

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ООО «Евраз Медикал Групп»

Д.А. Обычный

«4» марта 2015



ФОТОГРАФИИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

**Система роботоассистенции стереотаксическая ROSA,
с принадлежностями:(см. Приложение 1).**

Производства:

«МЕДТЕХ С.А.», Франция
MEDTECH S.A., France

Адрес: 1 chemin de Borie, Parc de Bellegarde - Bât. A, 34170, Castelnau-le-
lez, France

СОДЕРЖАНИЕ.

Наименование	Стр.
Система роботоассистенции стереотаксическая ROSA (основной блок, с кабелем питания, чехлом для монитора, чехлом для роботизированной руки, системой фиксации опорной)	3
Указка-зонд	4
Датчик измерения расстояний оптический	5
Устройство для калибровки датчика оптического	6
Модель рентгеновская для роботизированной руки	7
Модель рентгеновская для рамы Leksell	8
Модель регистрационная для рамы Leksell	9
Адаптер для рамы Leksell	10
Адаптер для фиксатора головы типа Mayfield	11
Держатель инструмента	12
Держатель инструмента для вентрикулярной эндоскопии	13
Держатель инструмента для трансназальной эндоскопии	14
Держатель микроманипулятора для установки электродов Medtronic	15
Держатель микроманипулятора для установки электродов Alpha Omega	16
Держатель микроманипулятора для установки электродов Innomed	17
Адаптер для инструмента	18
Адаптер для сверла для СЭЭГ	19
Адаптер для канюли для СЭЭГ	20
Адаптер для вентрикулярной эндоскопии	21
Шуруп M5 стальной	22
Шуруп держателя инструмента	23
Шуруп адаптера инструмента	24
Устройство предохранительное ручное	25
Устройство предохранительное напольное	26
Система фиксации шарнирная	27
Система фиксации опорная	28
Штанга поддерживающая	29
Мышь USB	30
Стилус	31
Рулетка измерительная	32
Ключ шестигранный	33
Кейс для хранения	34













L

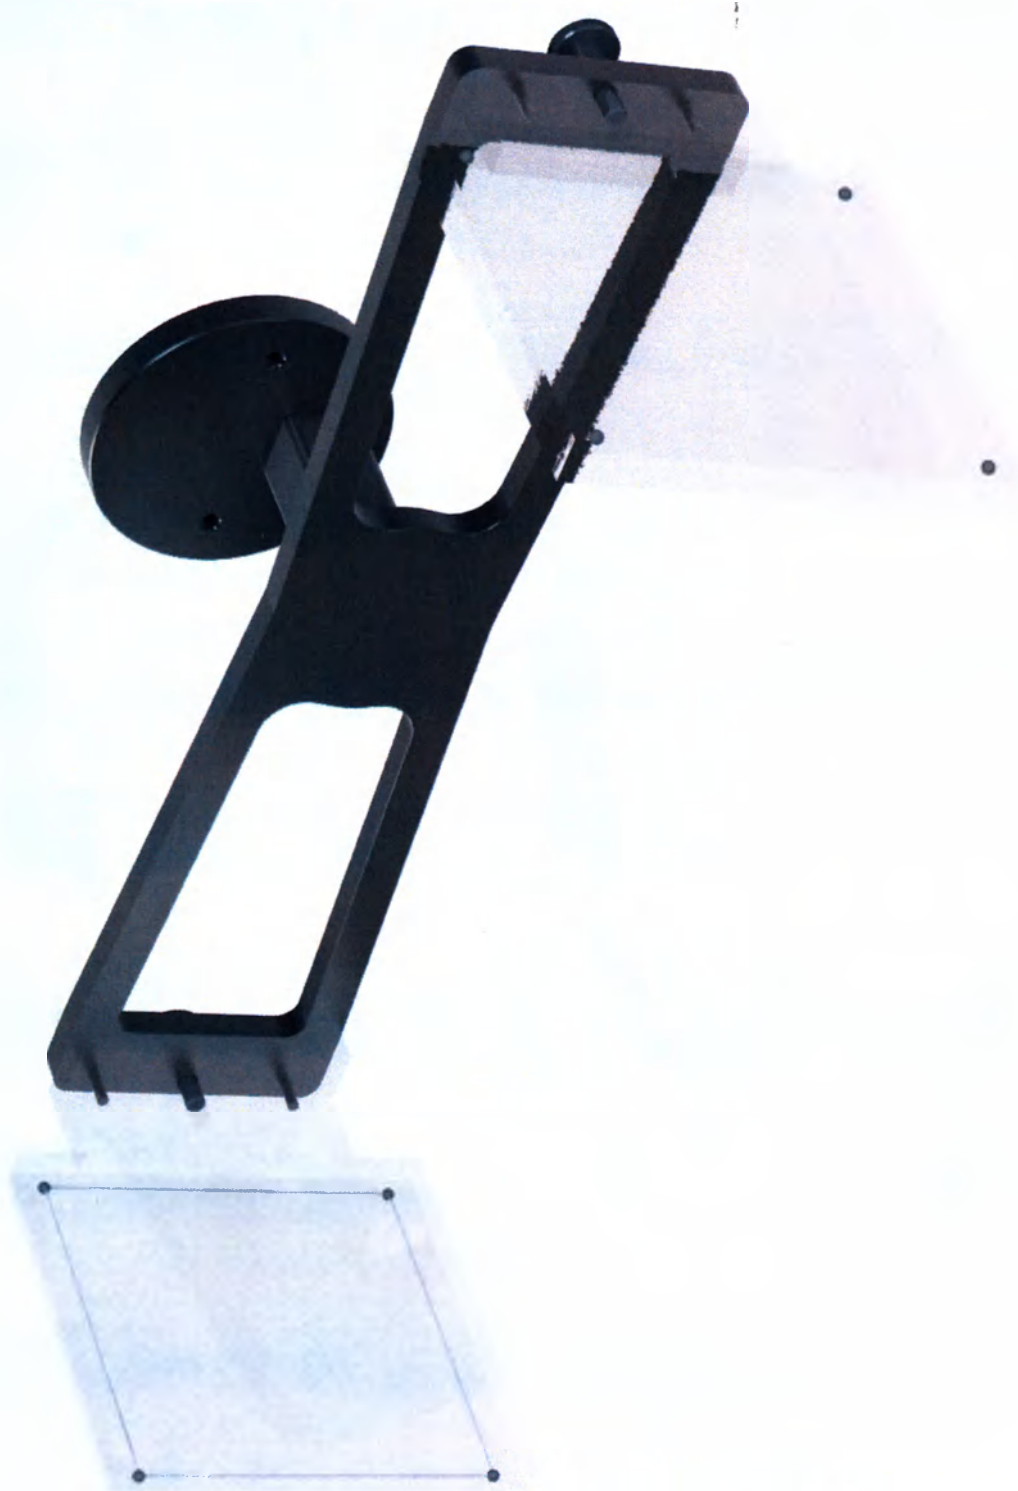

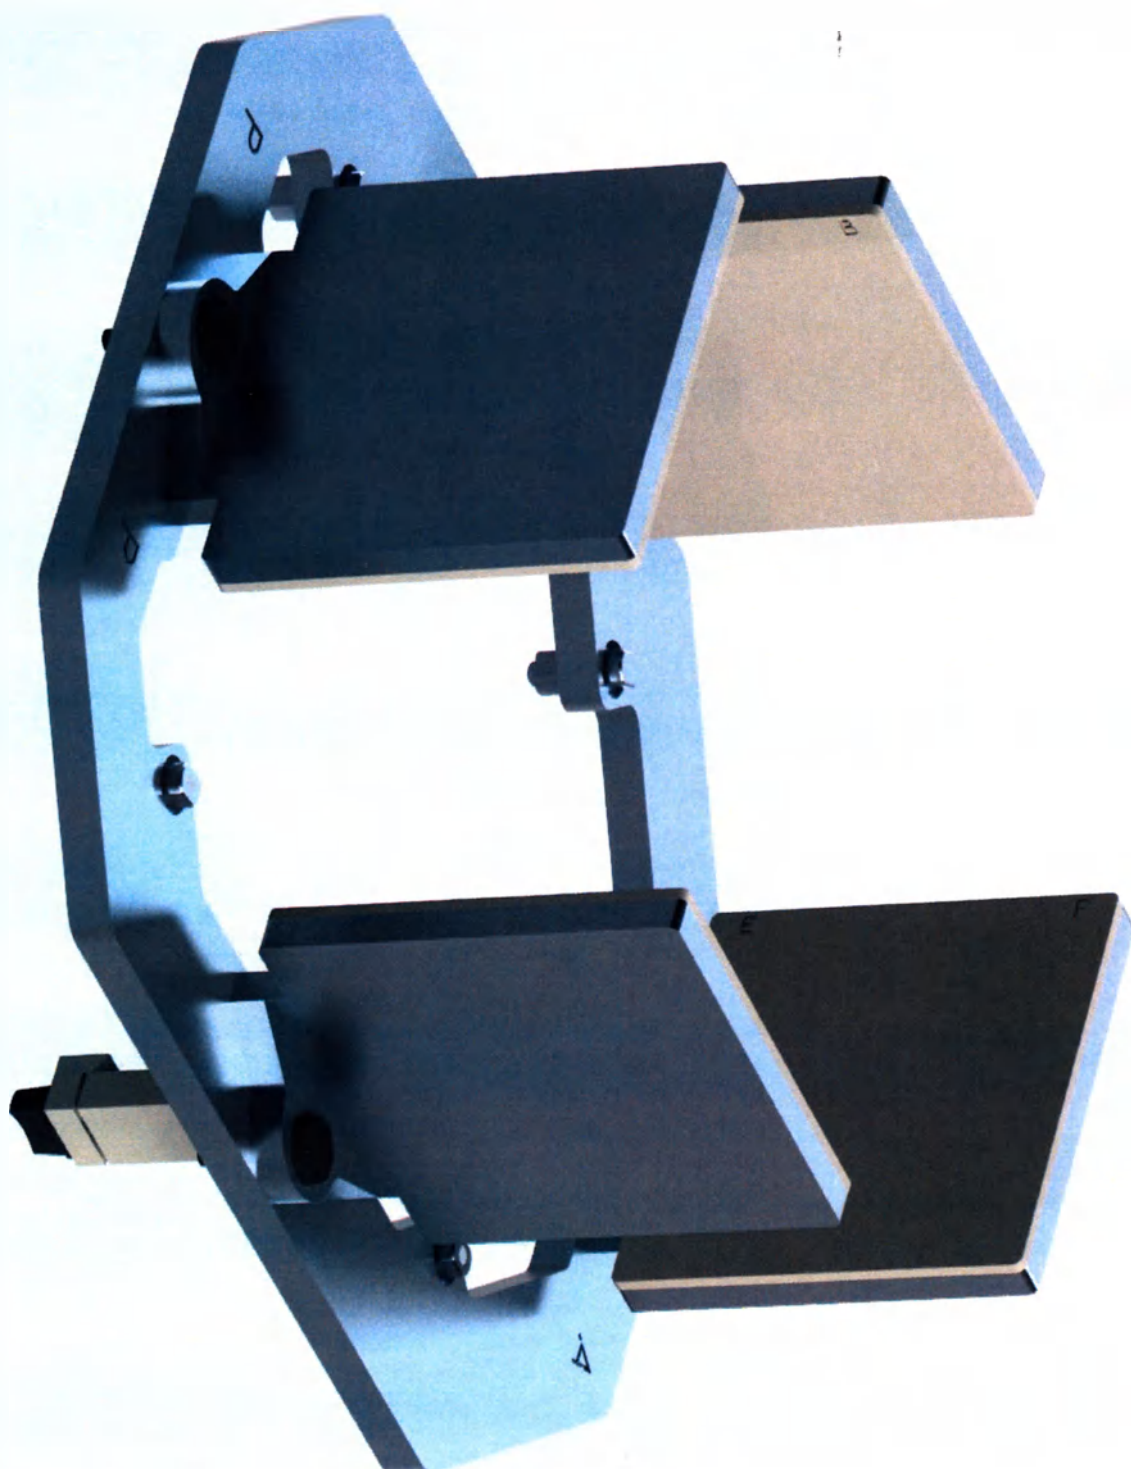



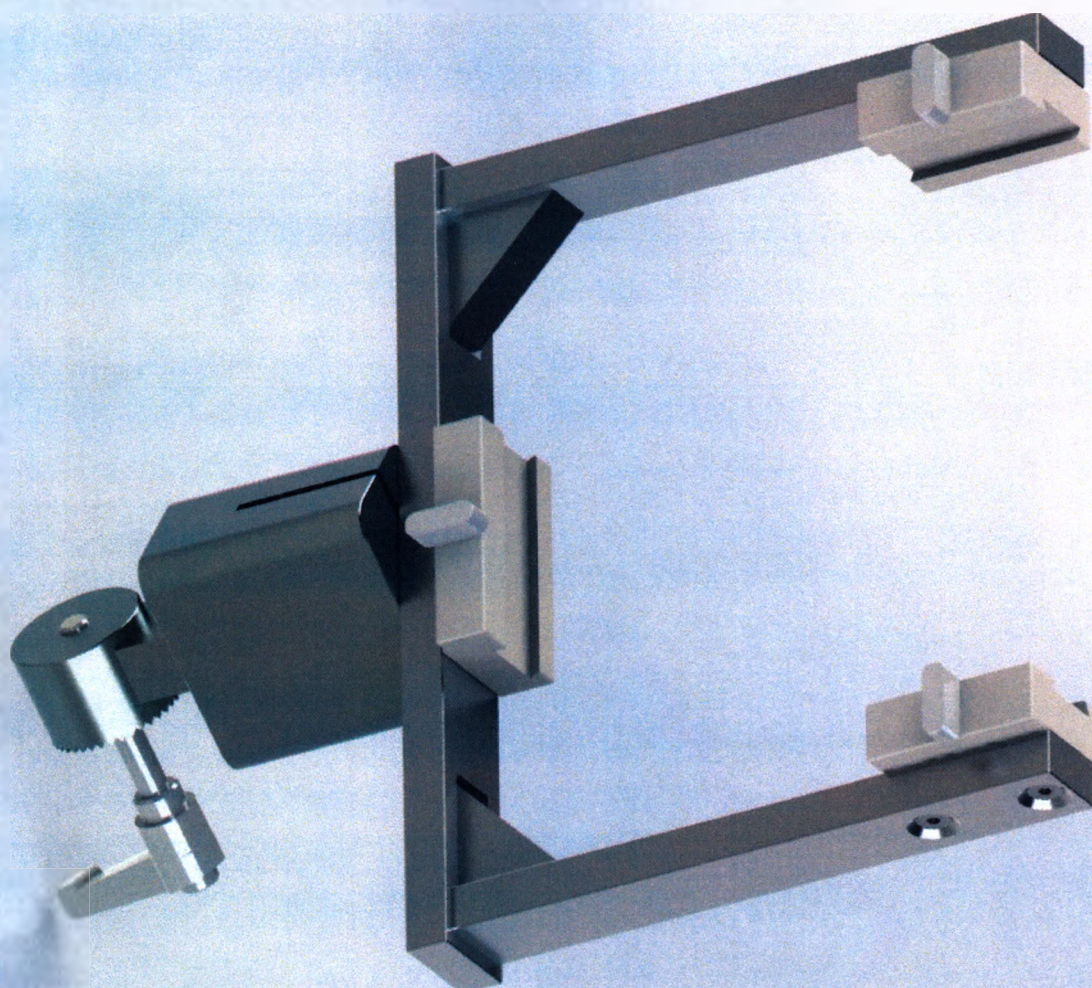


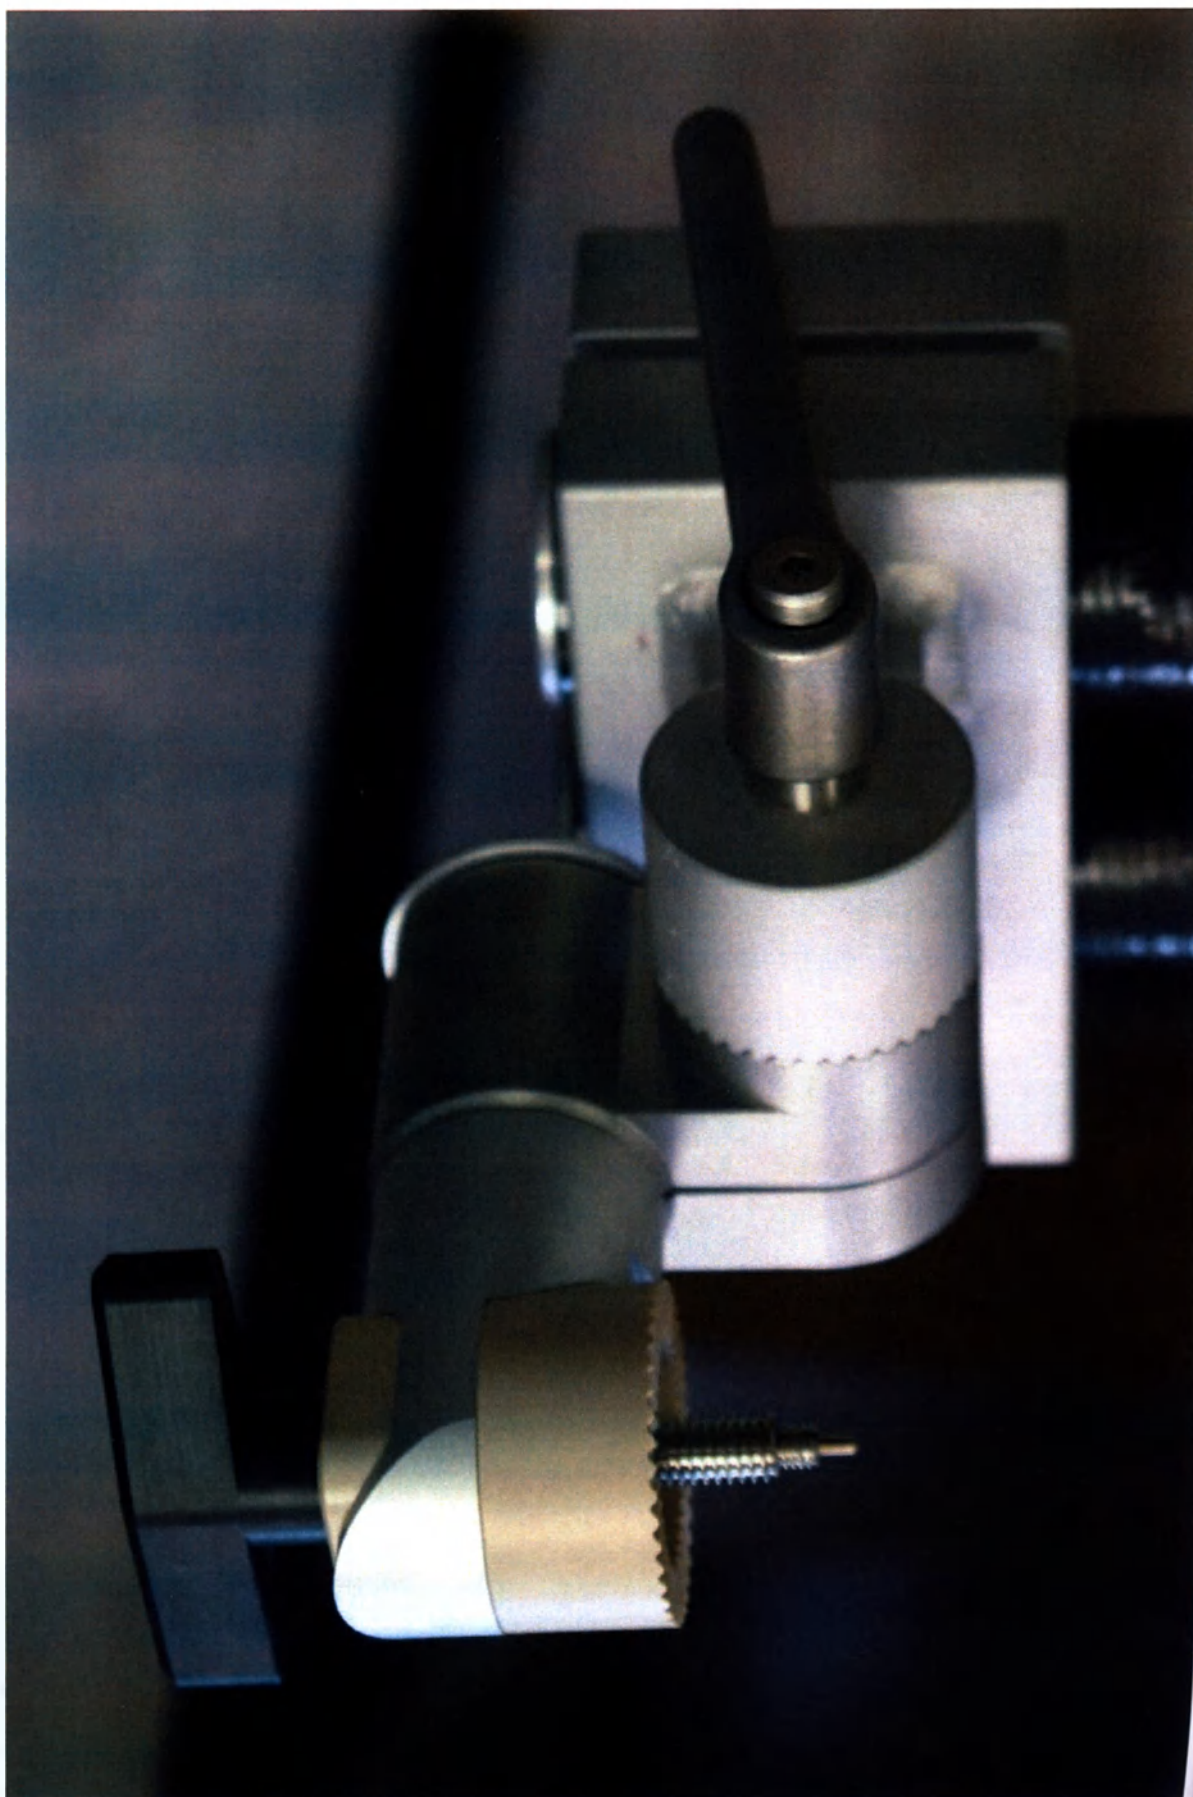








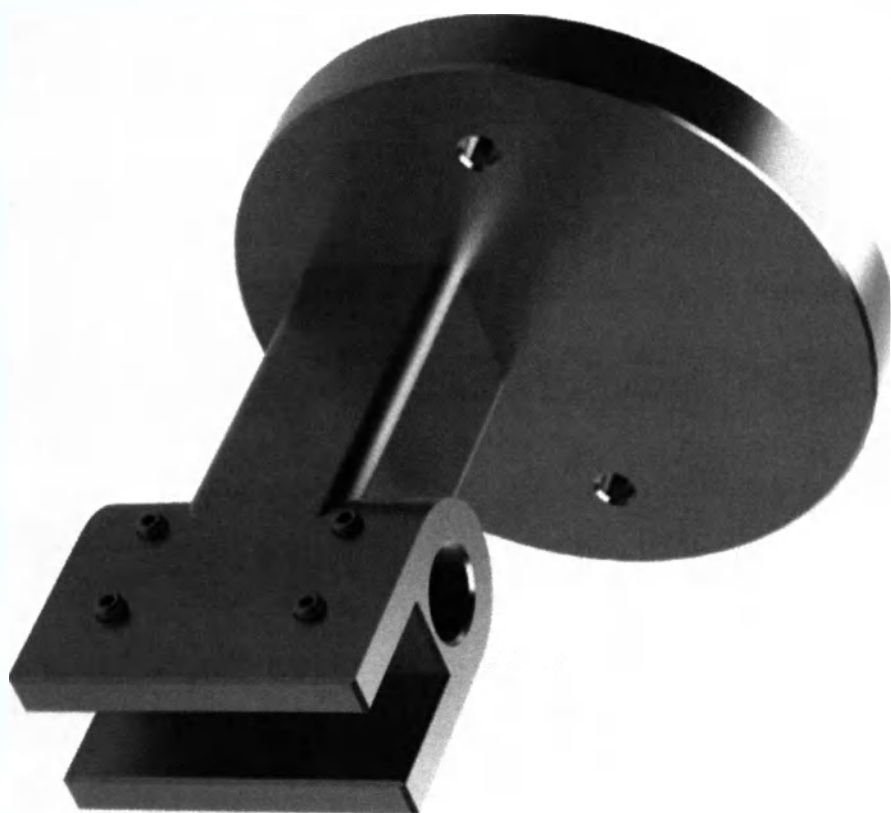


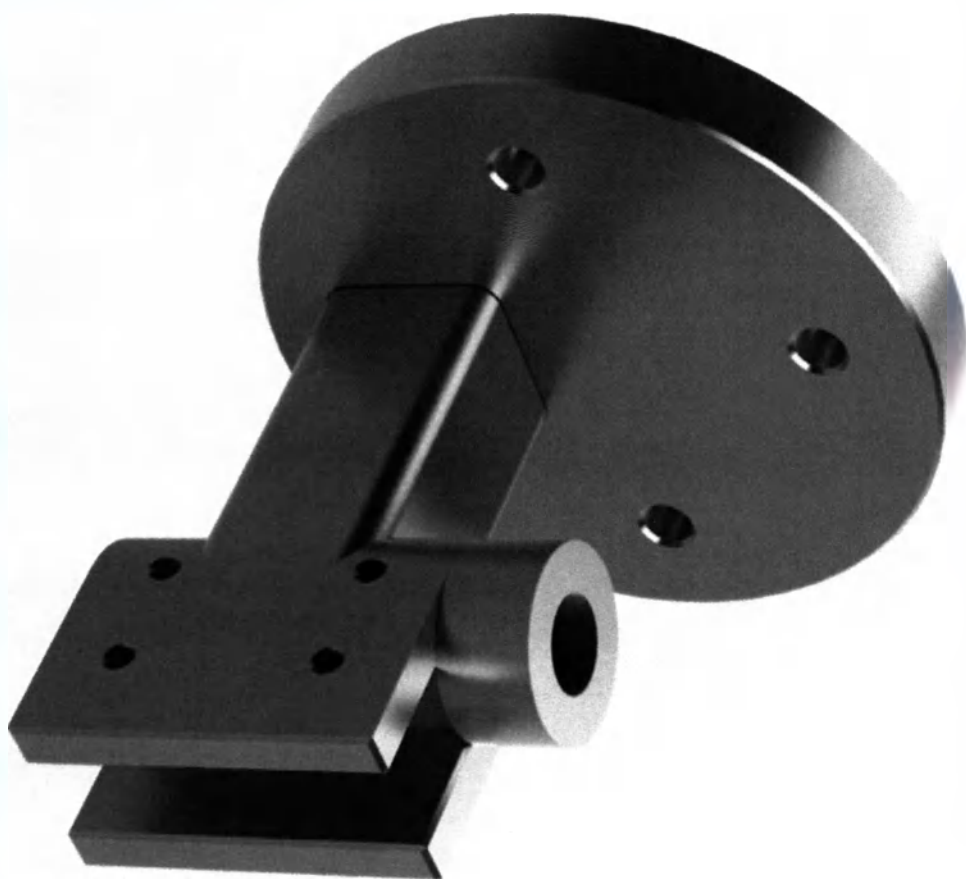









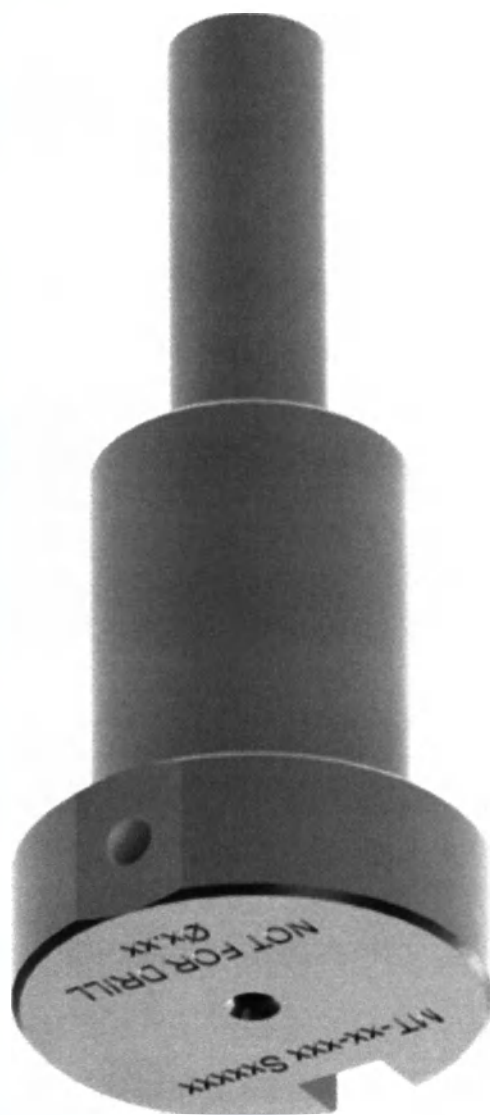

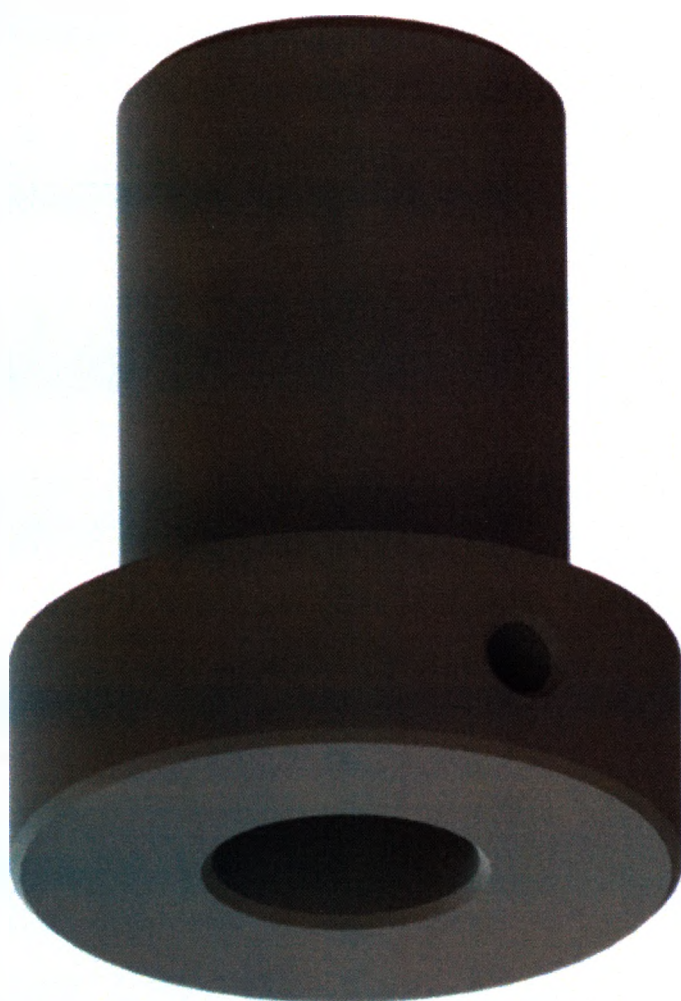




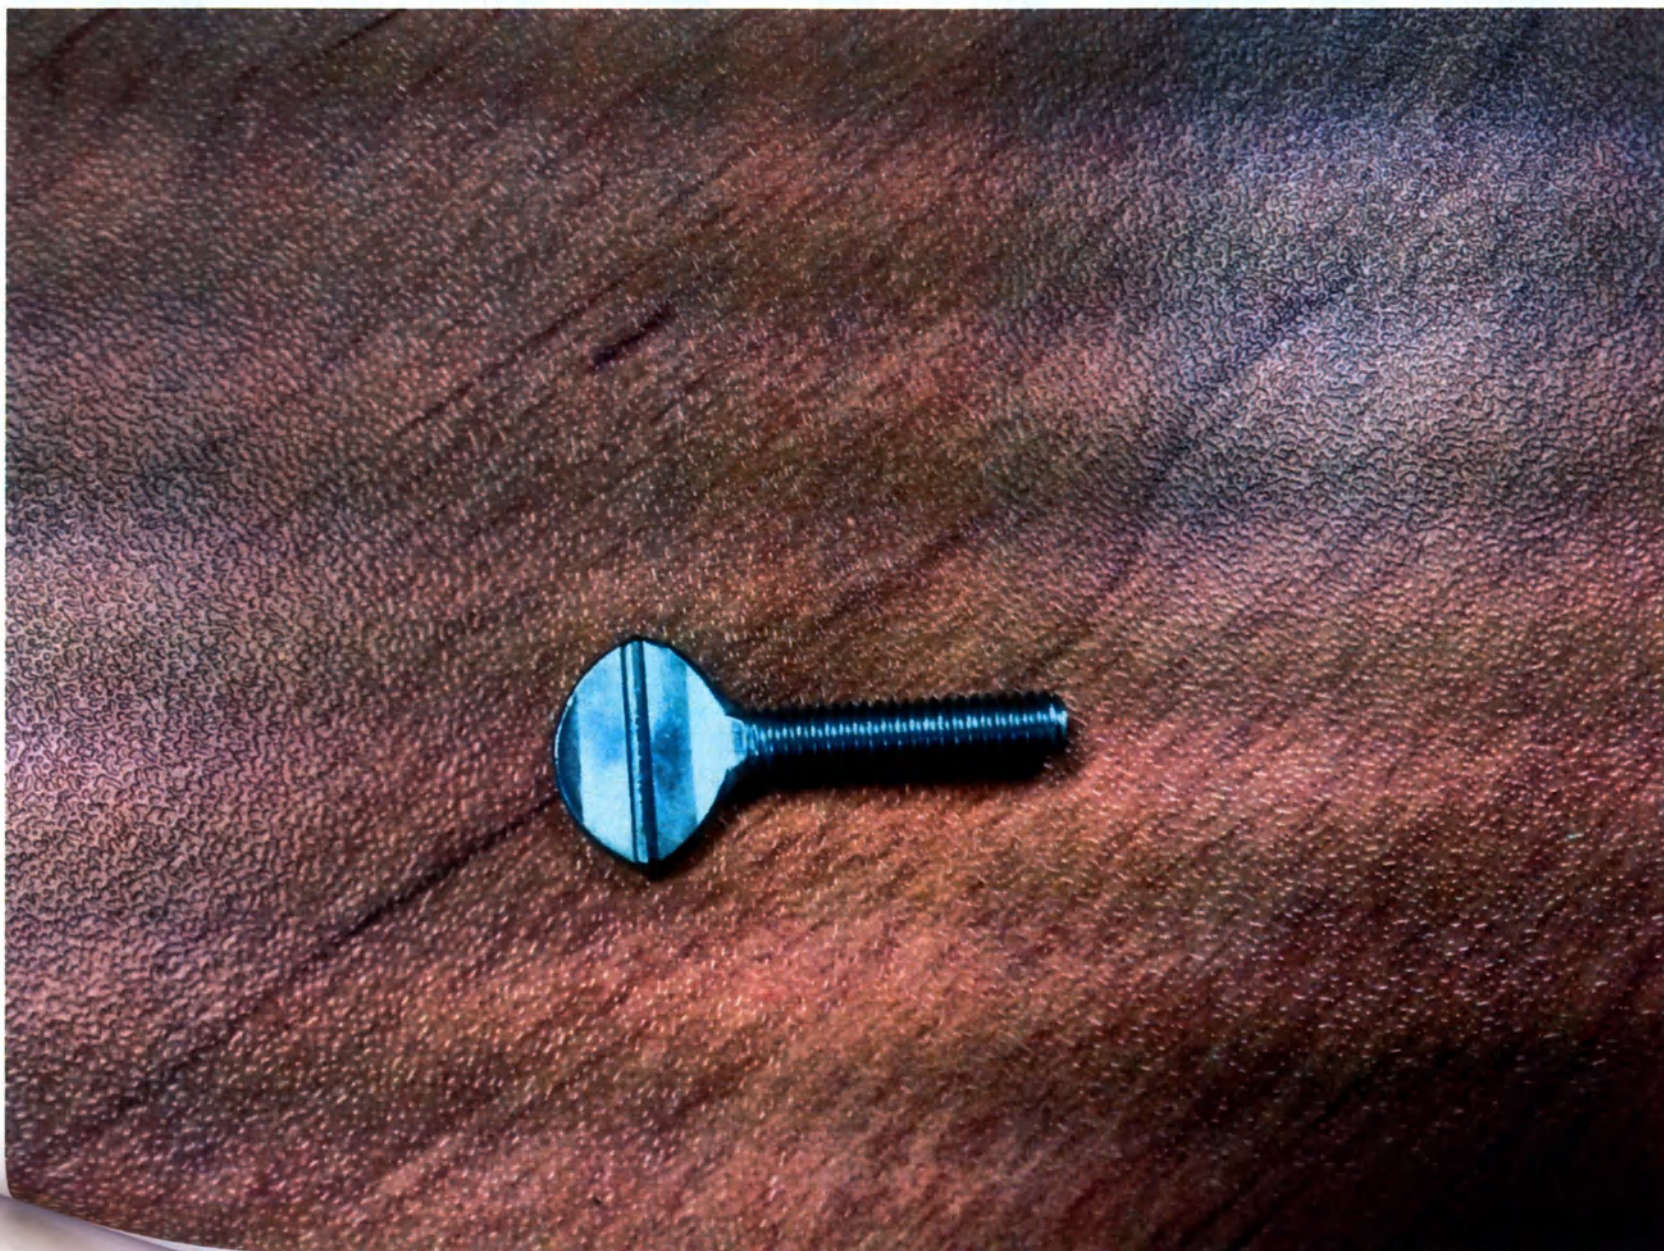









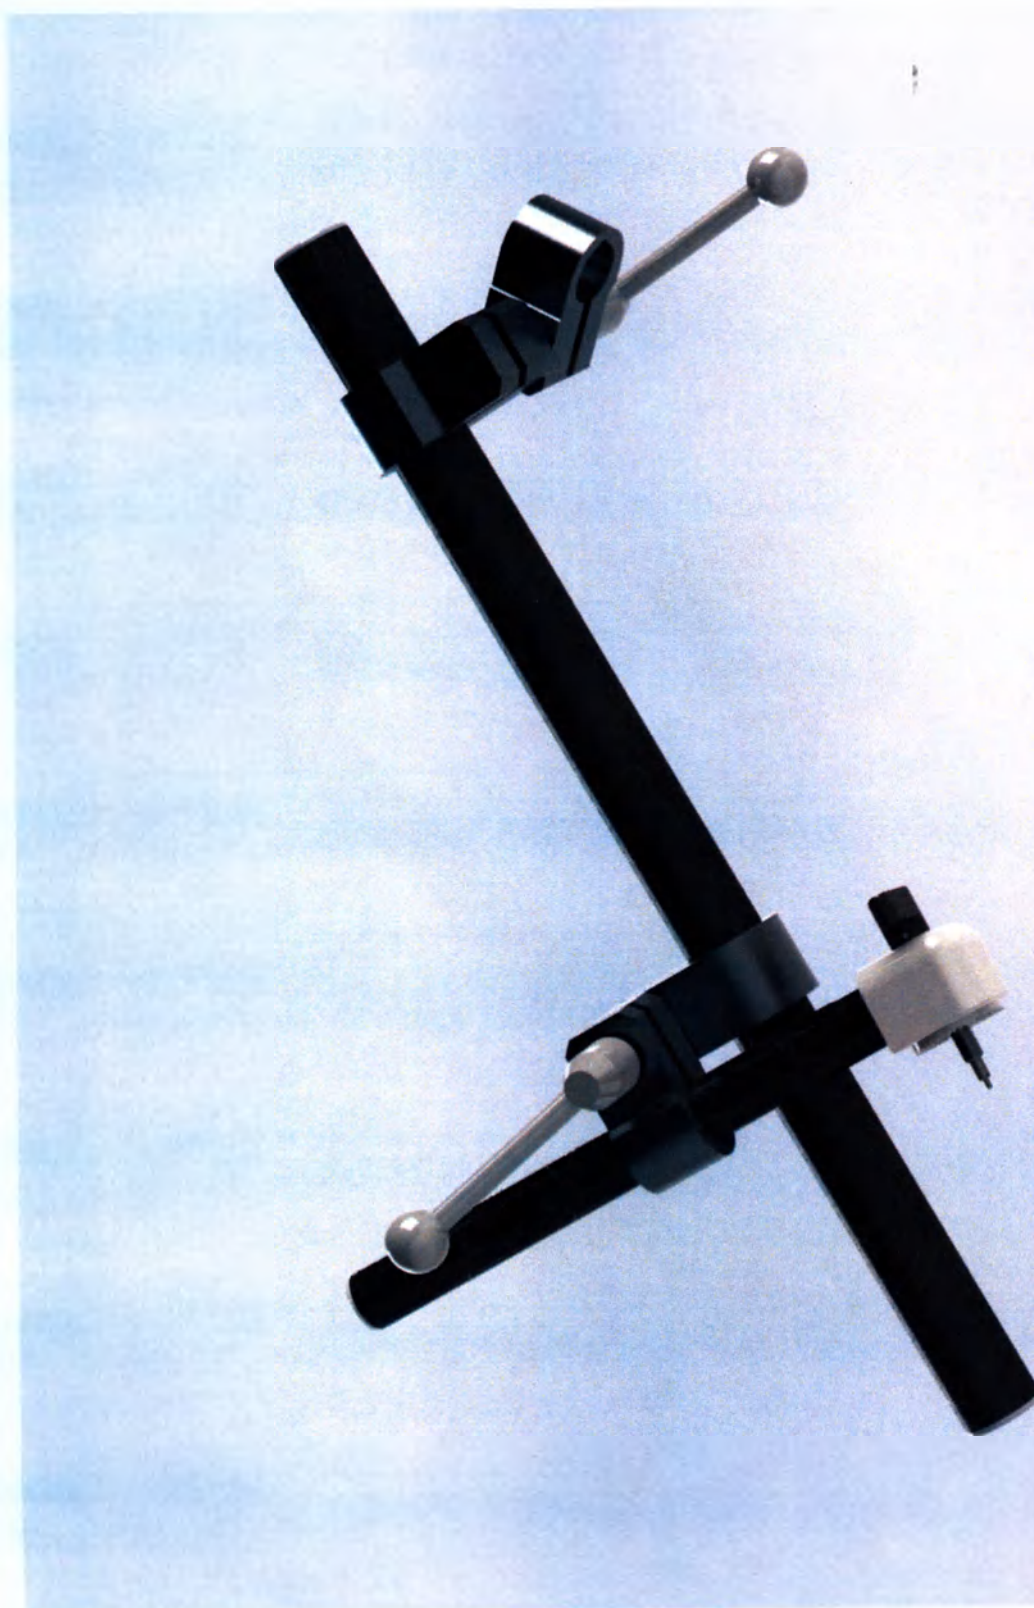

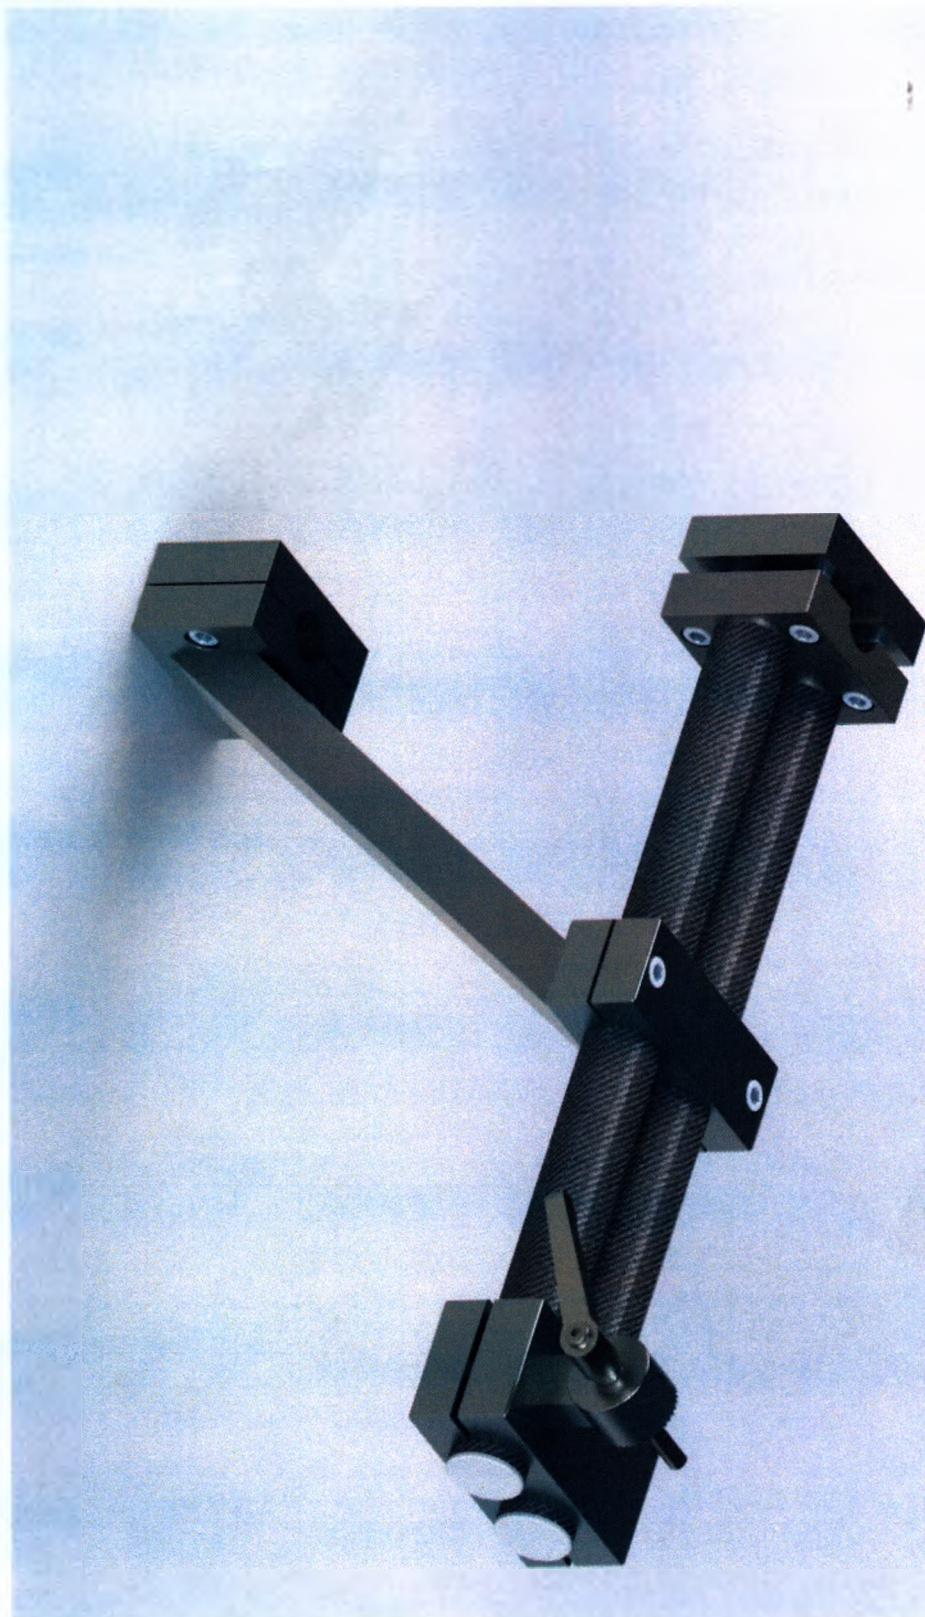






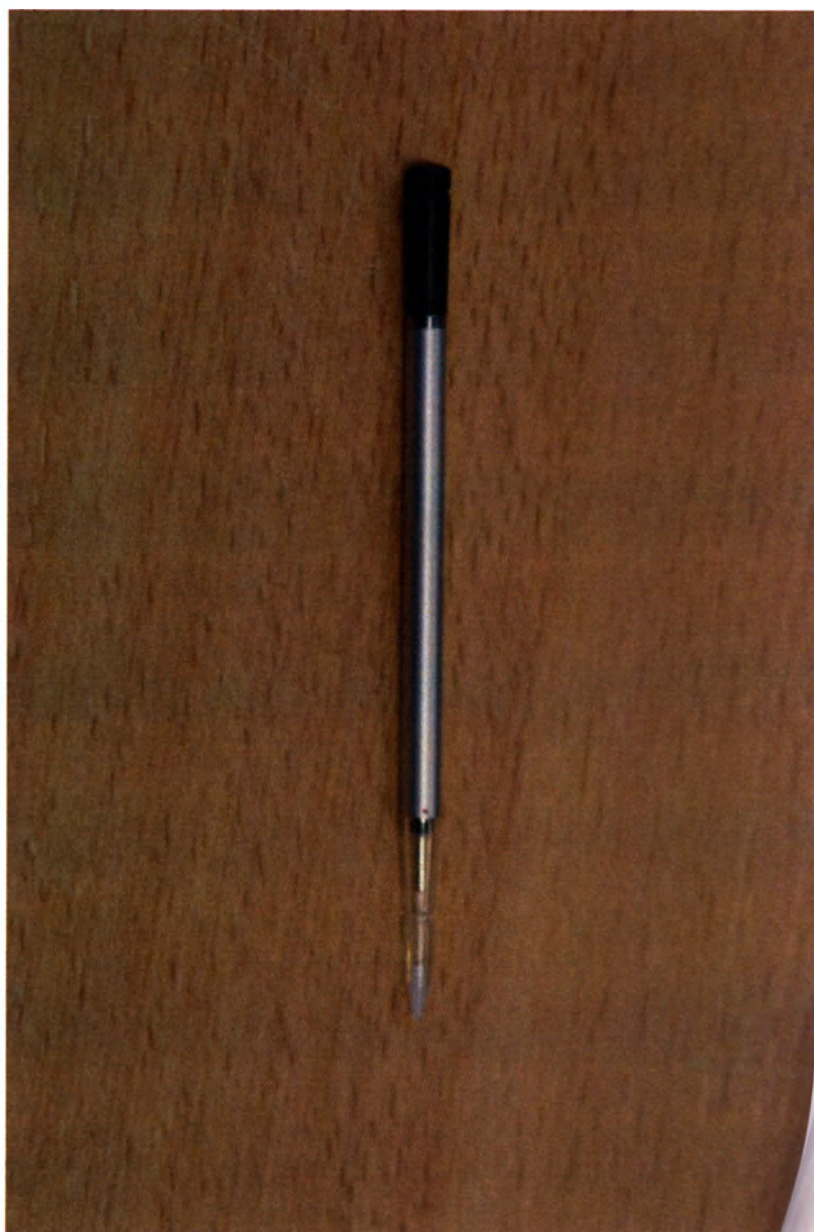





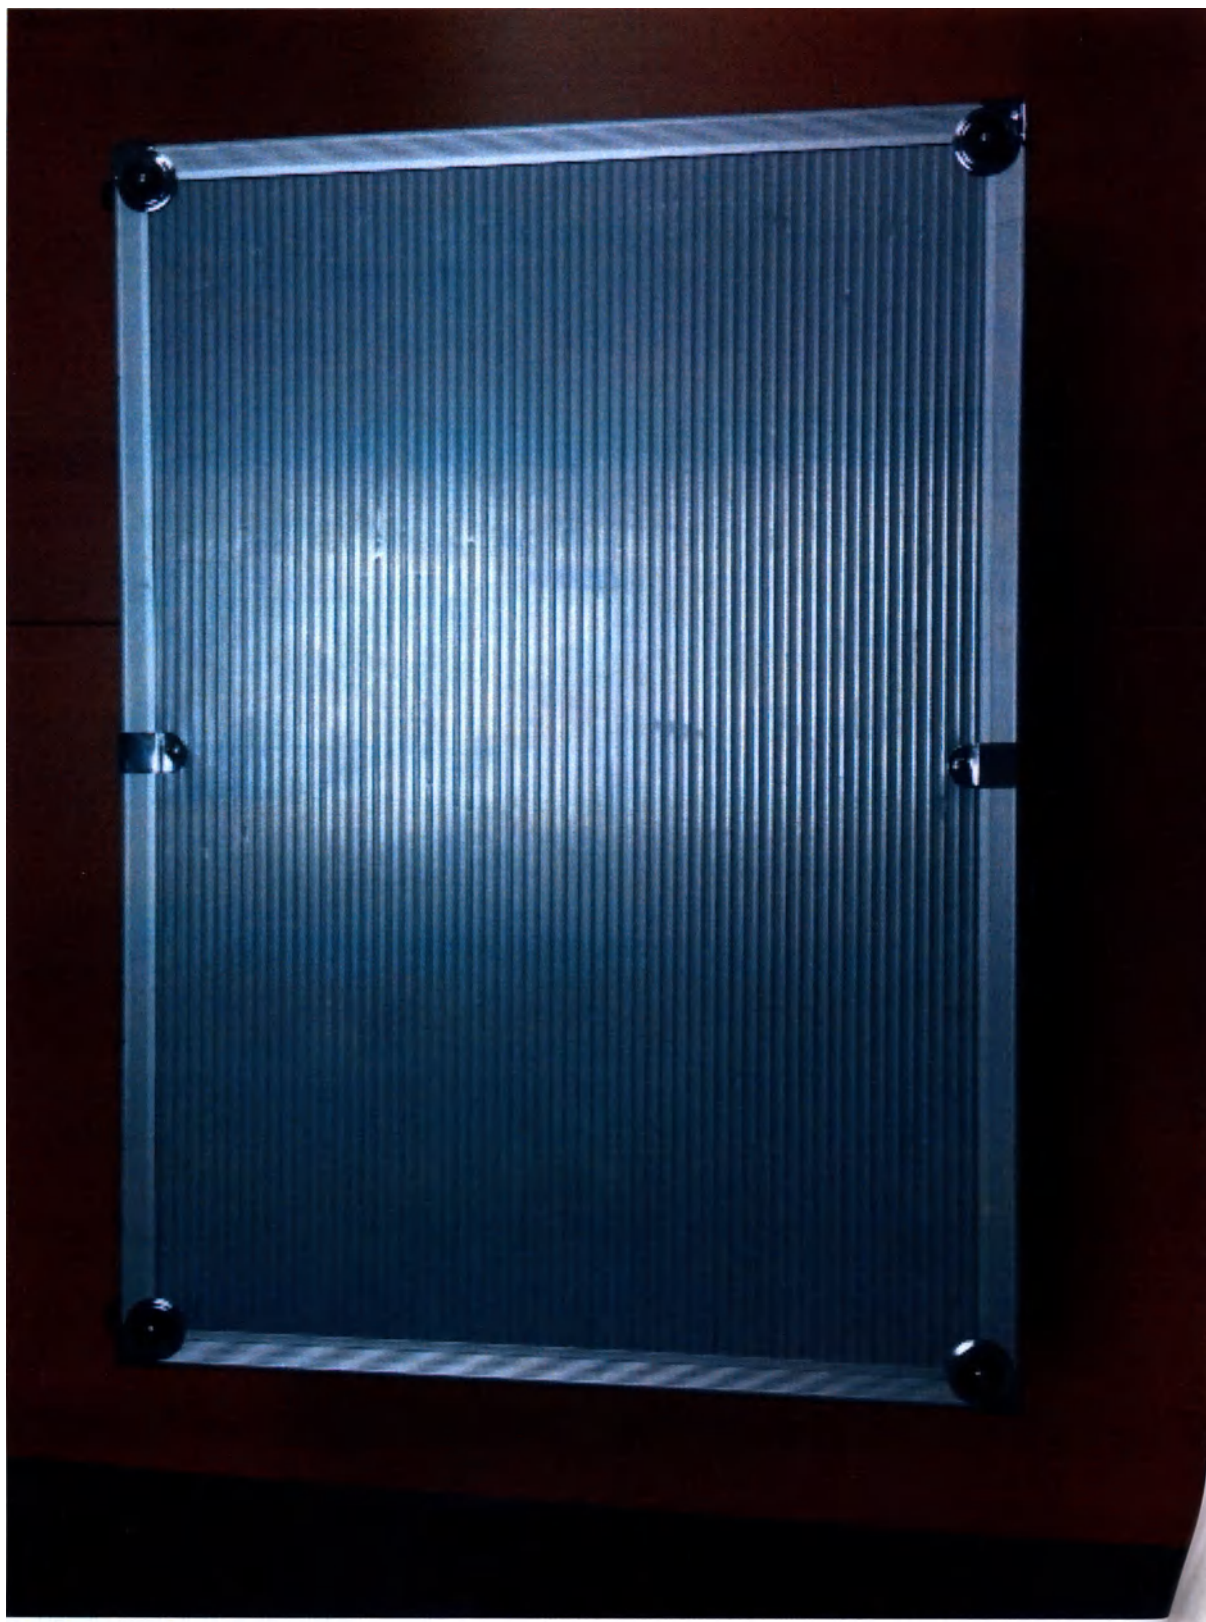

Приложение 1.

Тема робоаппаратуры стереотаксическая ROSA. с принадлежностями:

I. Состав системы:

1. Основной блок (включает: платформу мобильную, руку роботизированную, экран сенсорный);
2. Указка-зонд - не более 5 шт;
3. Датчик измерения расстояний оптический - не более 2 шт;
4. Модель рентгеновская для роботизированной руки - не более 3 шт;
5. Модель рентгеновская для рамы Leksell - не более 3 шт;
6. Модель регистрационная для рамы Leksell - не более 3 шт;
7. Адаптер для рамы Leksell - не более 3 шт;
8. Адаптер для фиксатора головы типа Mayfield - не более 3 шт;
9. Держатель инструмента - не более 10 шт;
10. Держатель инструмента для вентрикулярной эндоскопии - не более 10 шт;
11. Держатель инструмента для трансназальной эндоскопии - не более 10 шт;
12. Держатель микроманипулятора для установки электродов Medtronic - не более 10 шт;
13. Держатель микроманипулятора для установки электродов Alpha Omega - не более 10 шт;
14. Держатель микроманипулятора для установки электродов Innomed - не более 10 шт;
15. Адаптер для инструмента (диаметр входа от 0,9 мм до 15 мм) - не более 30 шт;
16. Адаптер для сверла для СЭЭГ (диаметр входа от 0,9 мм до 15 мм) - не более 30 шт;
17. Адаптер для канюли для СЭЭГ (диаметр входа от 0,9 мм до 15 мм) - не более 30 шт;
18. Адаптер для вентрикулярной эндоскопии (диаметр входа от 5 мм до 15 мм) - не более 30 шт;
19. Шуруп М5 стальной - не более 30 шт;
20. Шуруп держателя инструмента - не более 20 шт;
21. Шуруп адаптера инструмента - не более 20 шт;
22. Устройство предохранительное ручное - не более 2 шт;
23. Устройство предохранительное напольное - не более 2 шт;
24. Мышь USB - не более 2 шт;
25. Кабель питания - не более 2 шт.

II. Принадлежности:

1. Устройство для калибровки датчика оптического - не более 2 шт;
2. Система фиксации шарнирная - не более 2 шт;
3. Система фиксации опорная - не более 2 шт;
4. Штанга поддерживающая - не более 2 шт;
5. Чехлы для монитора - не более 1000 шт;
6. Чехлы для роботизированной руки - не более 1000 шт;
7. Стилус - не более 2 шт;
8. Рулетка измерительная - не более 2 шт;
9. Ключ шестигранный - не более 2 шт;
10. Кейс для хранения - не более 20 шт;
11. Руководство по эксплуатации.

Прошито, пронумеровано

и скреплено печатью 35 лист

Генеральный директор
ООО «Евраз Медикал Групп»

Д.А. Обыкновенный

