

Набор реагентов для определения чувствительности *Trichomonas vaginalis* к антипротозойным препаратам (СВТ-АЧ).

внешний вид



ФБУН НИИ эпидемиологии и микробиологии
имени Пастера
Отдел Новых Технологий



ФБУН Научно-исследовательский институт
эпидемиологии и микробиологии
им. Пастера
Отдел новых технологий

Набор реагентов для определения
чувствительности *Trichomonas vaginalis*
к антипротозойным препаратам

«СВТ-АЧ»

Комплект № 2

Серия: 35 Дата изготовления: 05.15 Годен до: 06.15

ТУ 9398-010-01967164-2009

Состав набора:
8-луночные стрипы, содержащие метронидазол в семи концентрациях 10 шт.
Питательная среда для обнаружения *T. vaginalis*, лиофилизированная 10 фл.
Устройство для микробиологических исследований (требанка) 10 шт.
Пленка для заклеивания стрипов 1 шт.
Рамка-держатель для стрипов 1 шт.
Бланк учёта результатов исследования 1 шт.
Инструкция по применению 1 шт.

Хранить при температуре от 2 до 8 °C

197101, Санкт-Петербург, ул. Мира, 14
т/ф: (812)-233-17-03, (812)-313-69-88, (812)-313-69-89
e-mail: pasteurdnt@ya.ru <http://www.dntpasteur.ru>


Набор реагентов для определения чувствительности *Trichomonas vaginalis* к антипротозойным препаратам. Состав набора.

ГЭМ имени Пастера
СТРУКЦИЯ
применению
ентов для определения
льности *Trichomonas*
к антипротозойным
ратам (СВТ-АЧ)
омплект №1
НАЧЕНИЕ
редназначен для определ
as vaginalis к антипротозойн
при лечении урогенитальн
считан на проведение 10 анали
ети *T. vaginalis* к семи препара
ниморазол, секнидазол, оригид
оценить исследуемые штам
ные или резистентные к се
ЦИП МЕТОДА
очается в обнаружении подавле
ия исследуемого штамма *T. vagin*
стрипа с селективной питате
одержится препарат, облада
вами. Наличие или подавление
одится микроскопическим мет
гребенки, позволяющей про
цию во всех 8 лунках, одна из
тозойных препаратов и
м.
ОСТАВ НАБОРА
антипротозойными препаратами
я выявления *T. vaginalis*,
0 фл.
обиологических исследований
ия стрипа -10 шт.



Набор СВТ-АЧ.

Принадлежность набора - рамка-держатель для стрипов.

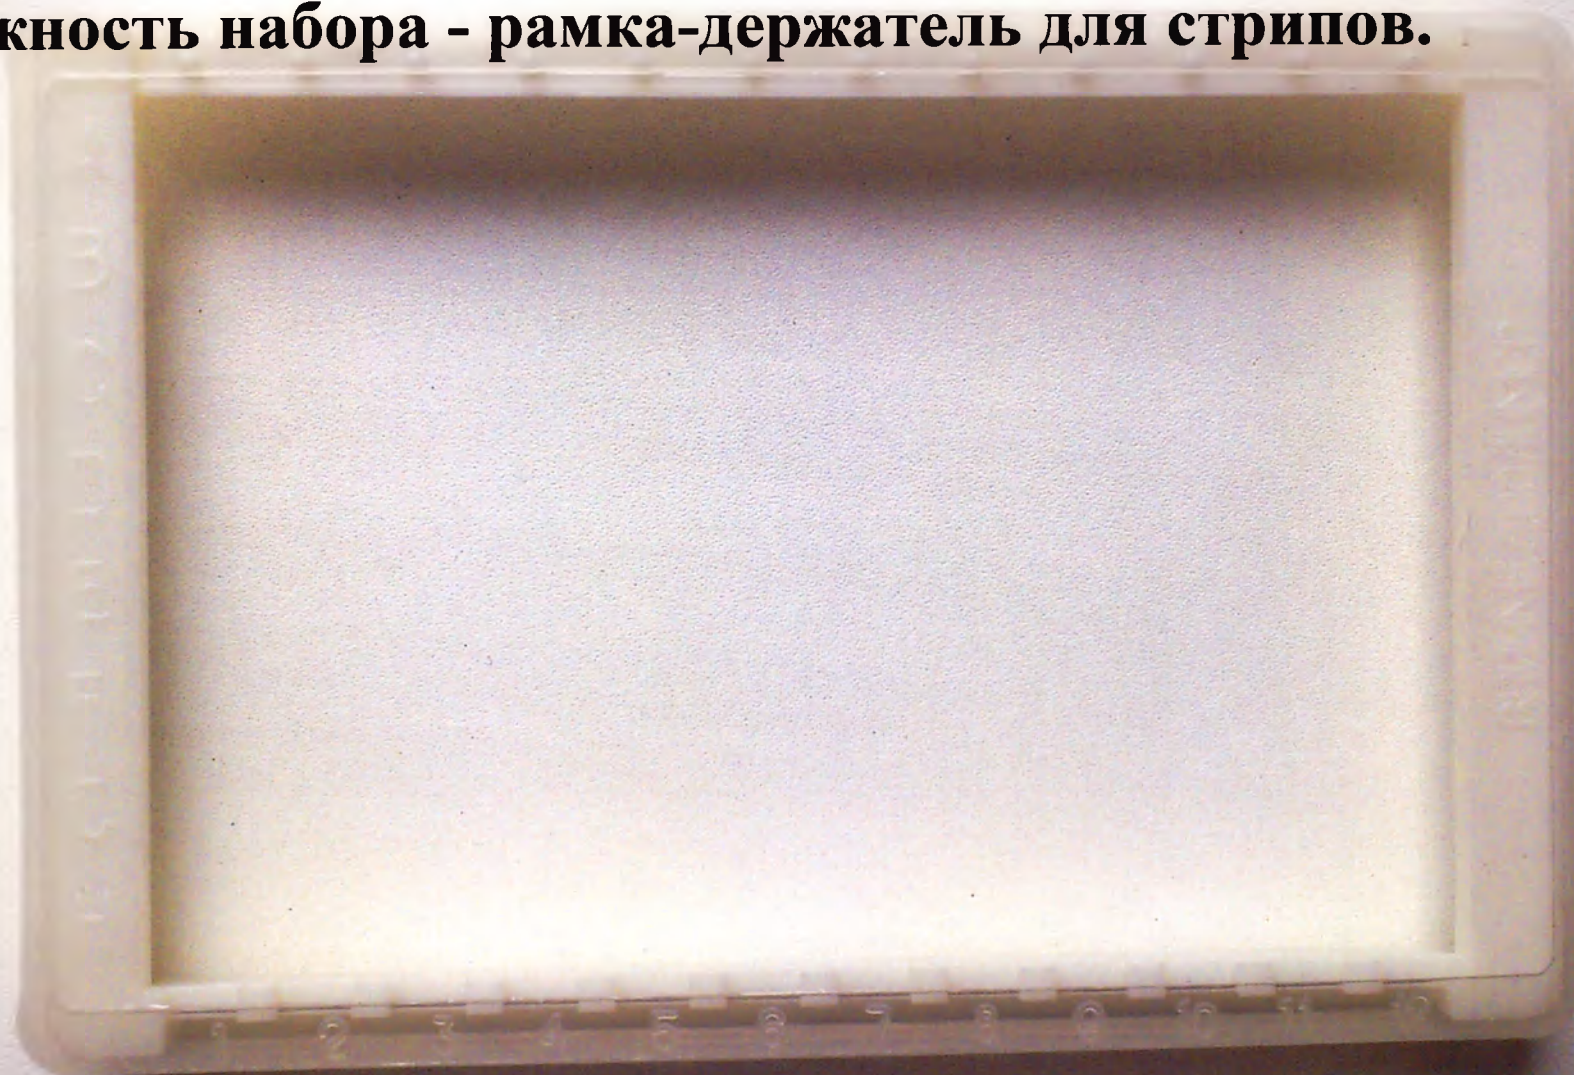

Набор СВТ-АЧ.

Принадлежность набора - упаковка с устройствами для микробиологических исследований (гребенка)




Набор СВТ-АЧ.

Компонент набора - коррексы,
содержащие 10 фл. с лиофилизированной
питательной средой для выявления
T.vaginalis.



Набор СВТ-АЧ.

Компонент набора - коррексы,
содержащие 10 фл. с лиофилизированной
питательной средой для выявления
T.vaginalis.

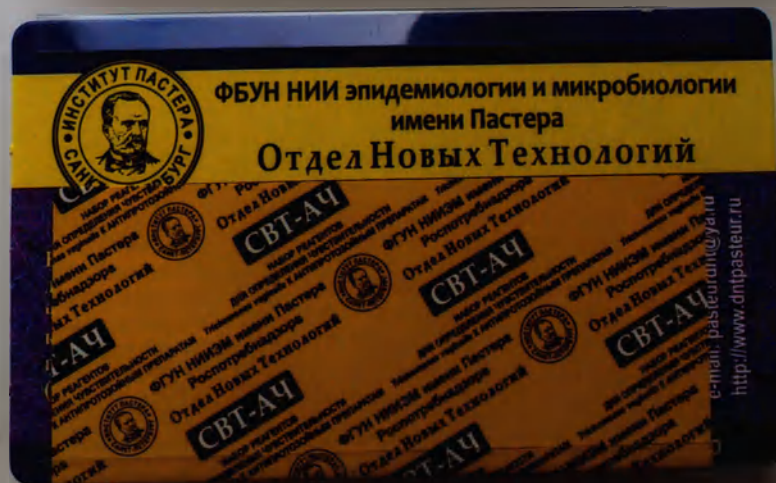

Набор СВТ-АЧ.

Компонент набора - 8-луночные стрипы с антипротозойными препаратами в упаковке.

