


Утверждаю
Генеральный директор

ООО «ХТМ»

Иванов В.Н.

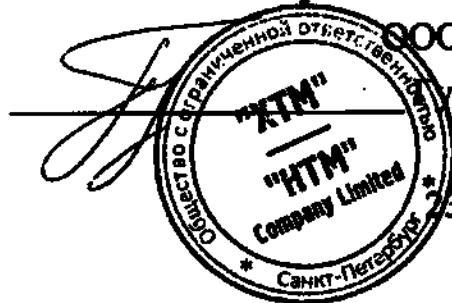

23.03.2015


**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ ОБЩЕГО ВИДА
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ**

**Датчики пульсоксиметрические НТМ
с кабелем и разъемом с принадлежностями.**

**Производства: Unimed Medical Supplies, Inc. (Юнимед Медикал Сапплайз, Инк.)
No.37, Yanshan Road, Shekou, Shenzhen, 518067, China**

Датчики пульсоксиметрические Н1М с кабелем и разъемом, серии НТМ100 (в упаковке, с маркировкой)



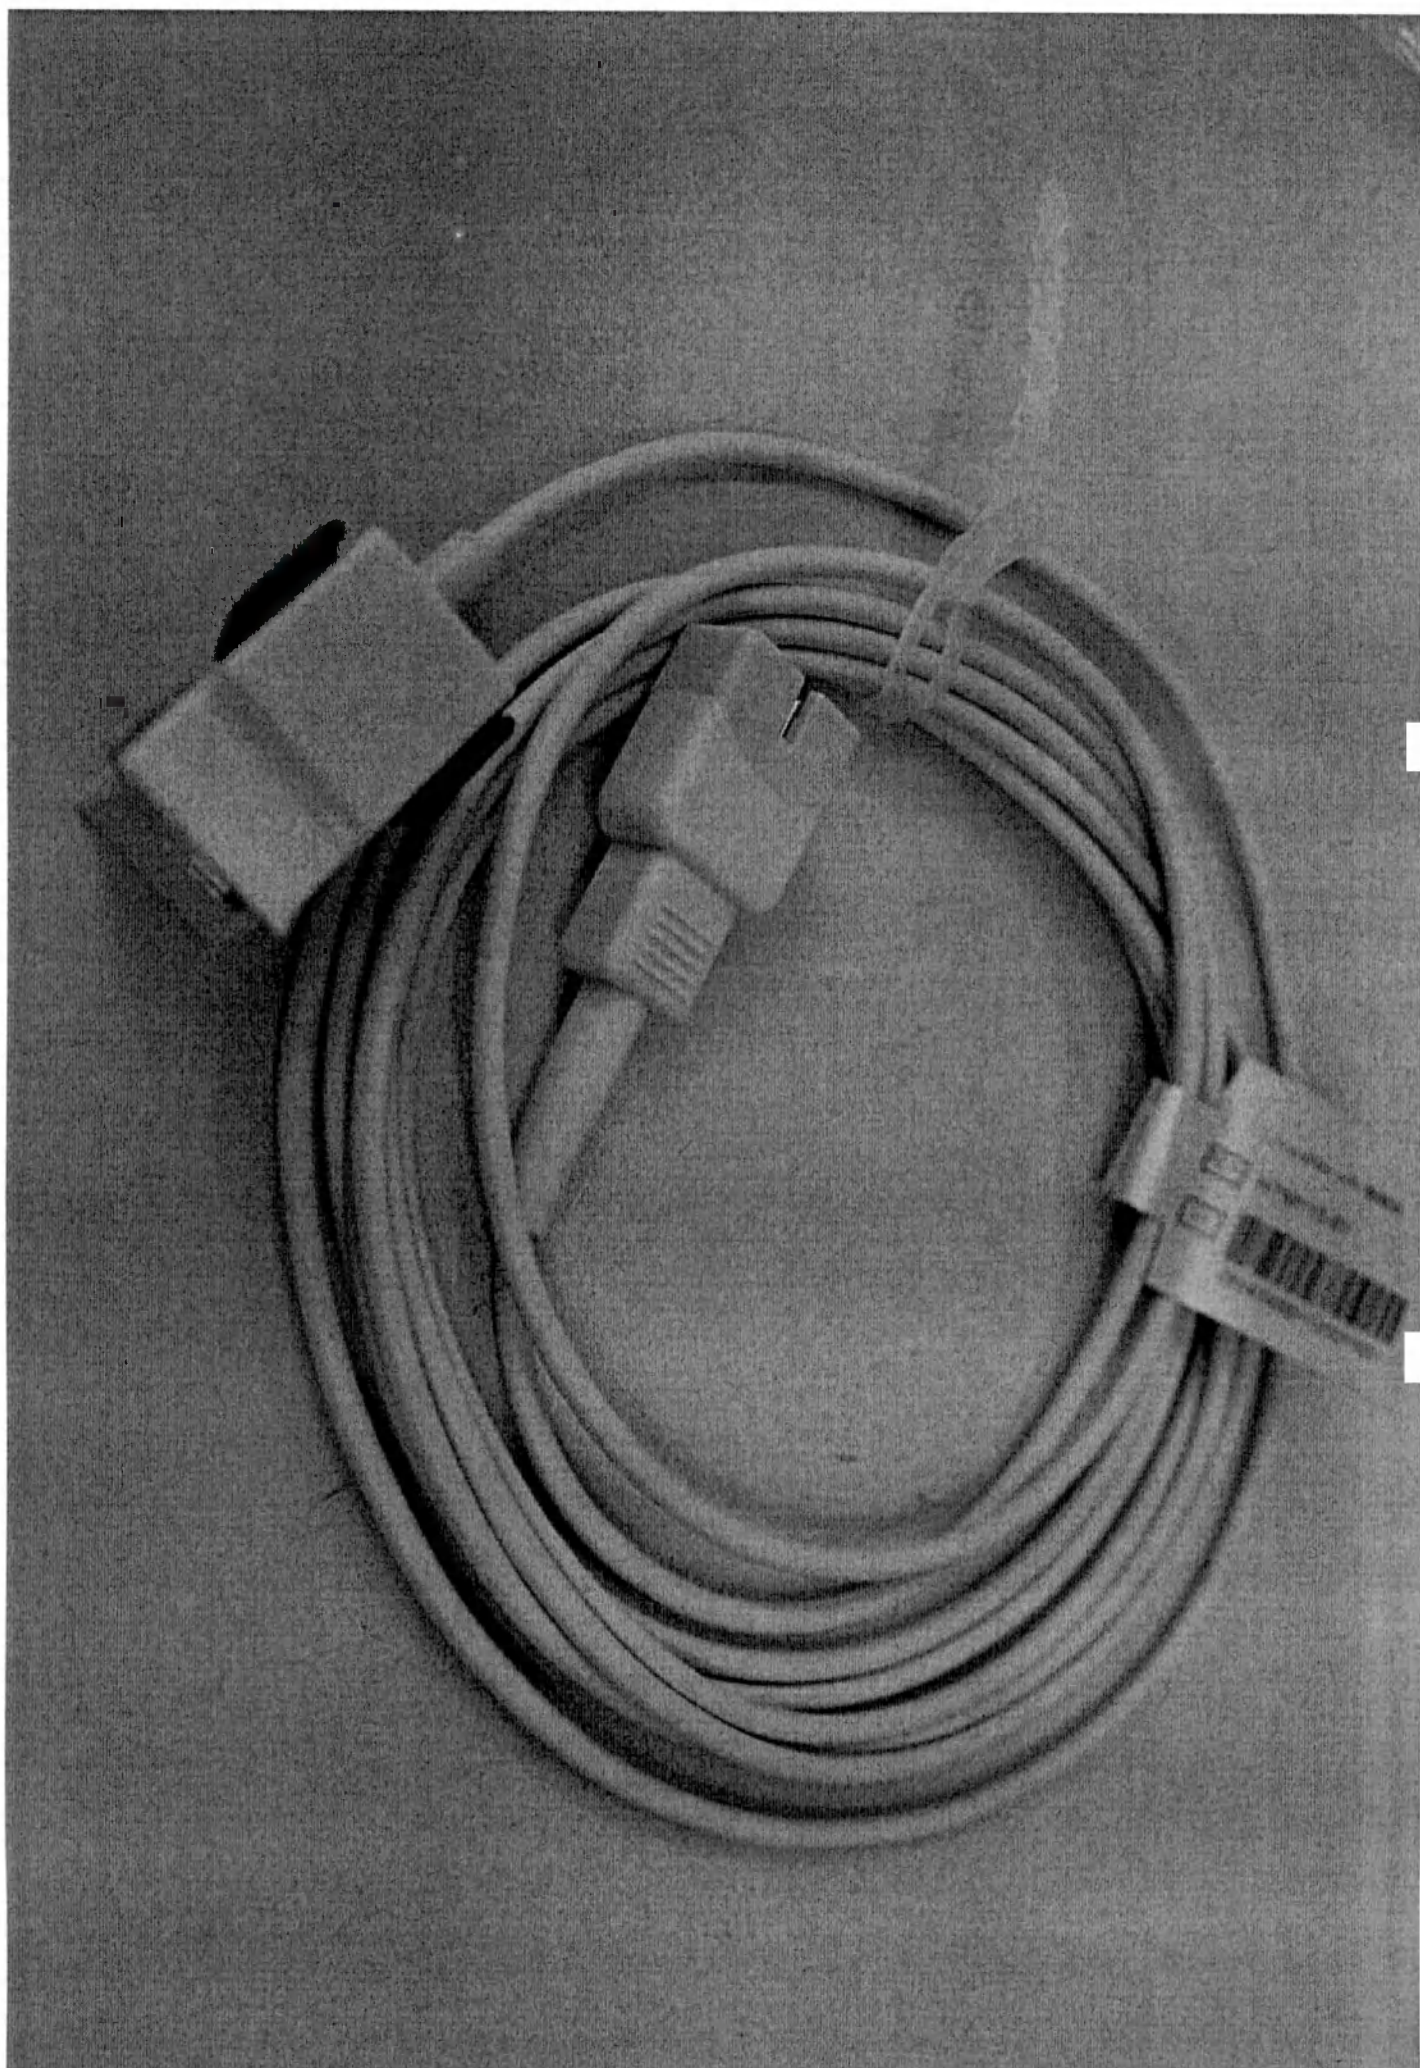


Датчики пульсоксиметрические НТМ с кабелем и разъемом, серии НТМ100S, (в упаковке, с маркировкой)





Датчики пульсоксиметрические НТІМ с кабелем и разъемом, серии НТМ200S (в упаковке, с маркировкой)



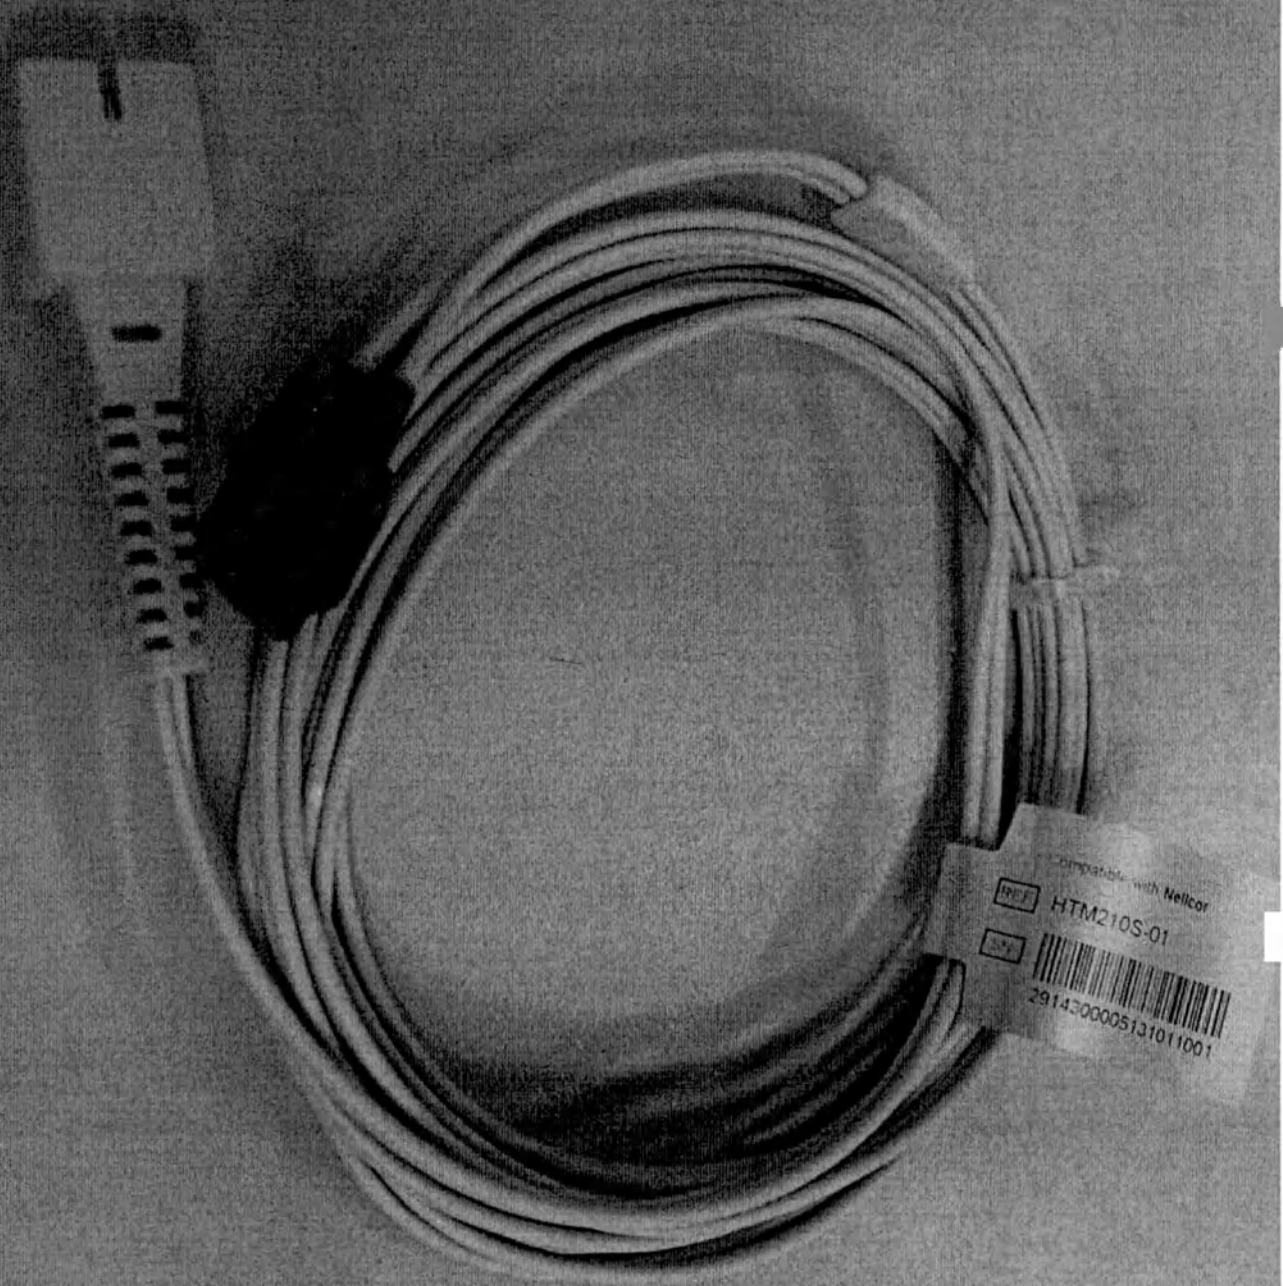

Датчики пульсоксиметрические НТМ с кабелем и разъемом, серии НТМ300 (в упаковке, с маркировкой)

unimed  **medical supplies**

Reusable Neonate Wrap SpO2 Sensor

REF **HTM300-05** **CE** **0123**

CSI Compatible, LEMO 5Pins Conn., 3.0m


SN  **2914300007131012001**

 **Unimed Medical Supplies Inc**
No.37, Yanshan Road, Shekou,
Shenzhen, China 518067


EC **REP** **Geranswers**
Rua Jos Rodrigues Miguls n141,
2870-486 Montijo, Portugal

 **2013/10/22**
Exp.date **2015/10/22**

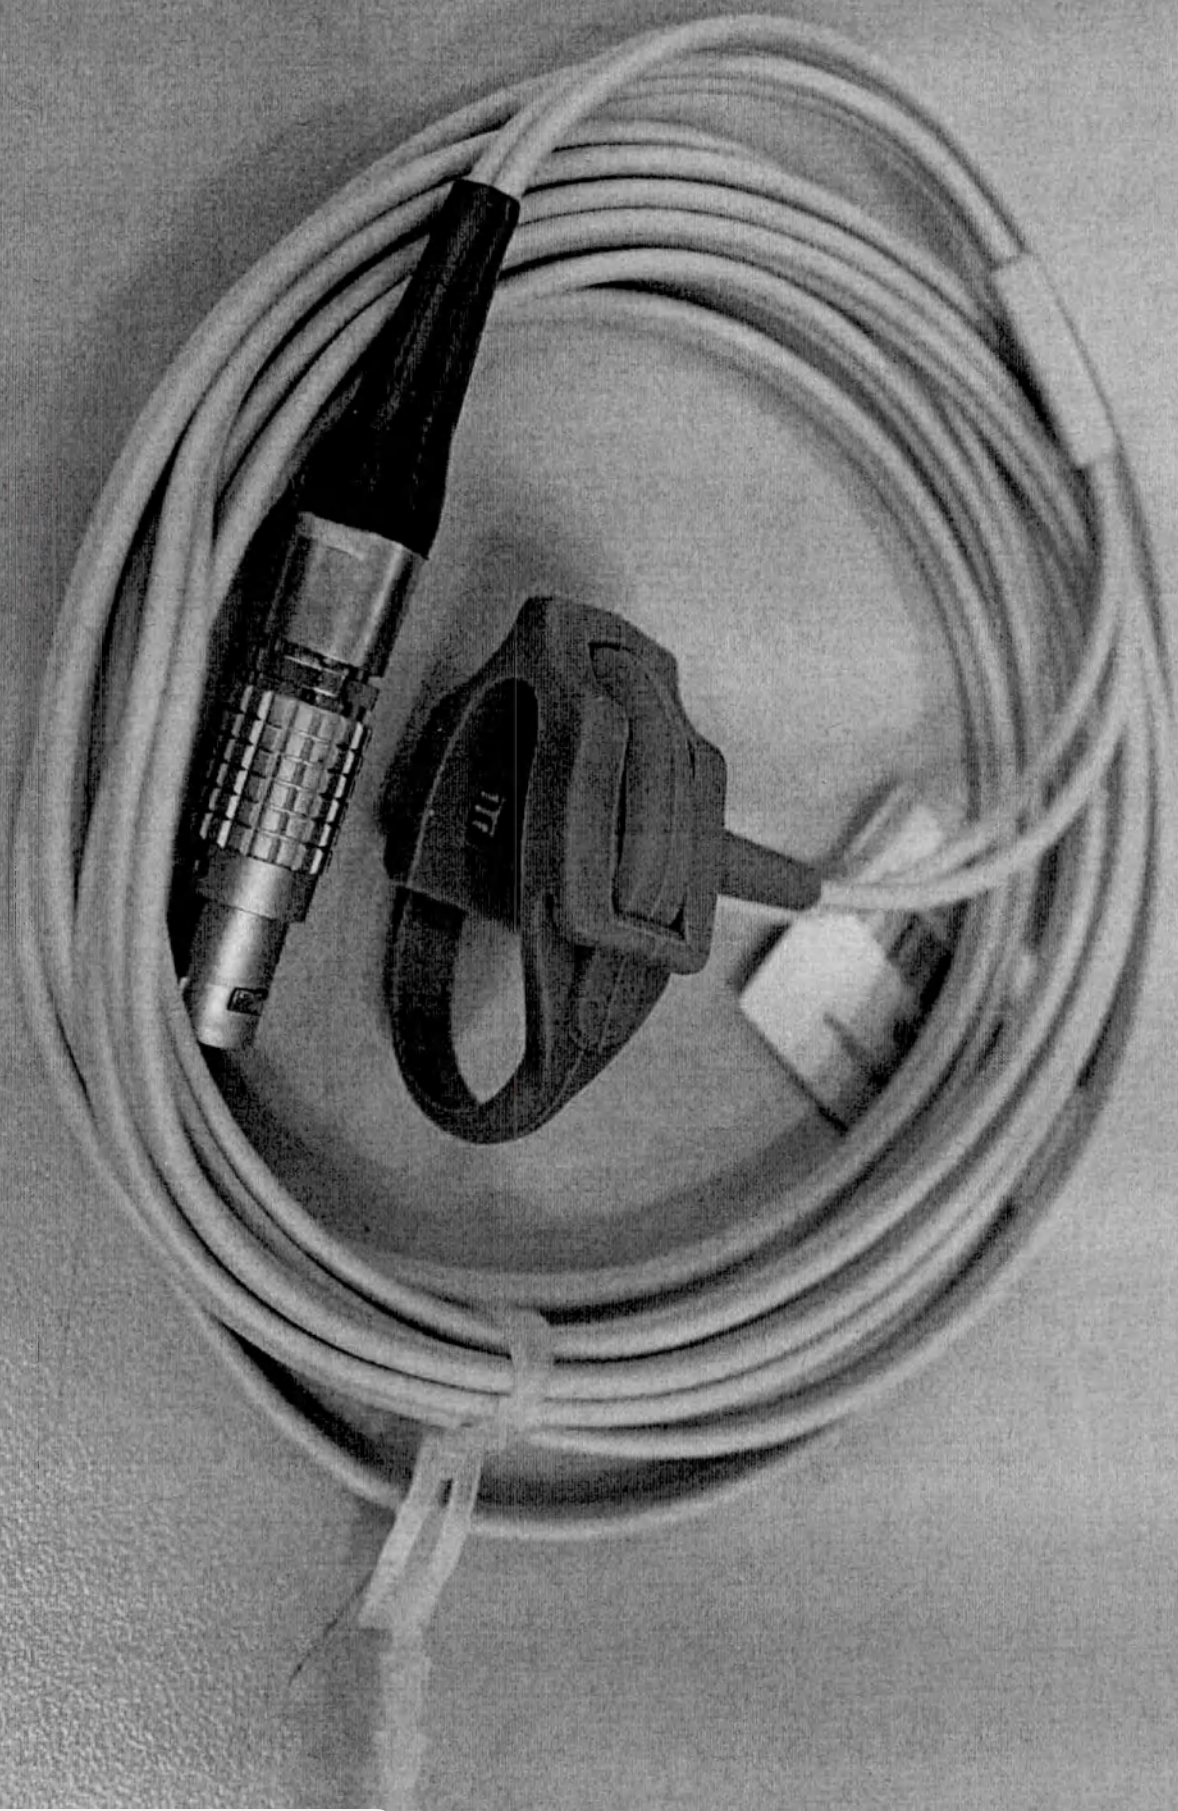


Датчики пульсоксиметрические Н1М1 с кабелем и разъемом, серии НТМ400 (в упаковке, с маркировкой)



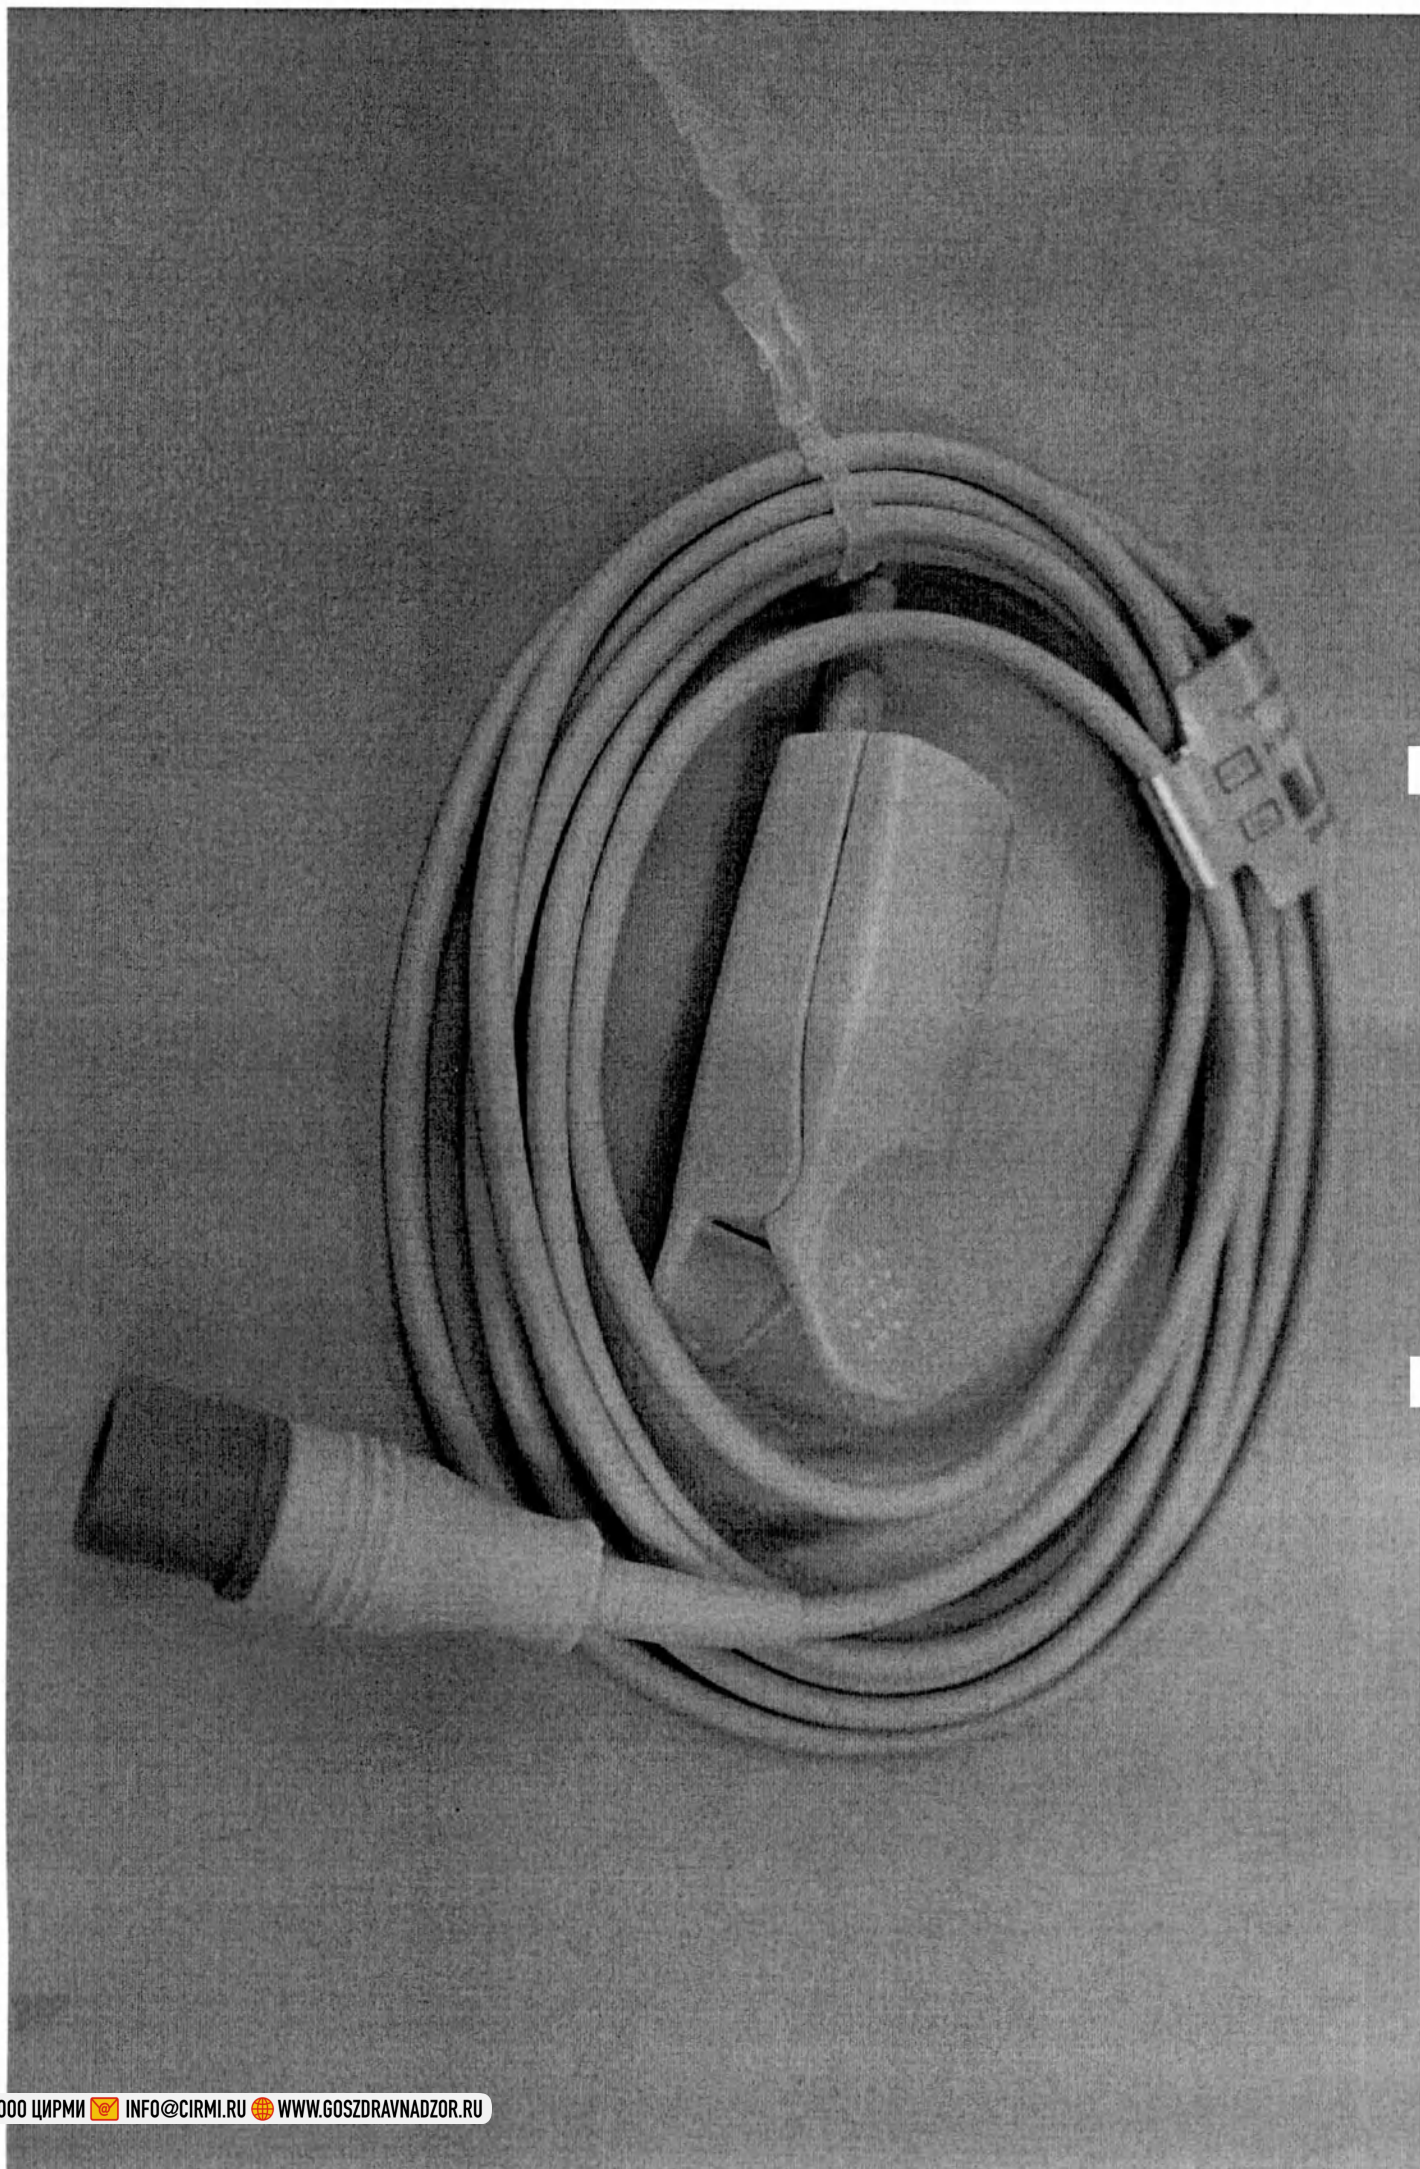


Датчики пульсоксиметрические НТМ с кабелем и разъемом, серии НТМ400S (в упаковке, с маркировкой)



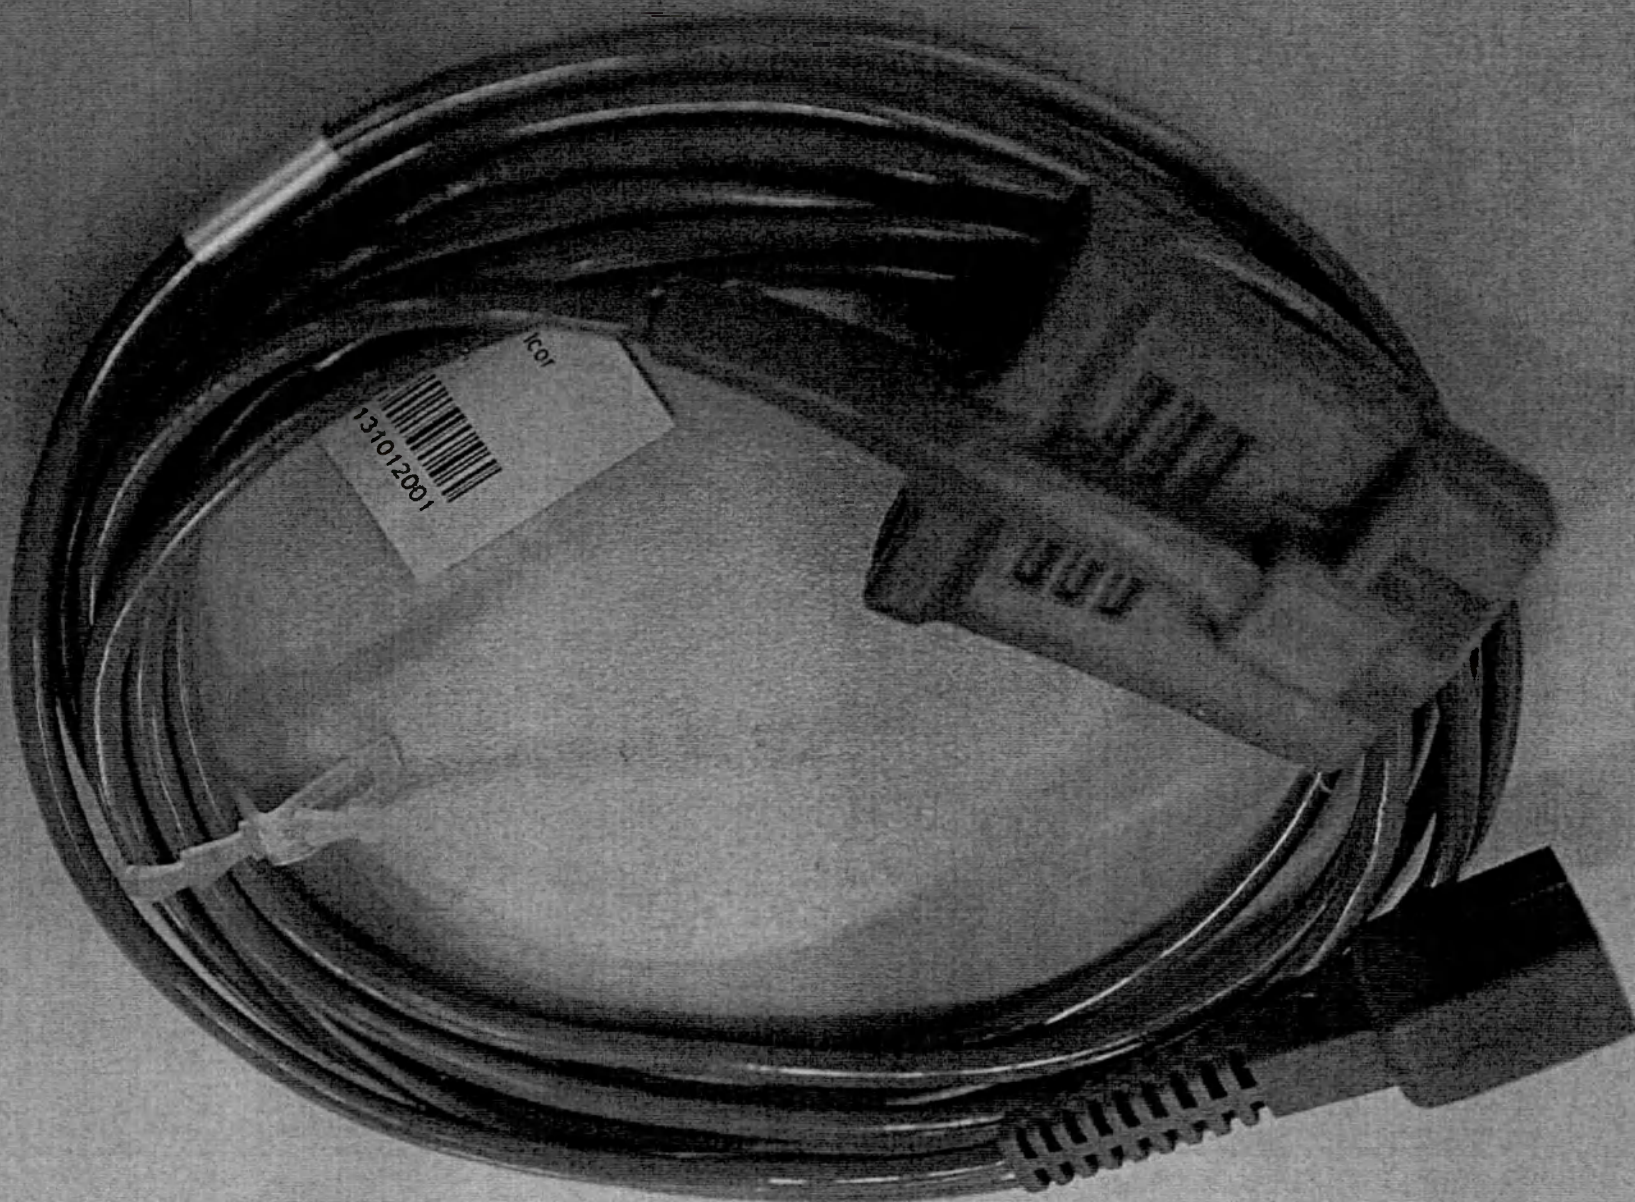


Датчики пульсоксиметрические НТМ с кабелем и разъемом, серии НТМ400В (в упаковке, с маркировкой)



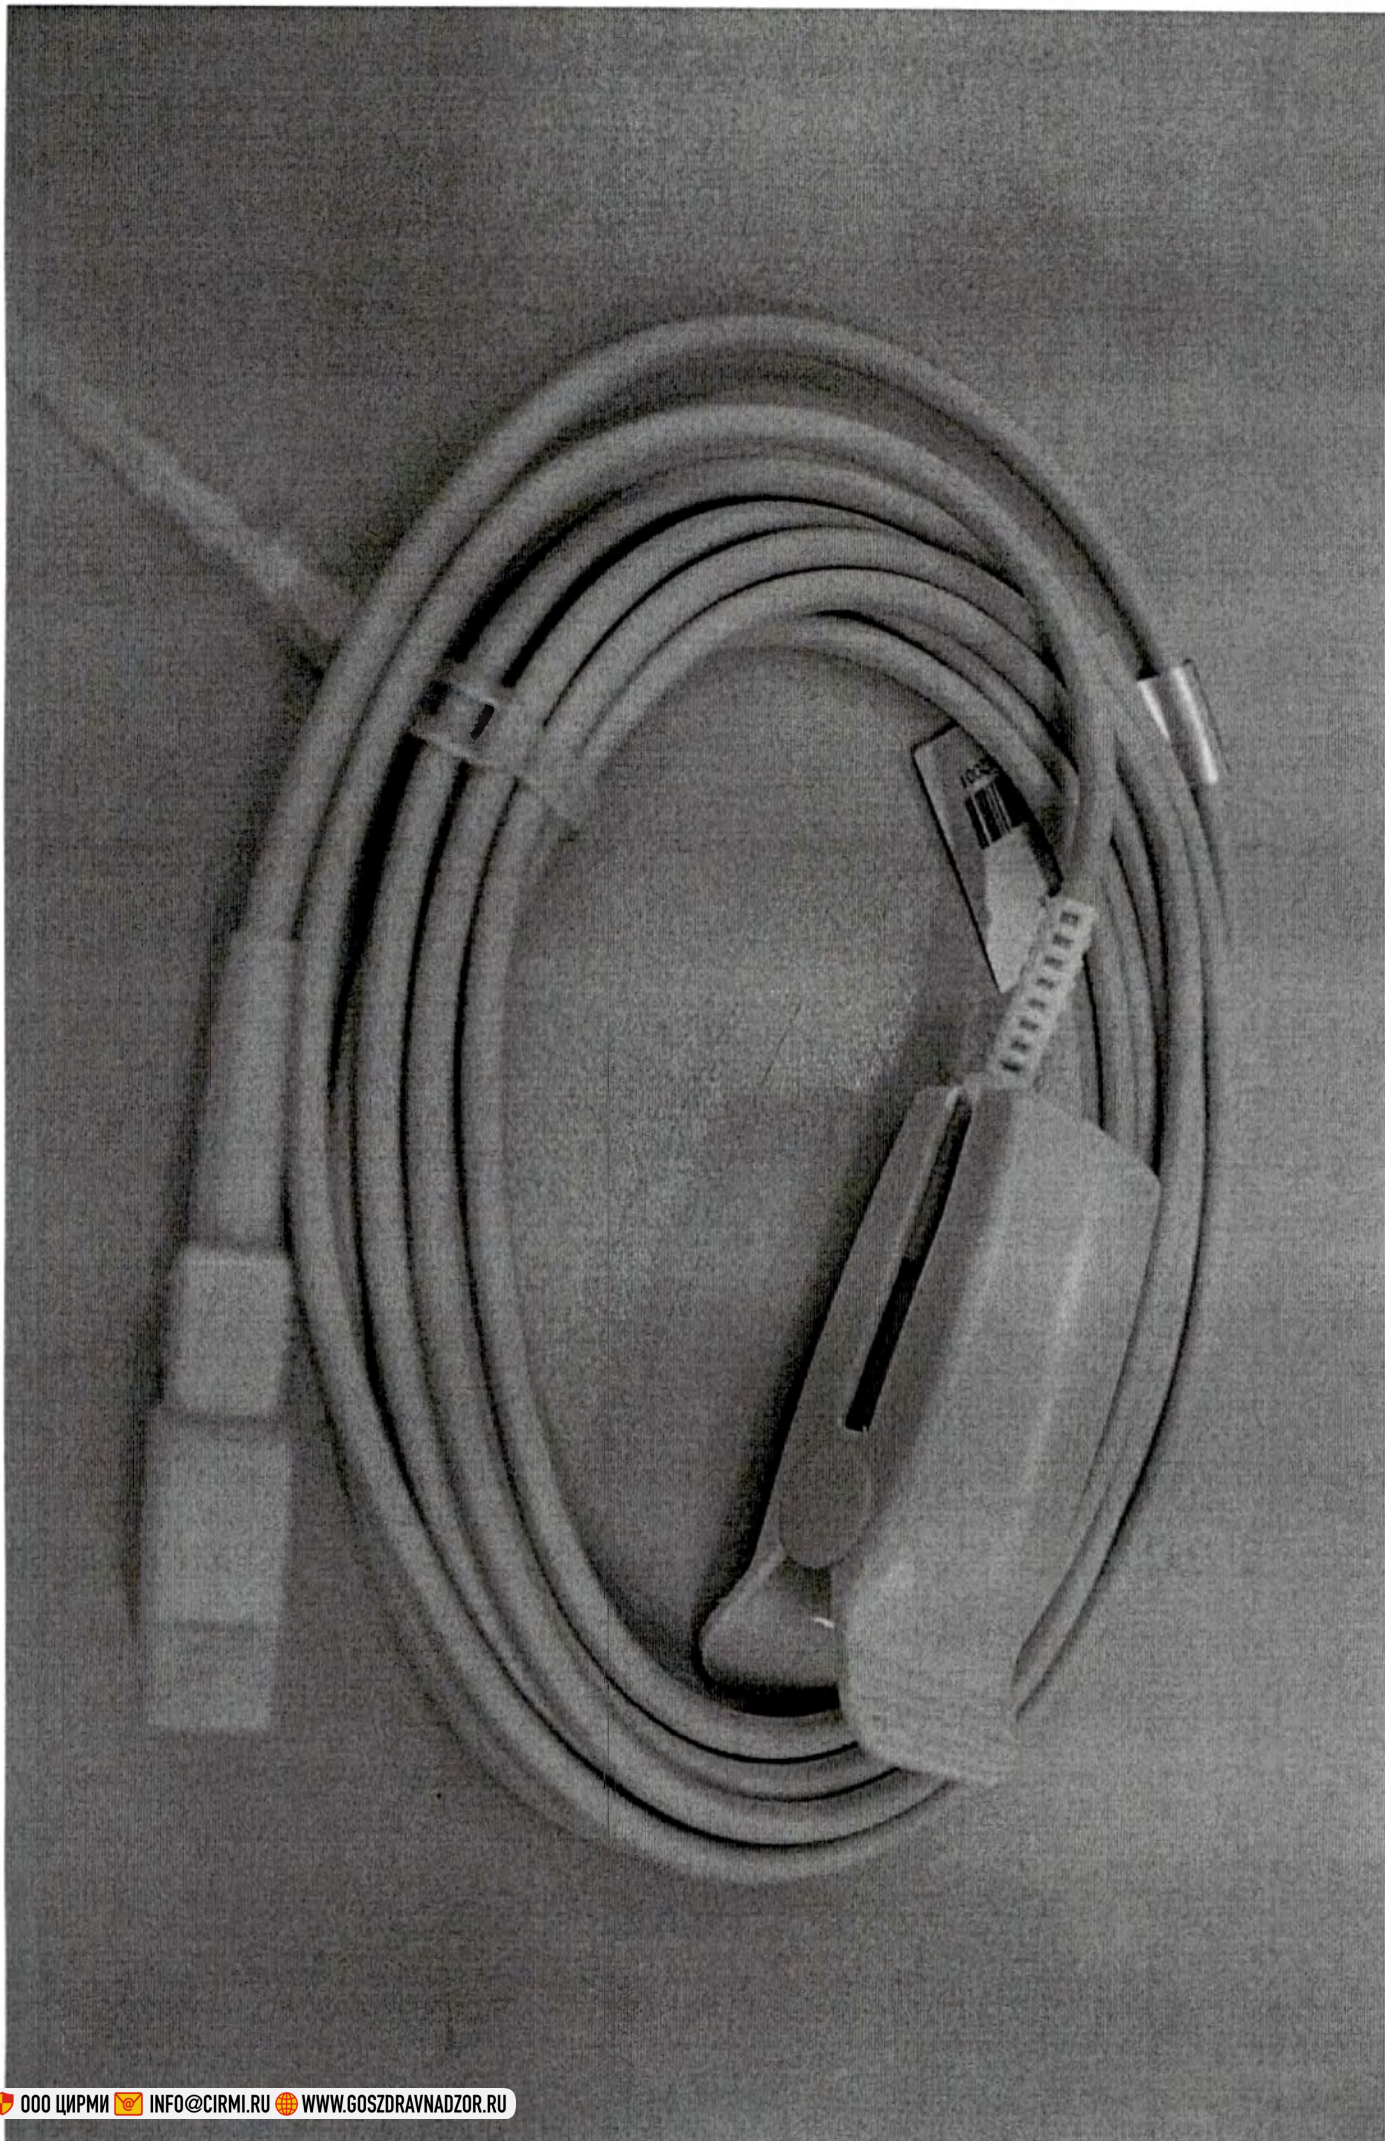

Датчики пульсоксиметрические НГ... с кабелем и разъемом, серии НТМ400Е (в упаковке, с маркировкой)



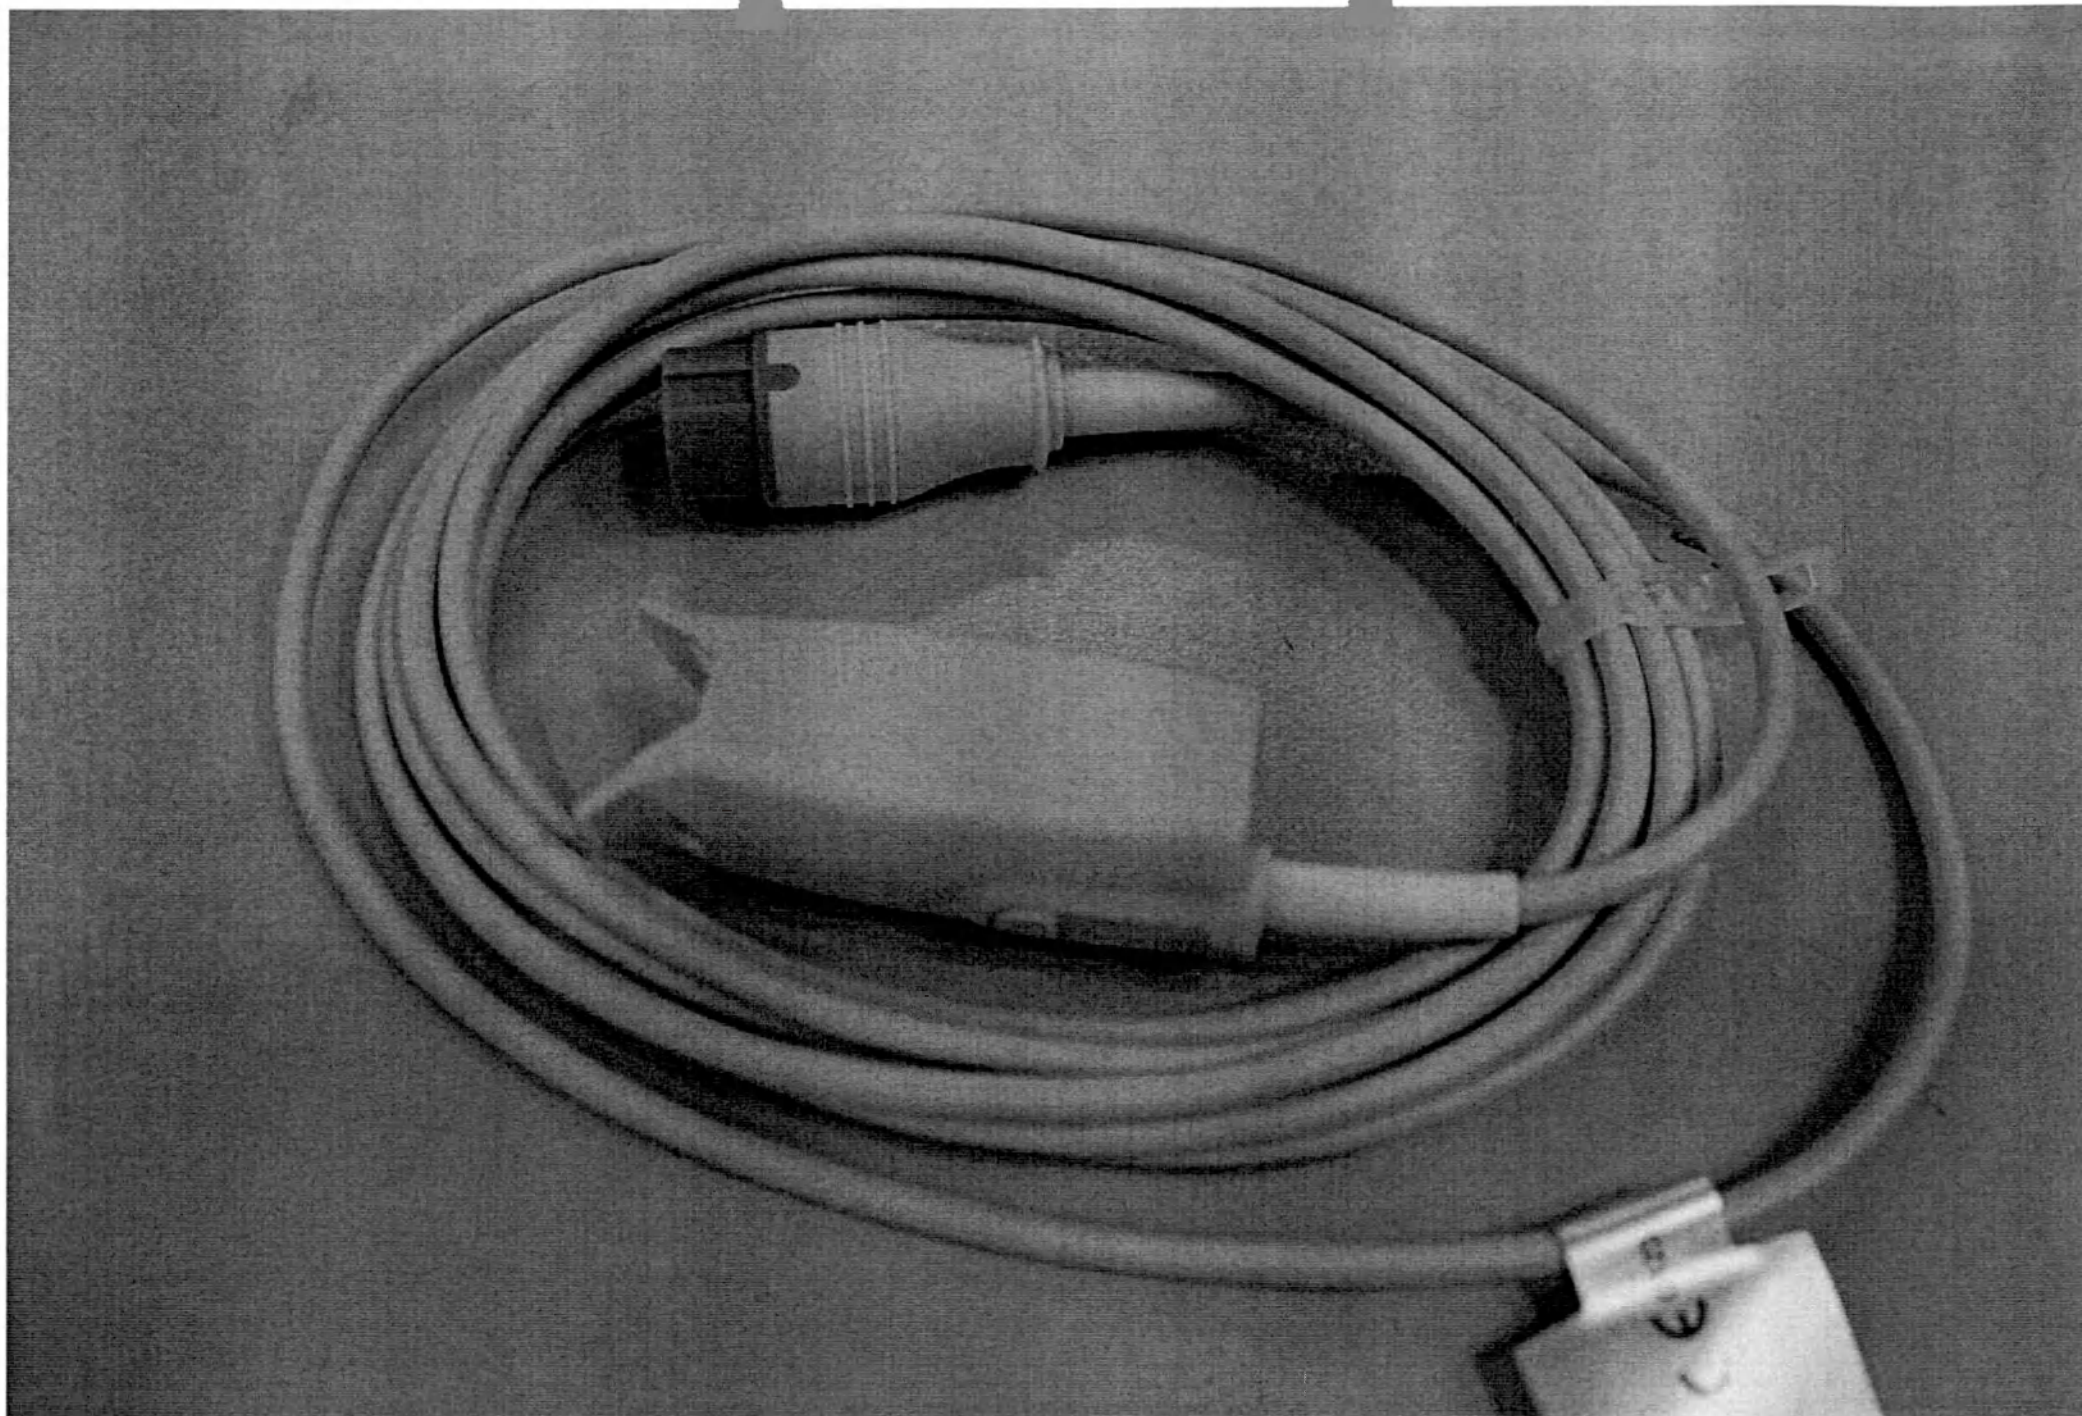

Unimed
medical supplies



SPO2
Sensor


Nellcor-Oximax Compatible

REF HTM500N-01

For Adult/Neonate

Non-Adhesive, 0.9m cable length

LOT

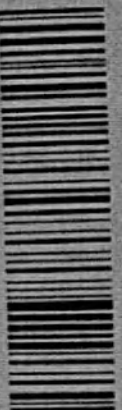

2914320003131011117

20131017

20181017



>30Kg

OR

<3kg



Single patient use



See directions for use



Lactex free



Non-sterile

Sensor adaptor may be required upto the pulse oximeters being used with. The adaptor cable need to be purchased separately.

CAUTION:
Federal (U.S.) Law restricts this device to sale by or on the order of a physician.



Unimed medical supplies Inc

No.37, Yanchan road, Shekou, Shenzhen, Guangdong,

China 518067




GERANWETS

Rua José Rodriguesrigues Miguel, 2870-466 Montijo Portugal

Y06-HQ12

CE 0123

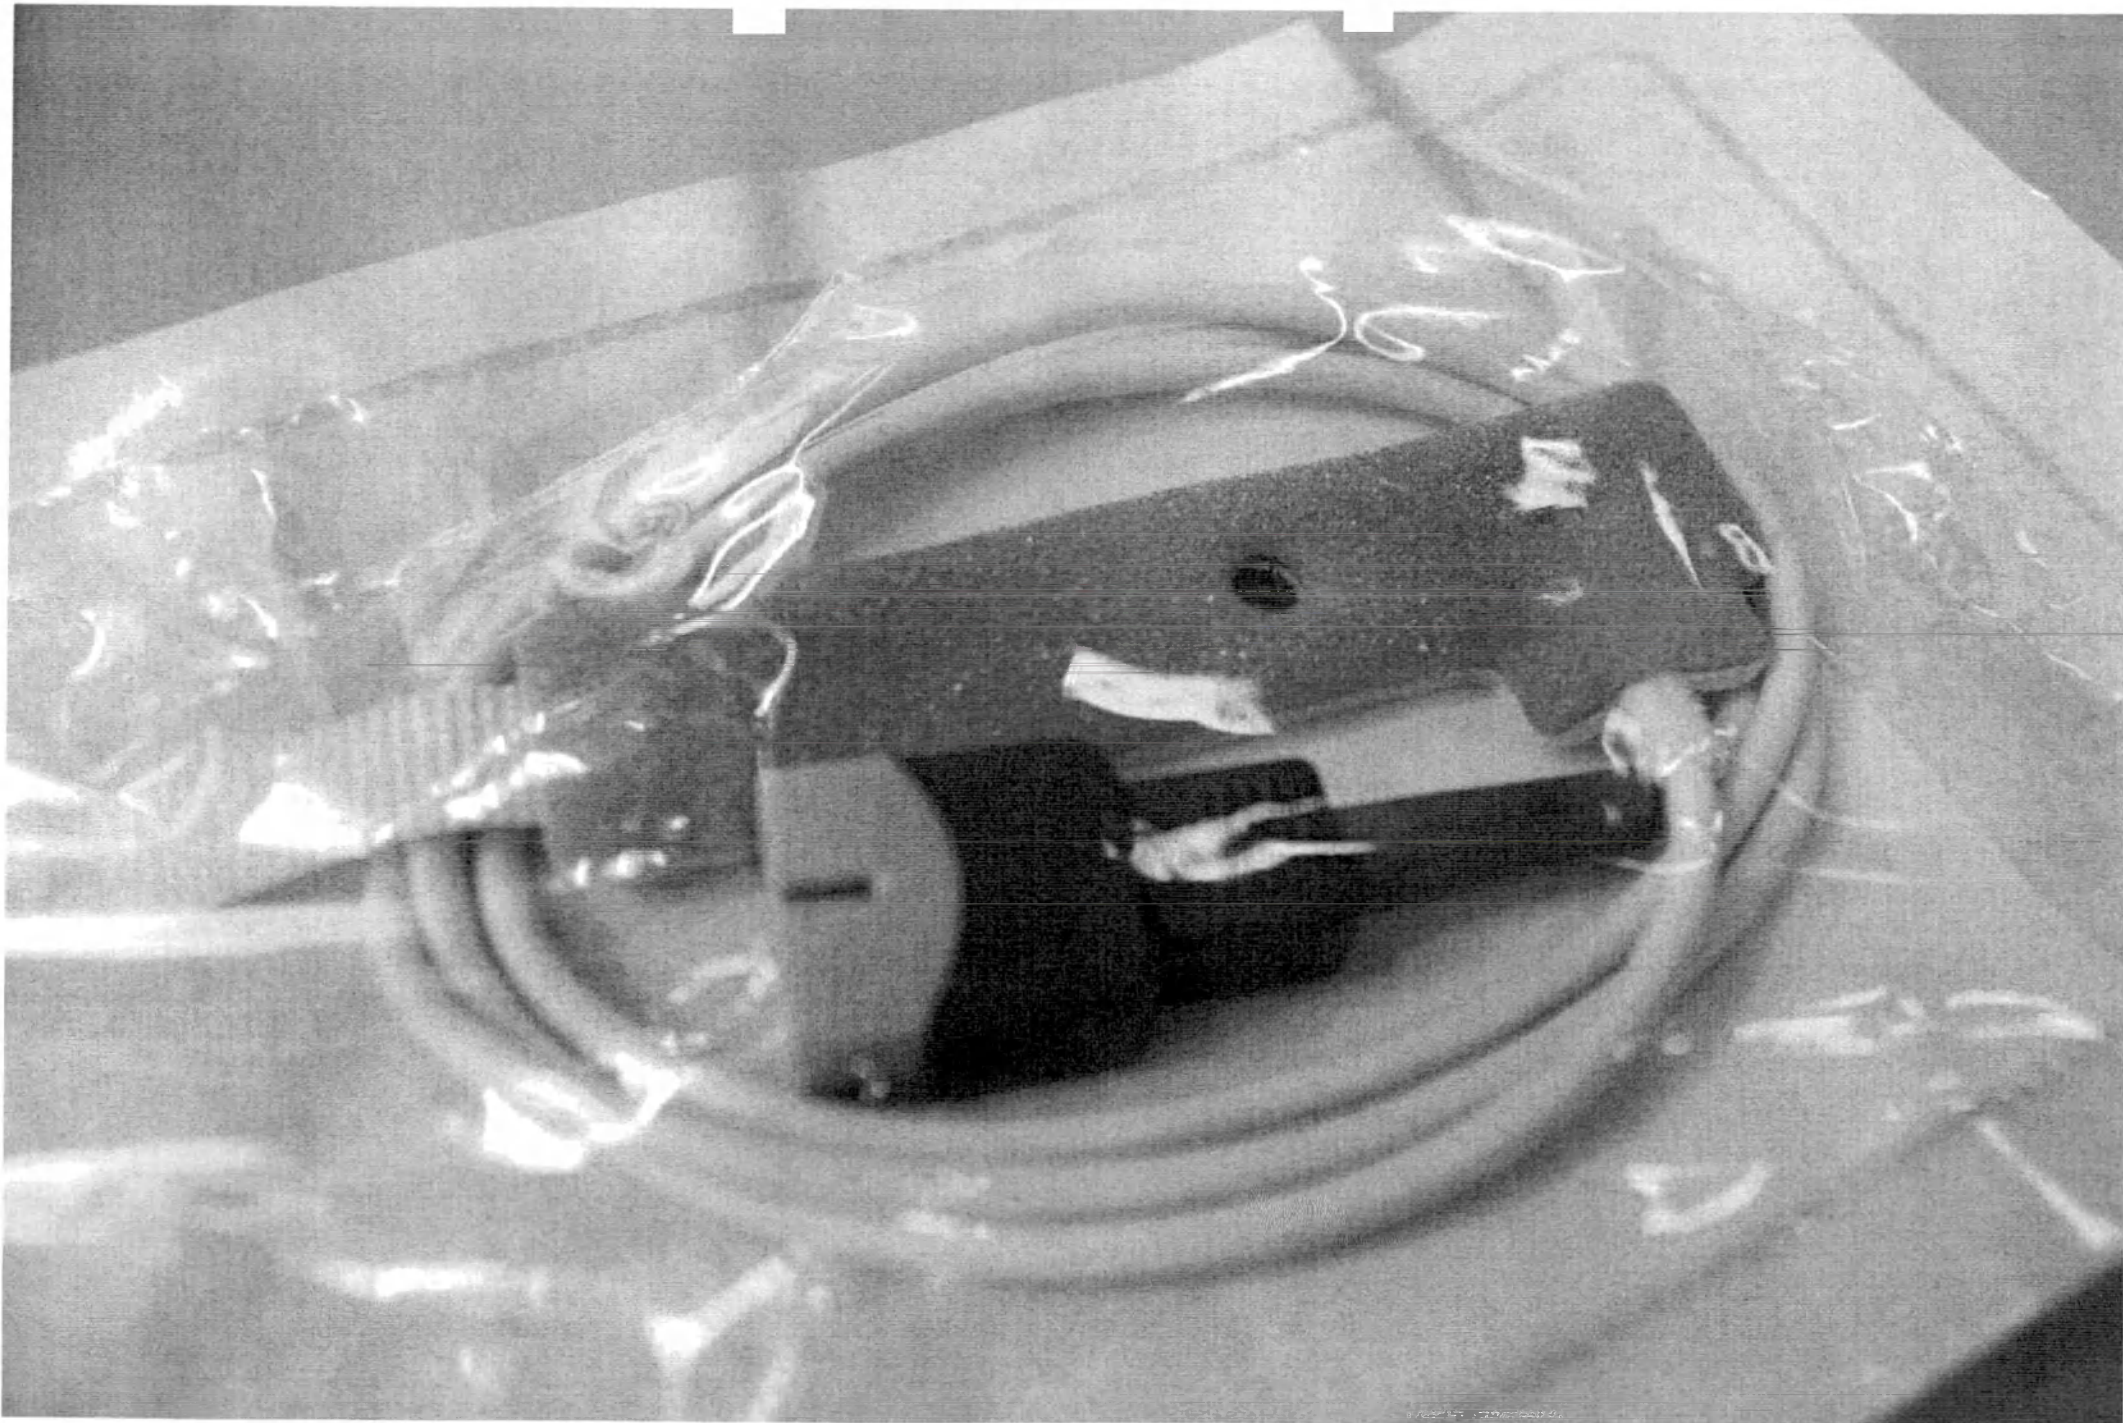

Датчики пульсоксиметрические НТ₁ с кабелем и разъемом, серии НТМ500U (в упаковке, с маркировкой)





Датчики пульсоксиметрические НТМ с кабелем и разъемом, серии НТМ500F (в упаковке, с маркировкой)

unimed
medical supplies



SPO2
Sensor

Nellcor-OxiMax Compatible

REF НТМ500F-01


For Pediatric


10-50Kg



Adhesive Foam, 0.9m cable length

LOT


2914320006131012143

 20131017

 20161017

Single patient use

 Latex free

 Non-adhesive

 See directions for use

CAUTION:
Sensor adaptor may be required upto the pulse oximeters being used with. The adaptor cable need to be purchased separately.
Federal (U.S.) Law restricts this device to sale by or on the order of a physician.



Unimed medical supplies Inc
No. 37, Yanshan road, Shenzhen, Guangdong,
China 518067

EC
REP

Getapsweta
Rua Jose Rodriguesrigues Miguel, N.º111, 2875-466 Monte Portugal


Y01-F022

CE 0123

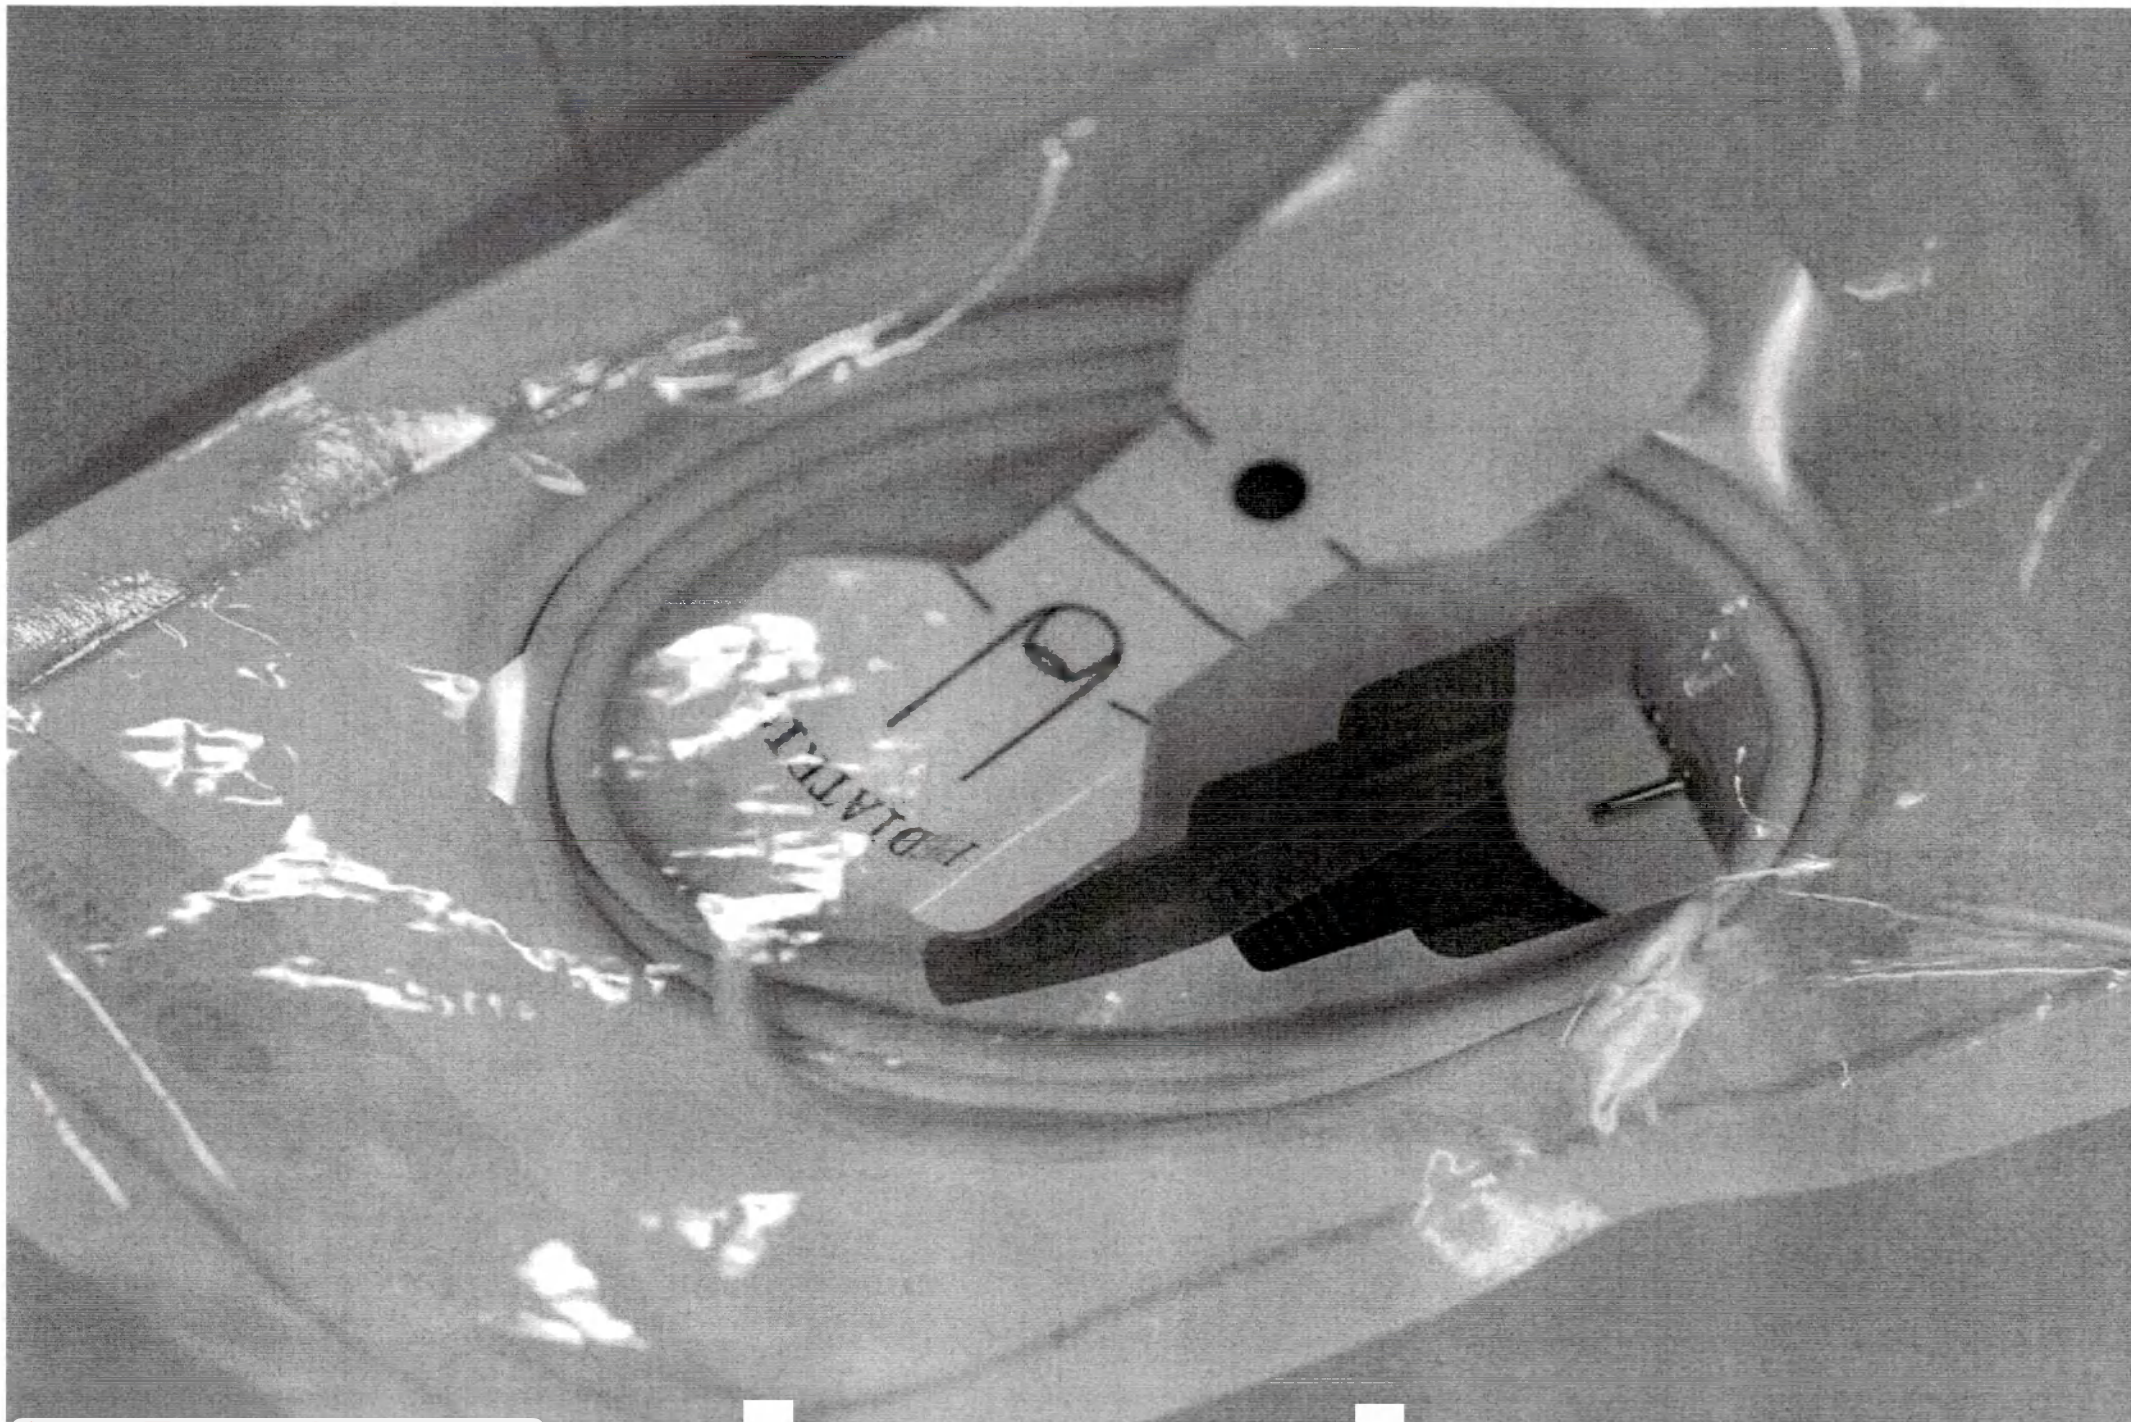


Датчики пульсоксиметрические Н.М с кабелем и разъемом, серии HTM600 (в упаковке, с маркировкой)



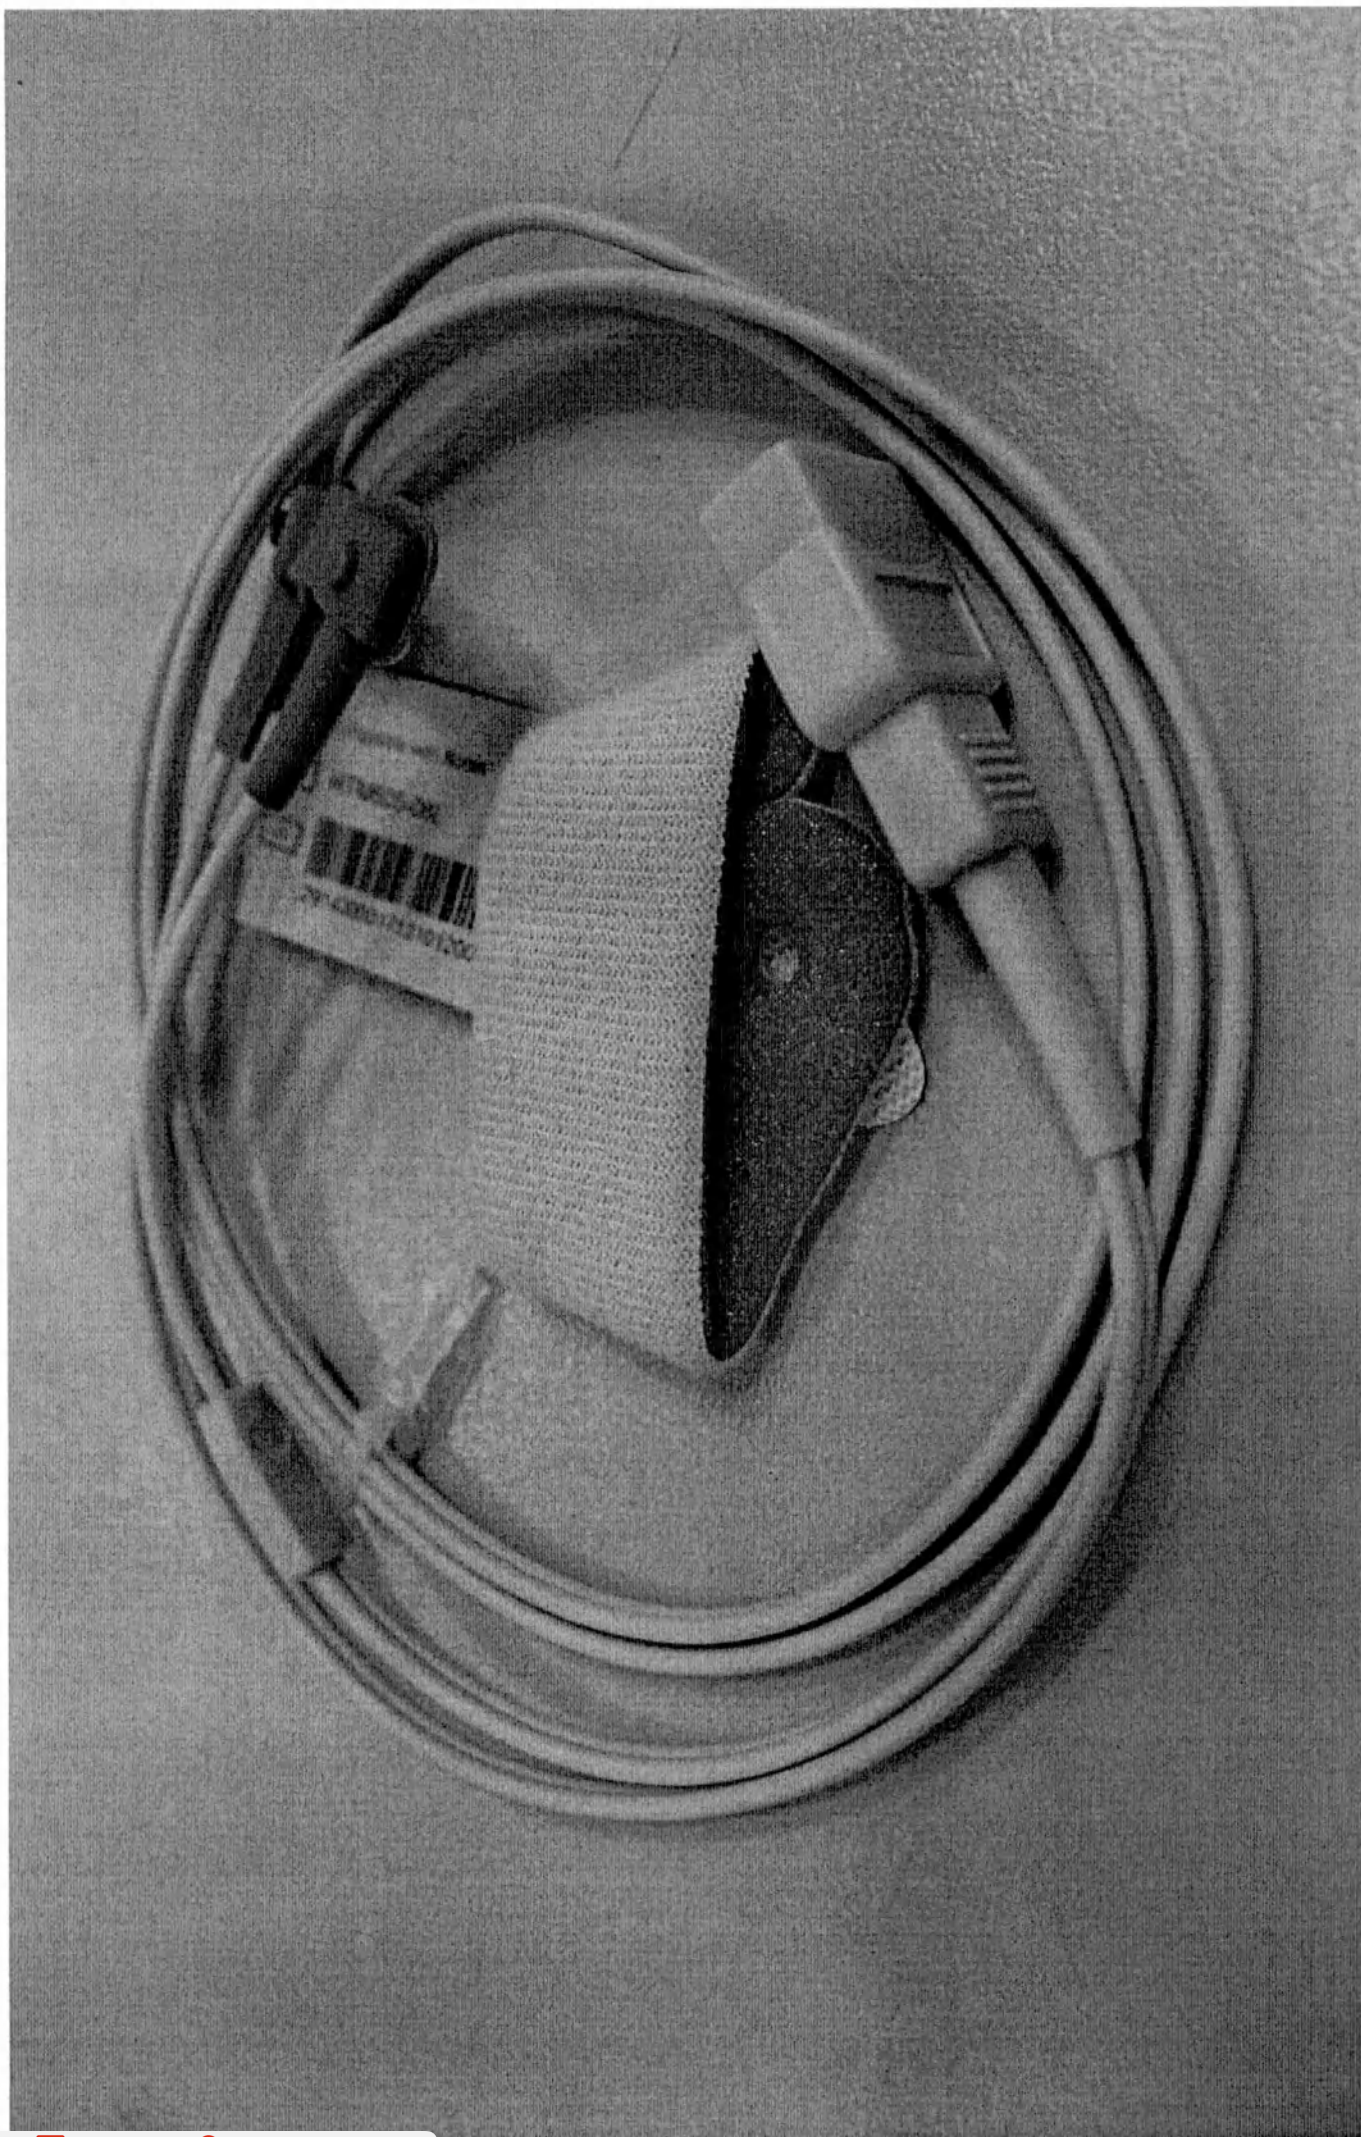


Датчики пульсоксиметрические НТМ с кабелем и разъемом, серии НТМ600В (в упаковке, с маркировкой)



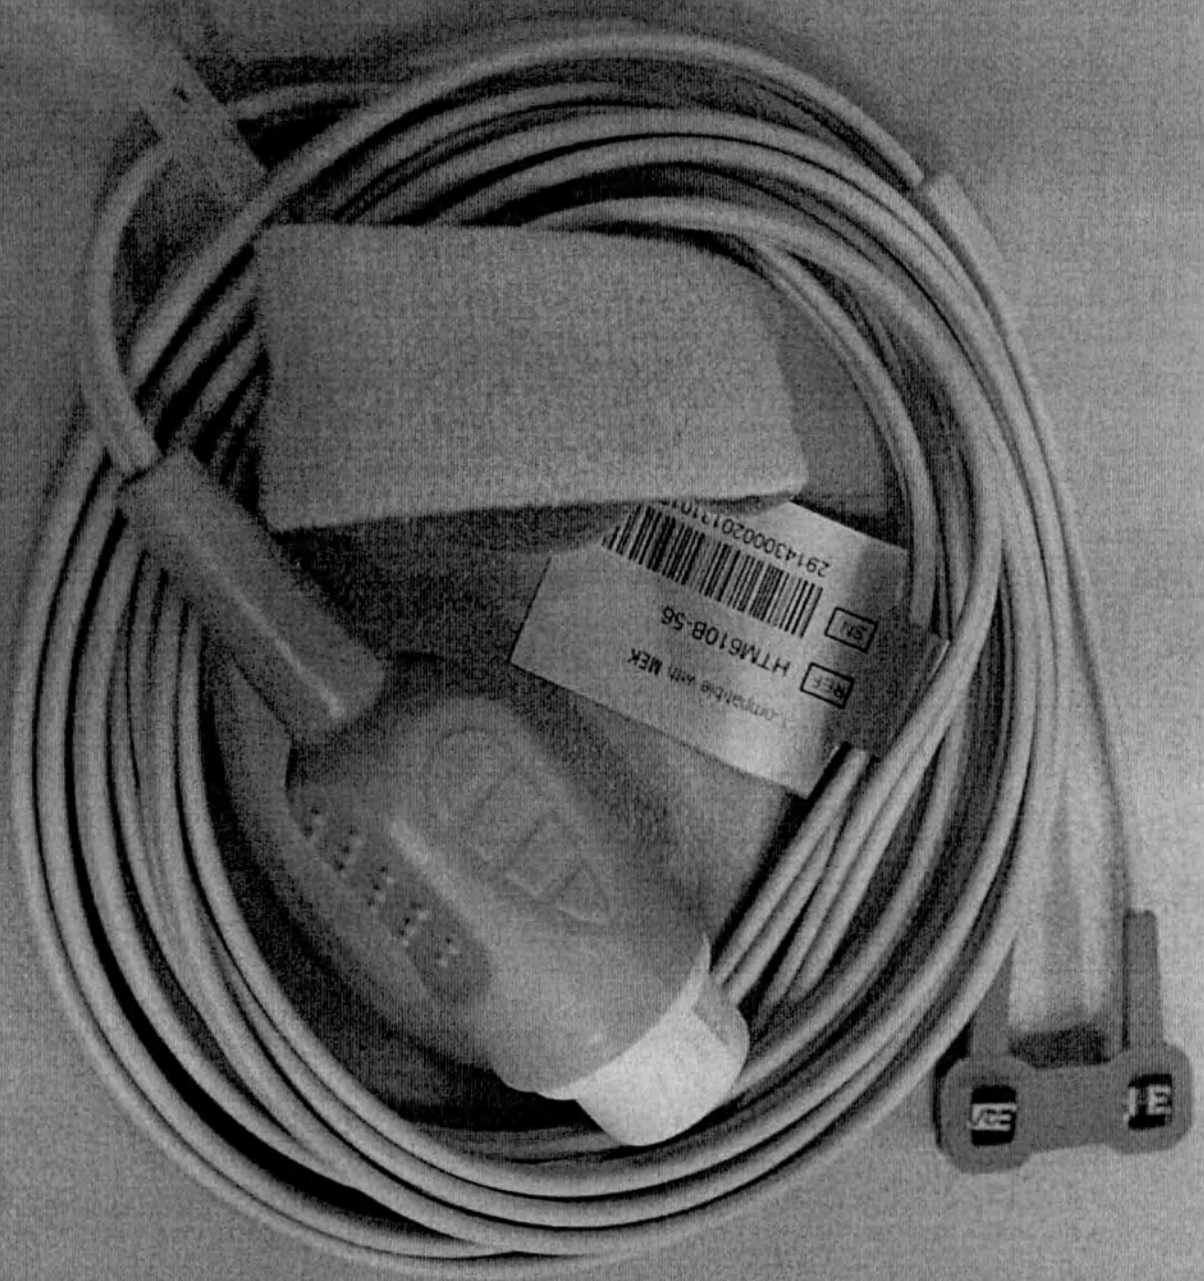


Датчики пульсоксиметрические Н.М с кабелем и разъемом, серии НТМ800 (в упаковке, с маркировкой)



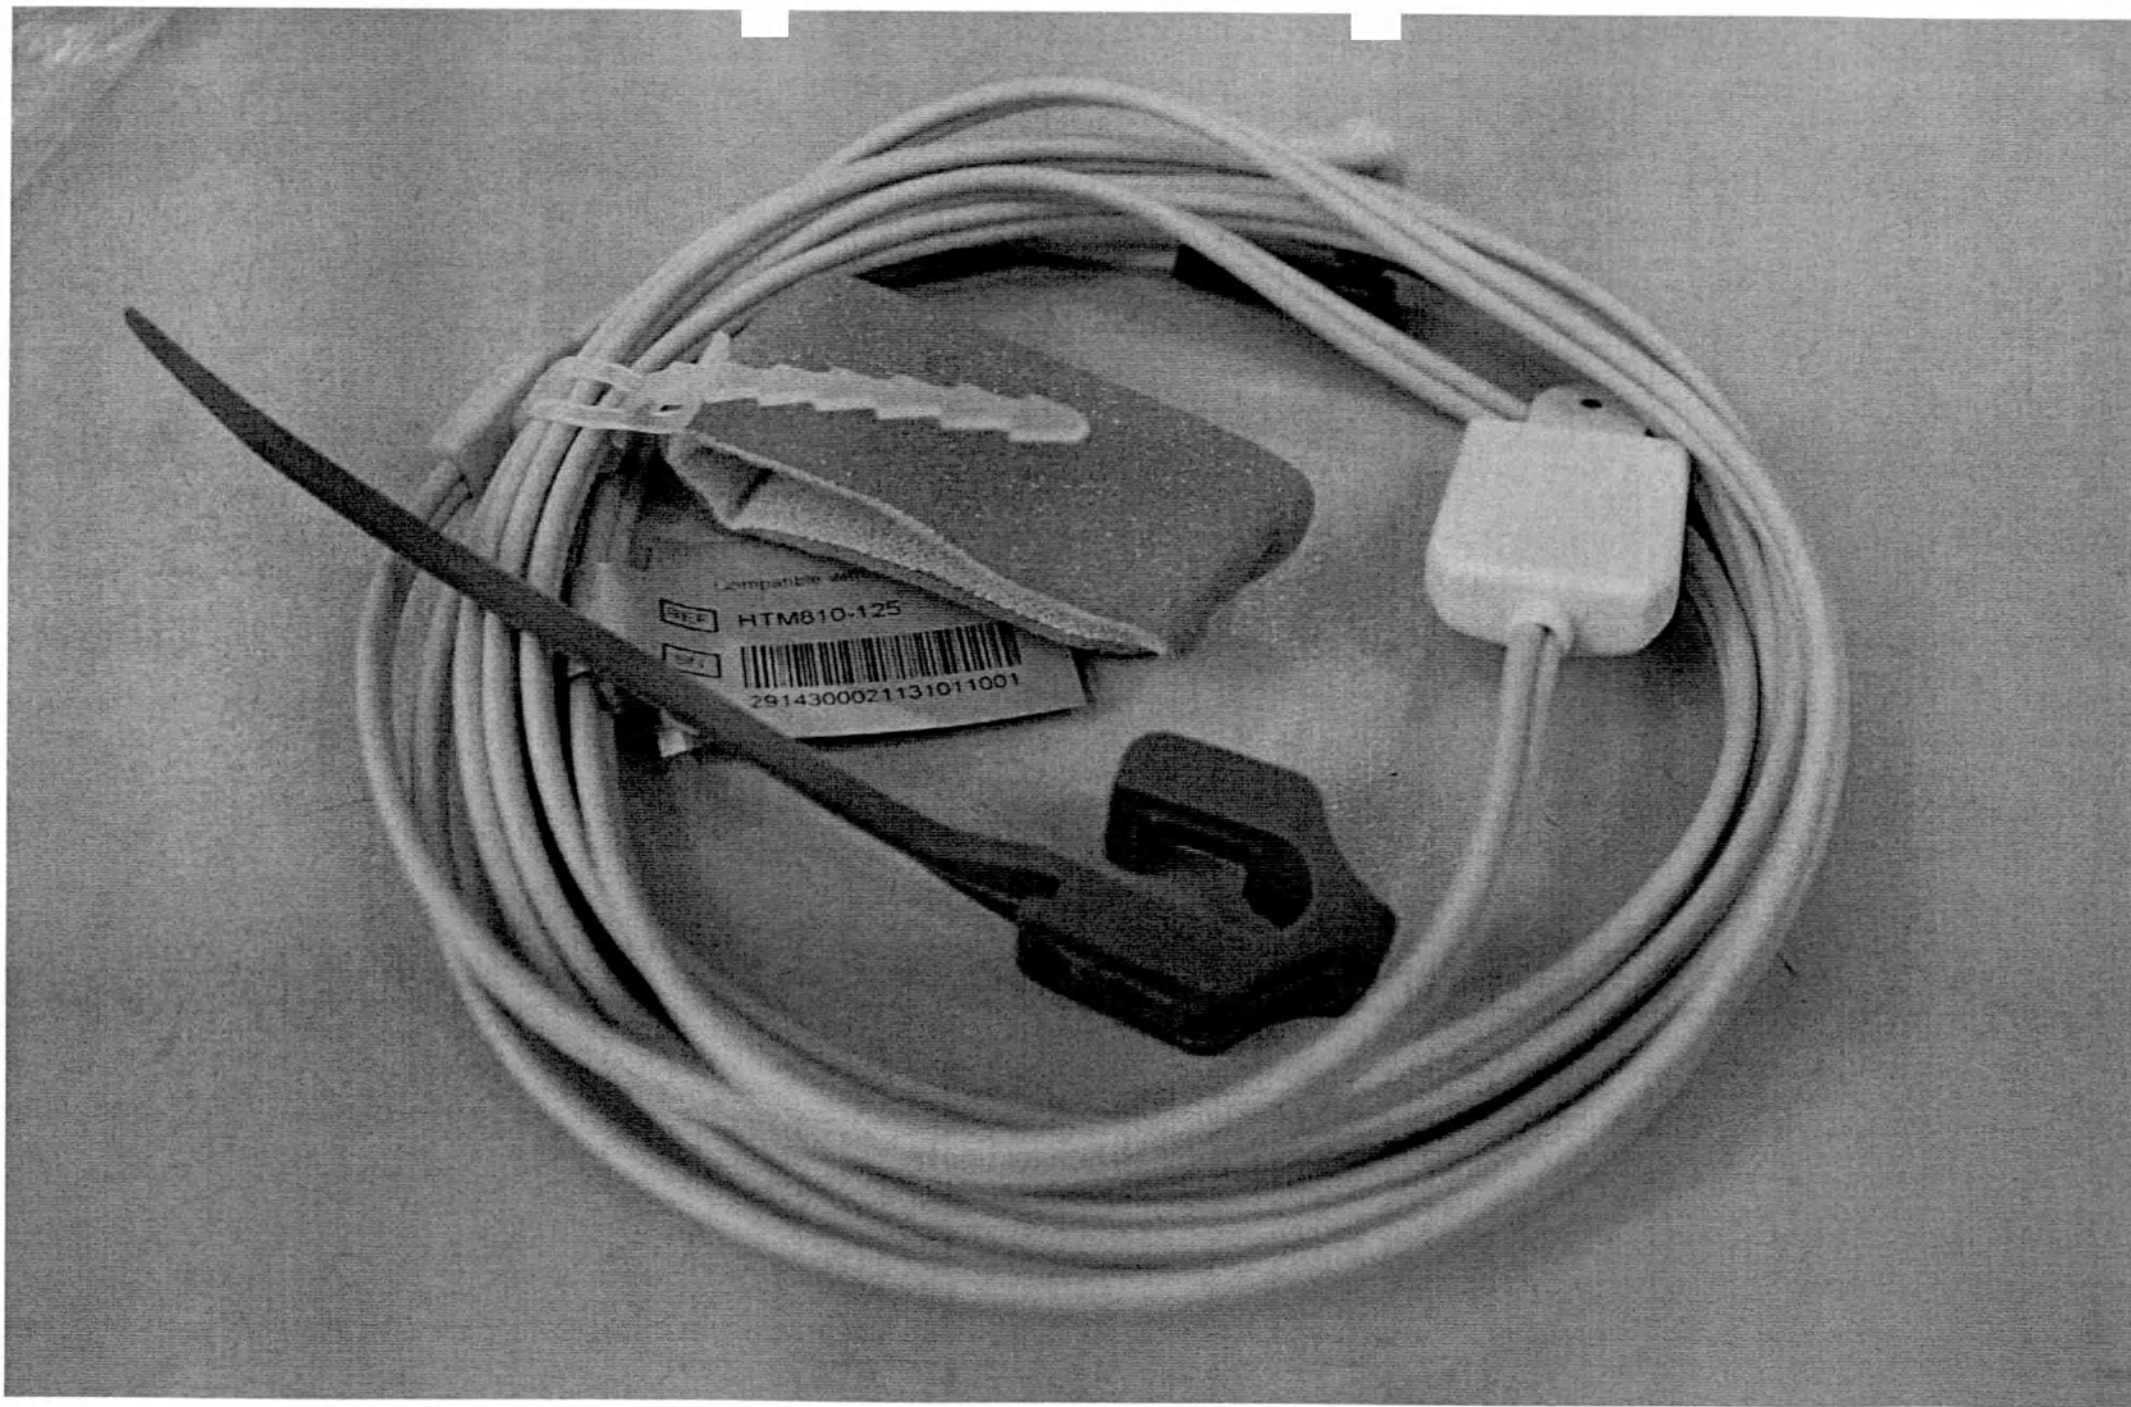


Датчики пульсоксиметрические НТМ с кабелем и разъемом, серии НТМ800Е (в упаковке, с маркировкой)



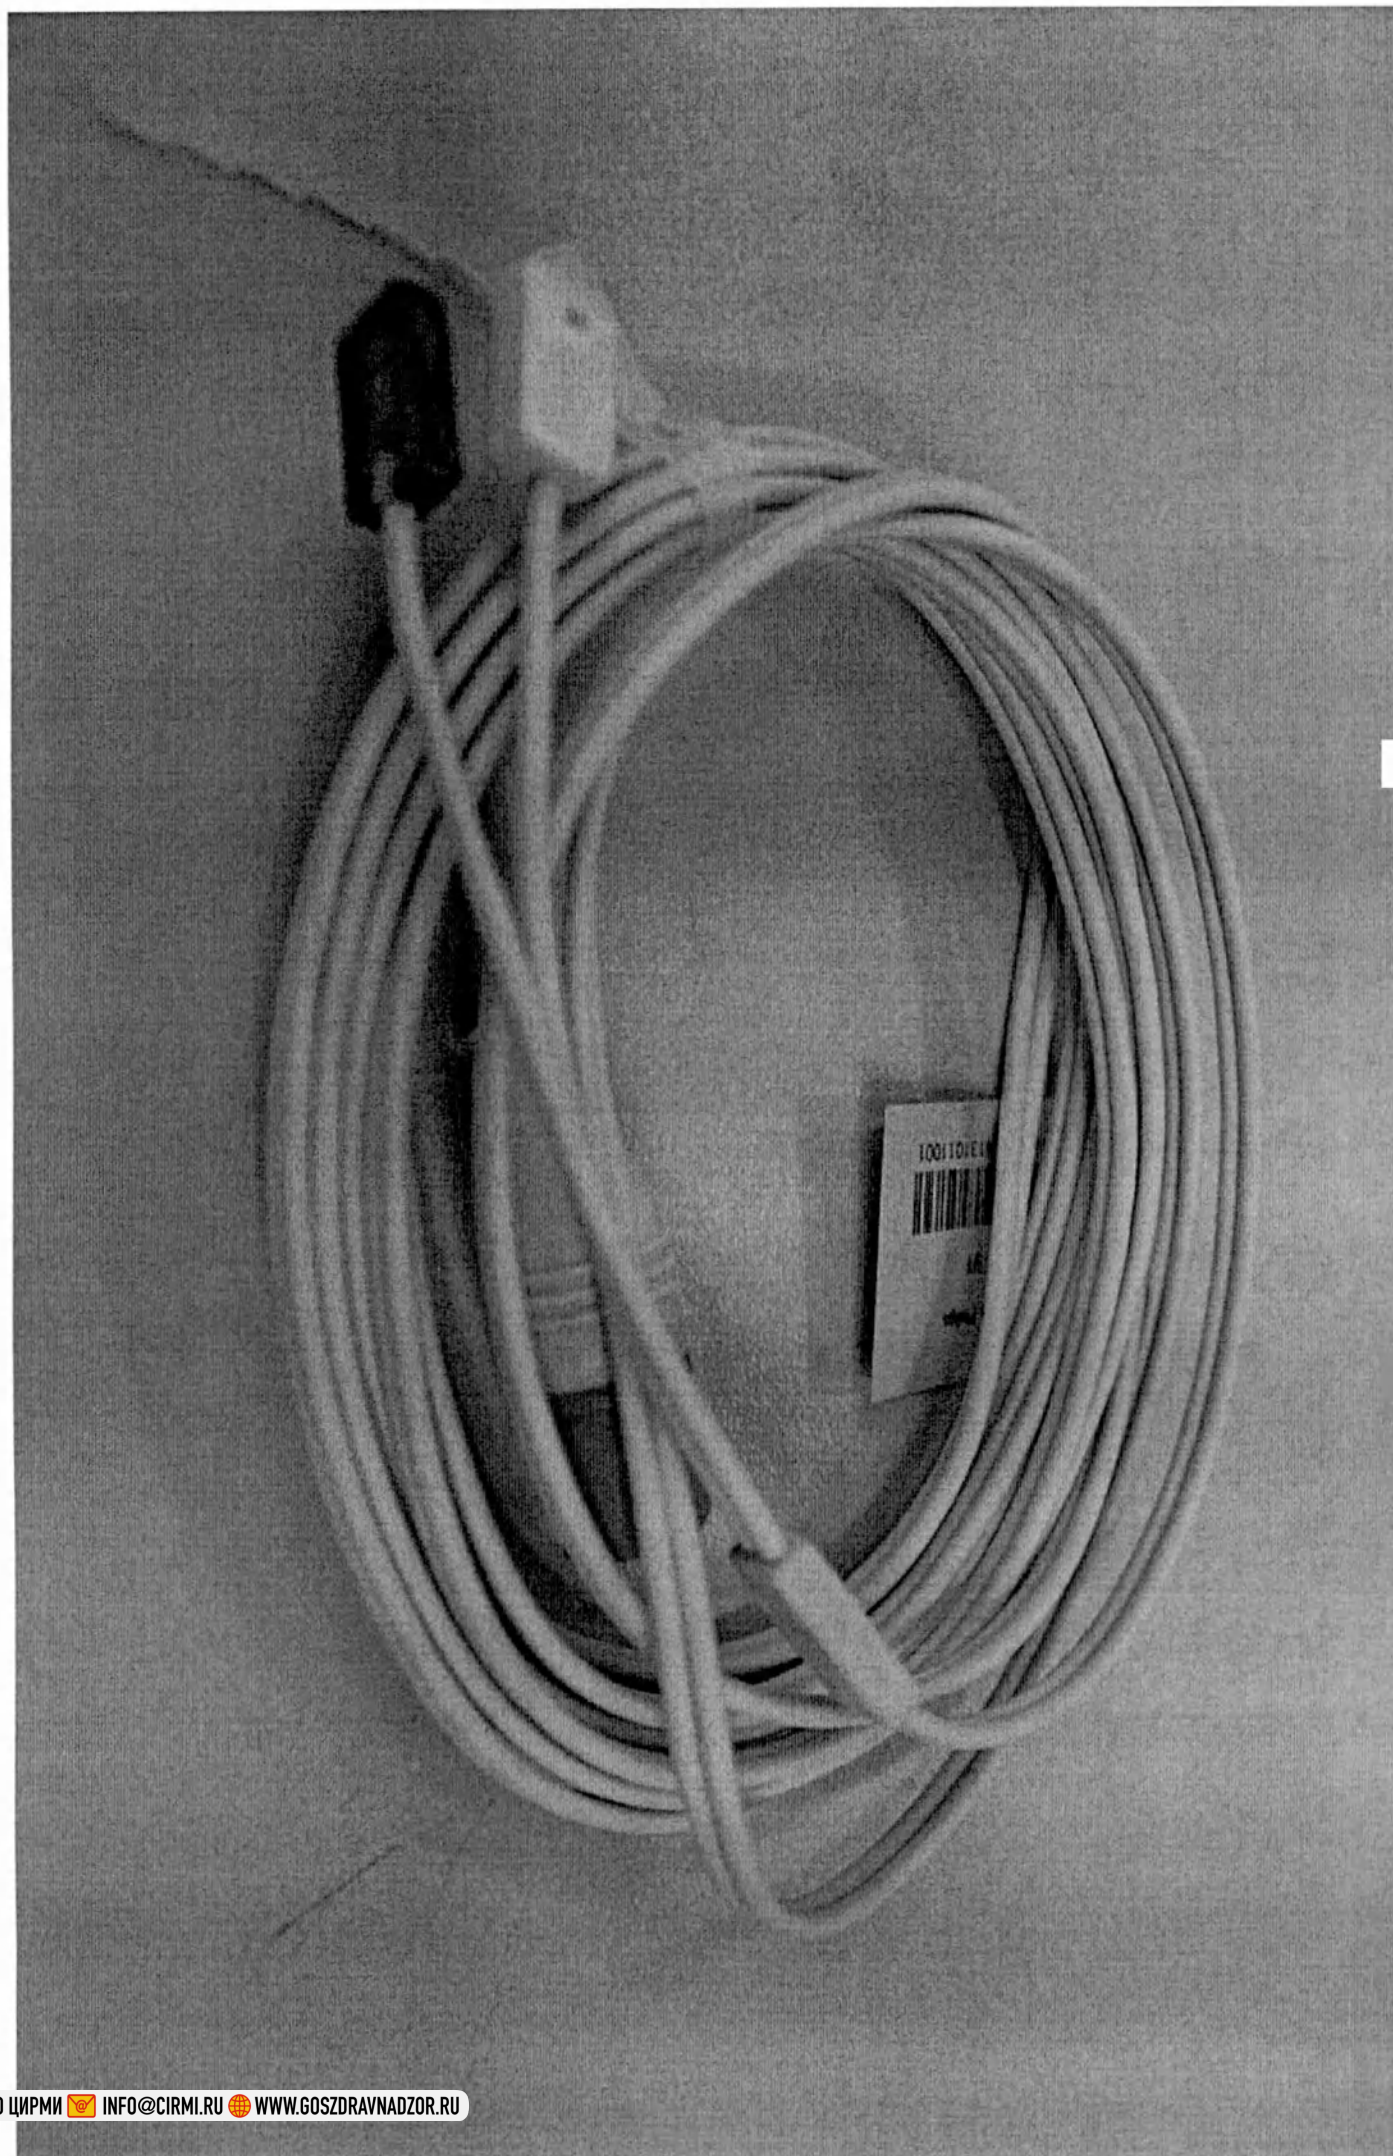

Датчики пульсоксиметрические НТМ с кабелем и разъемом, серии НТМ800V (в упаковке, с маркировкой)



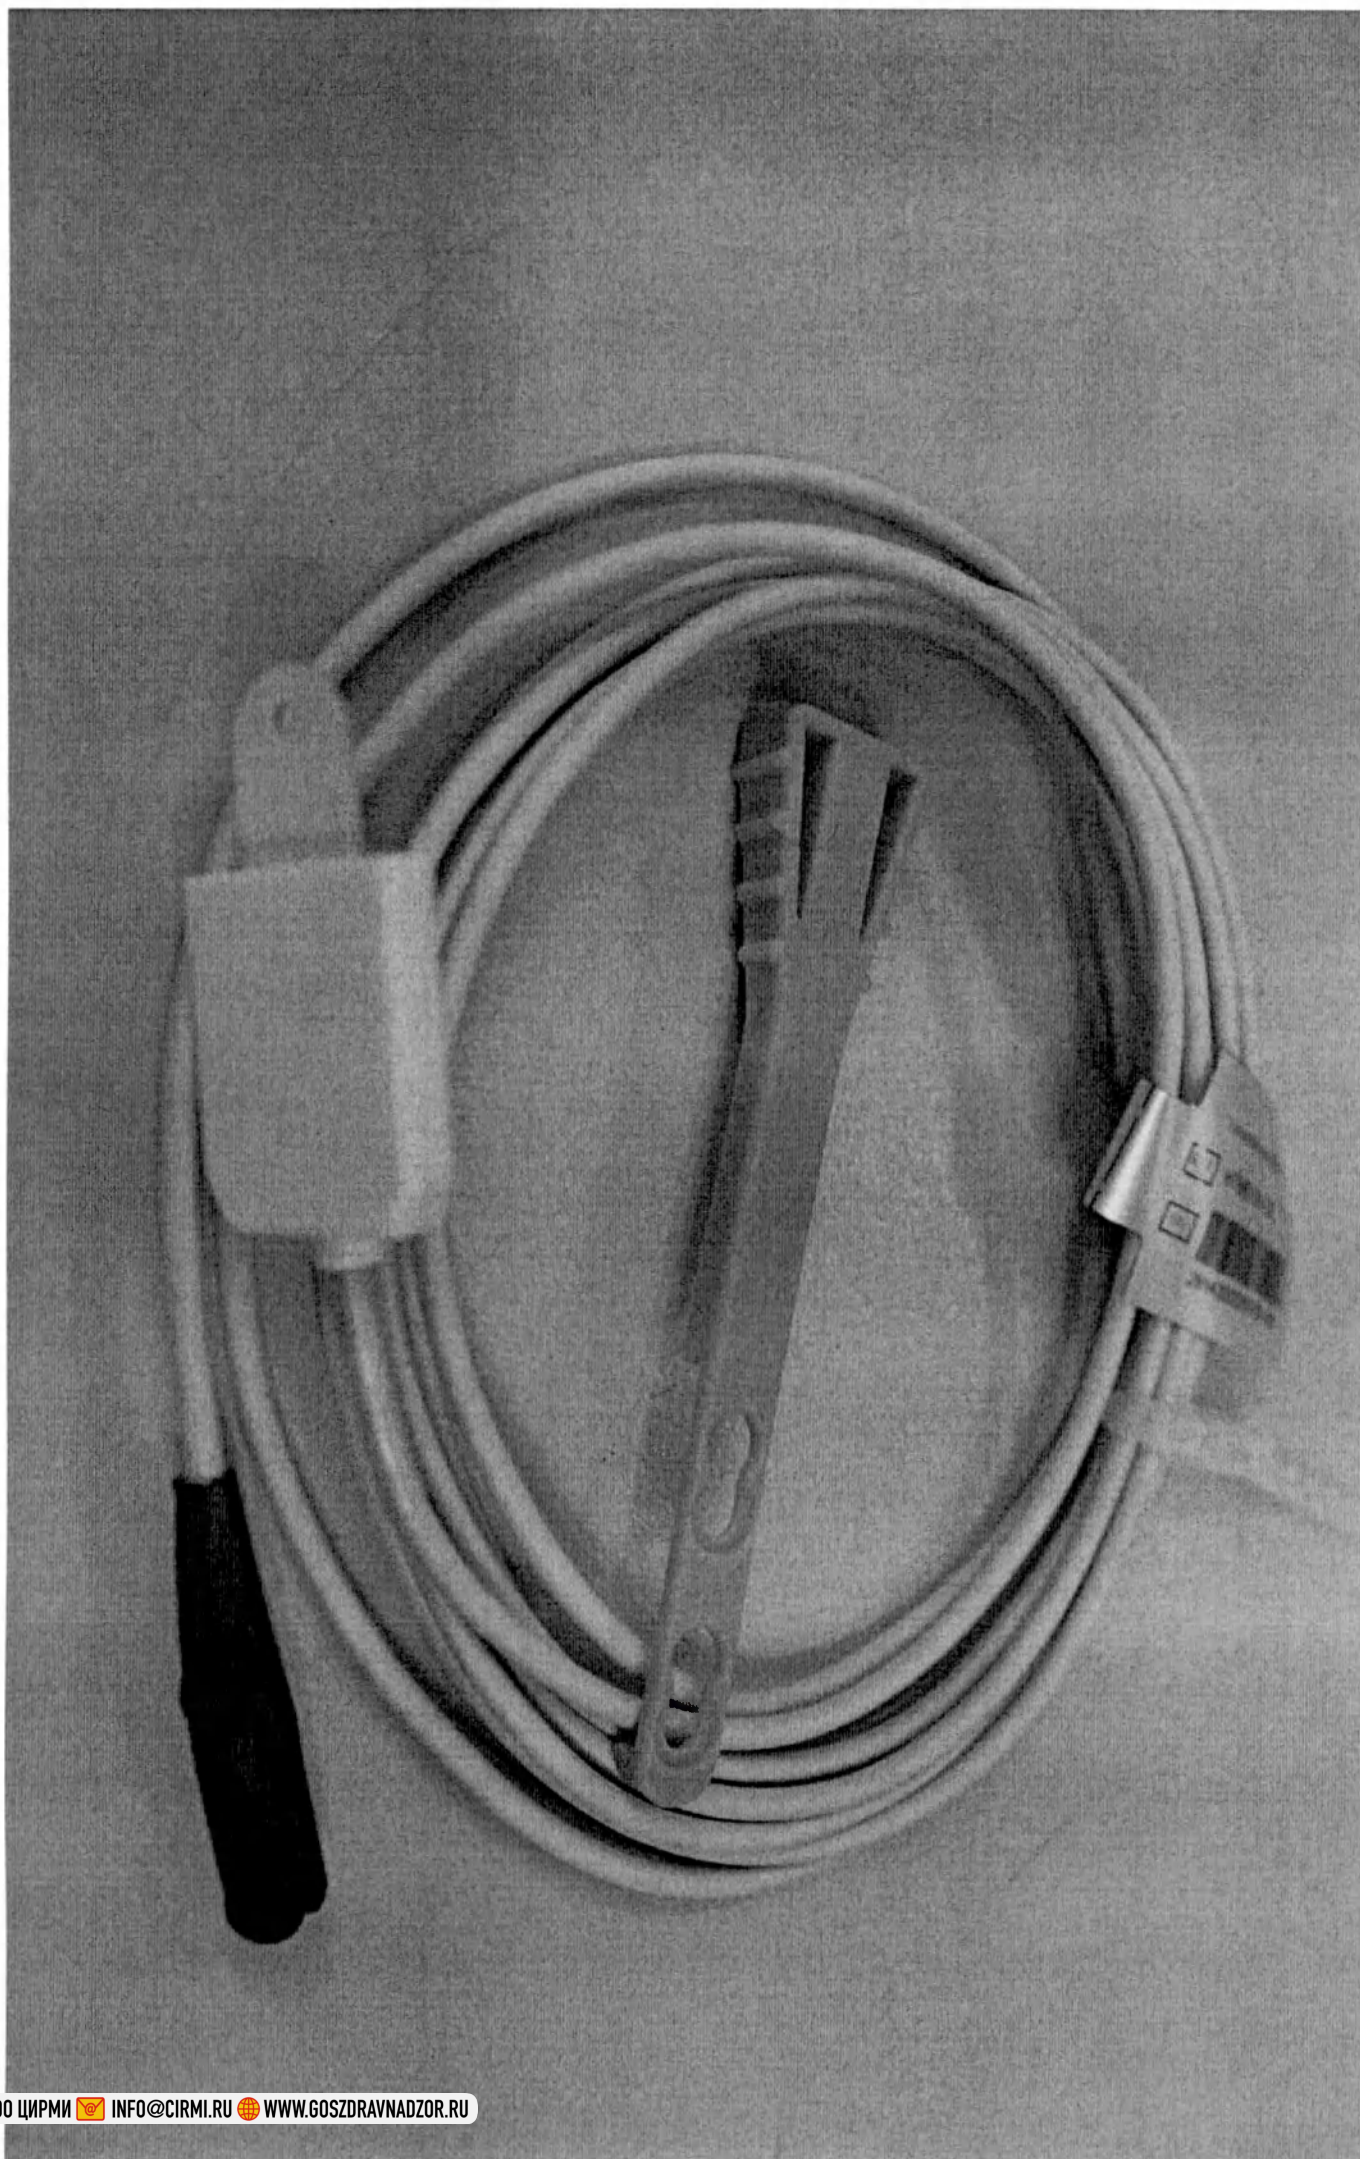

Датчики пульсоксиметрические НТМ с кабелем и разъемом, серии НТМ900 (в упаковке, с маркировкой)






Принадлежности:

1. Кабели-переходники удлинительные серии HTM700 (в упаковке, с маркировкой)




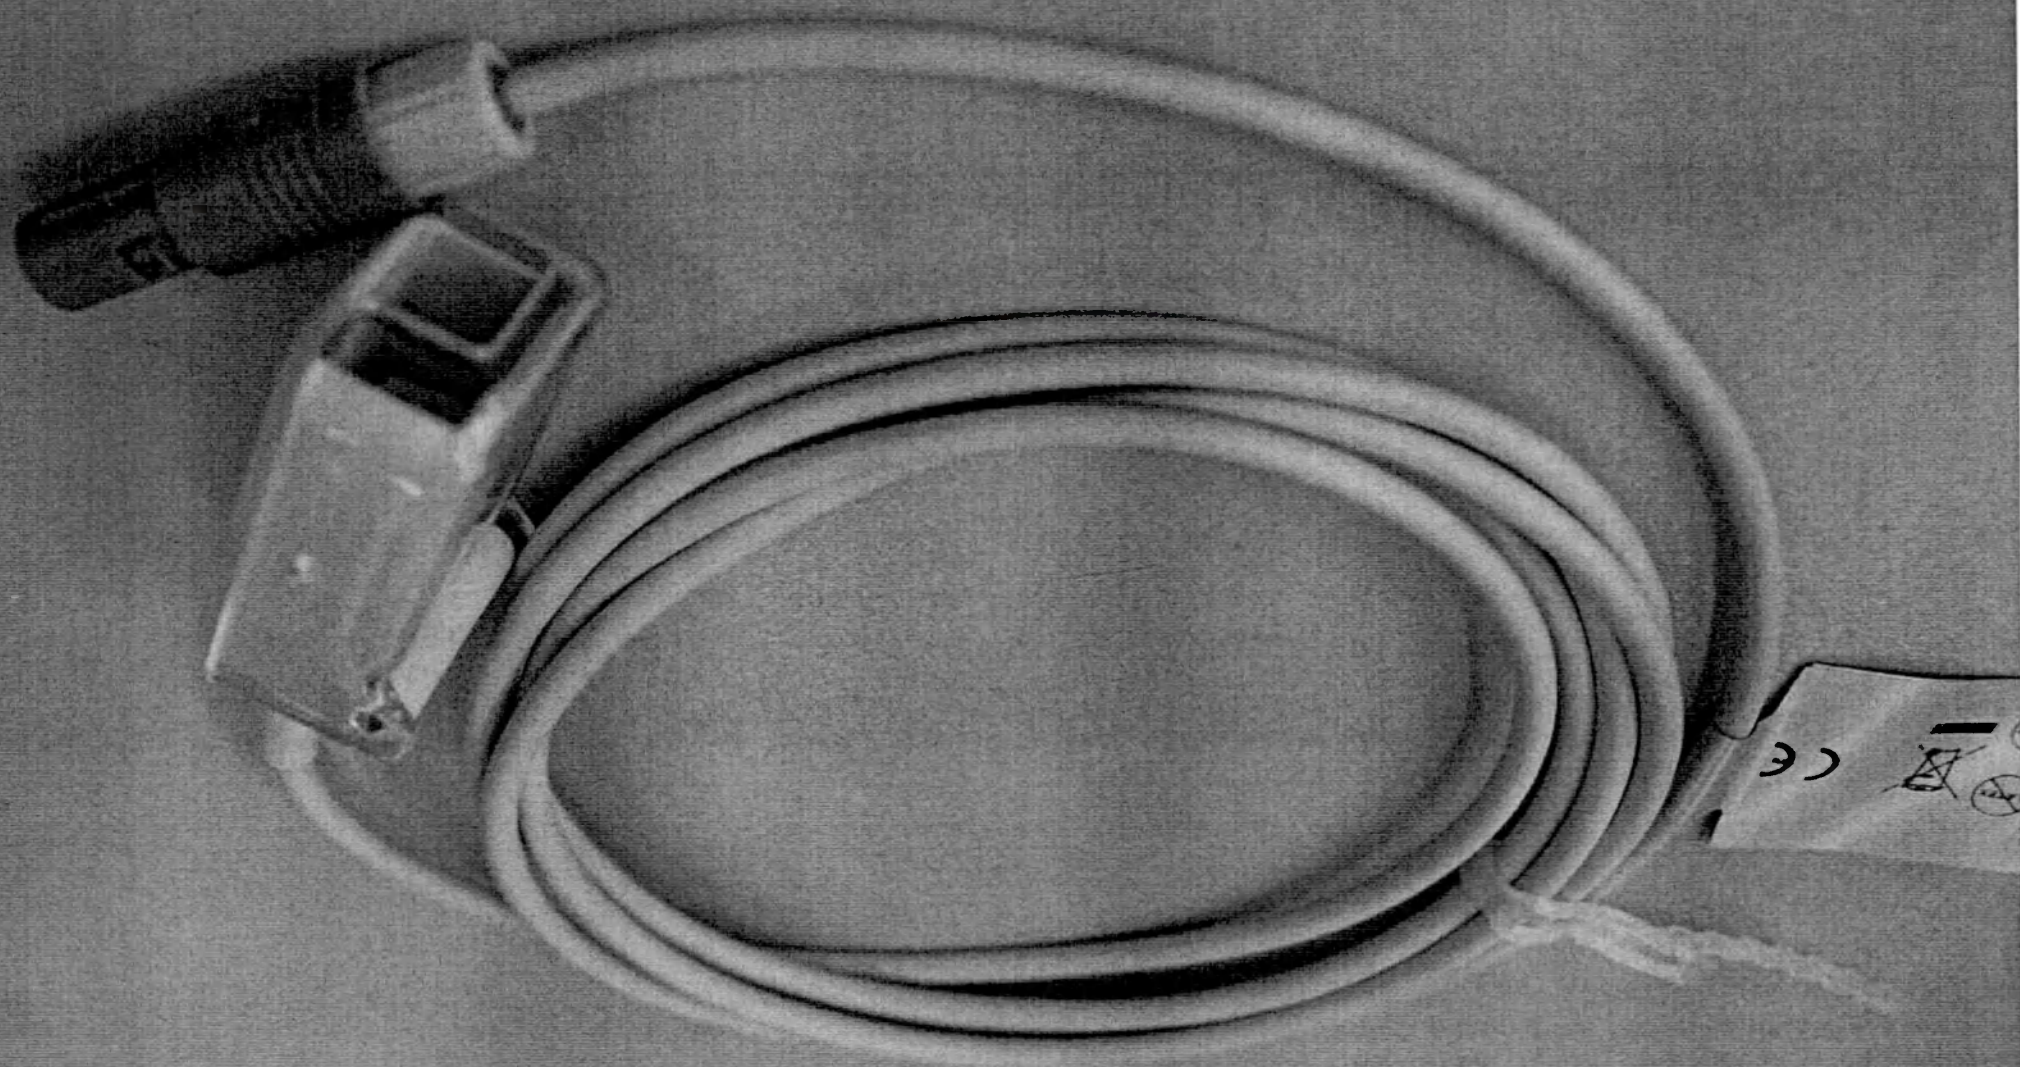

2. Ремешки для крепления датчиков серии HTM800:

HTM-E023 (в упаковке, с маркировкой)




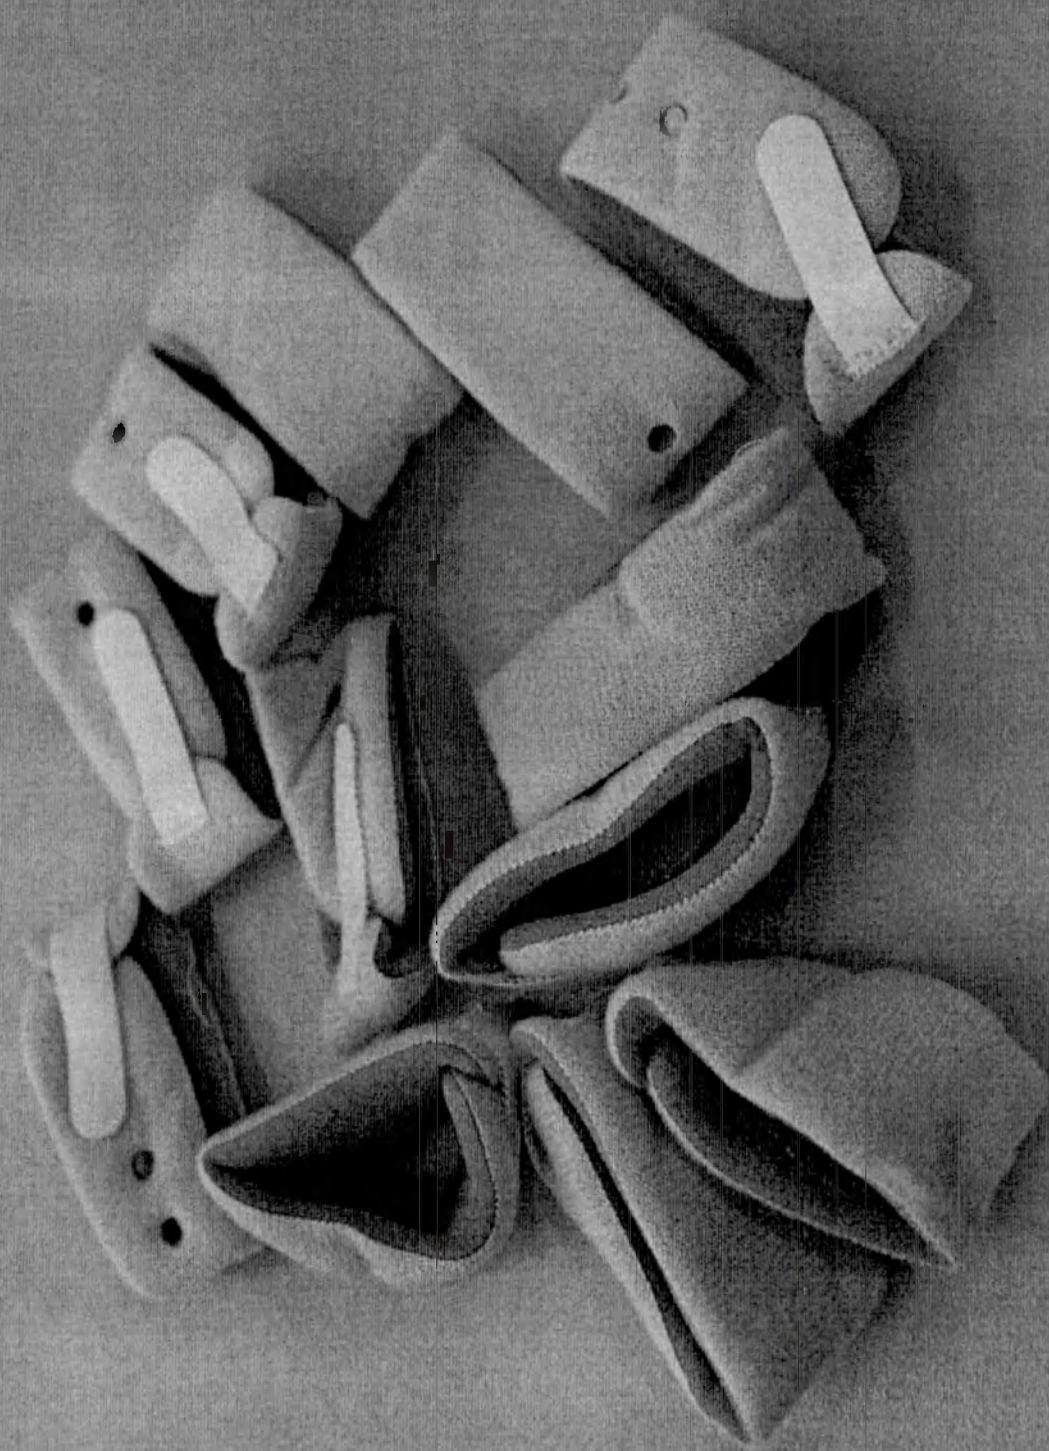

2. Ремешки для крепления датчиков сер.... НТМ800:

НТМ-E024, (в упаковке, с маркировкой)




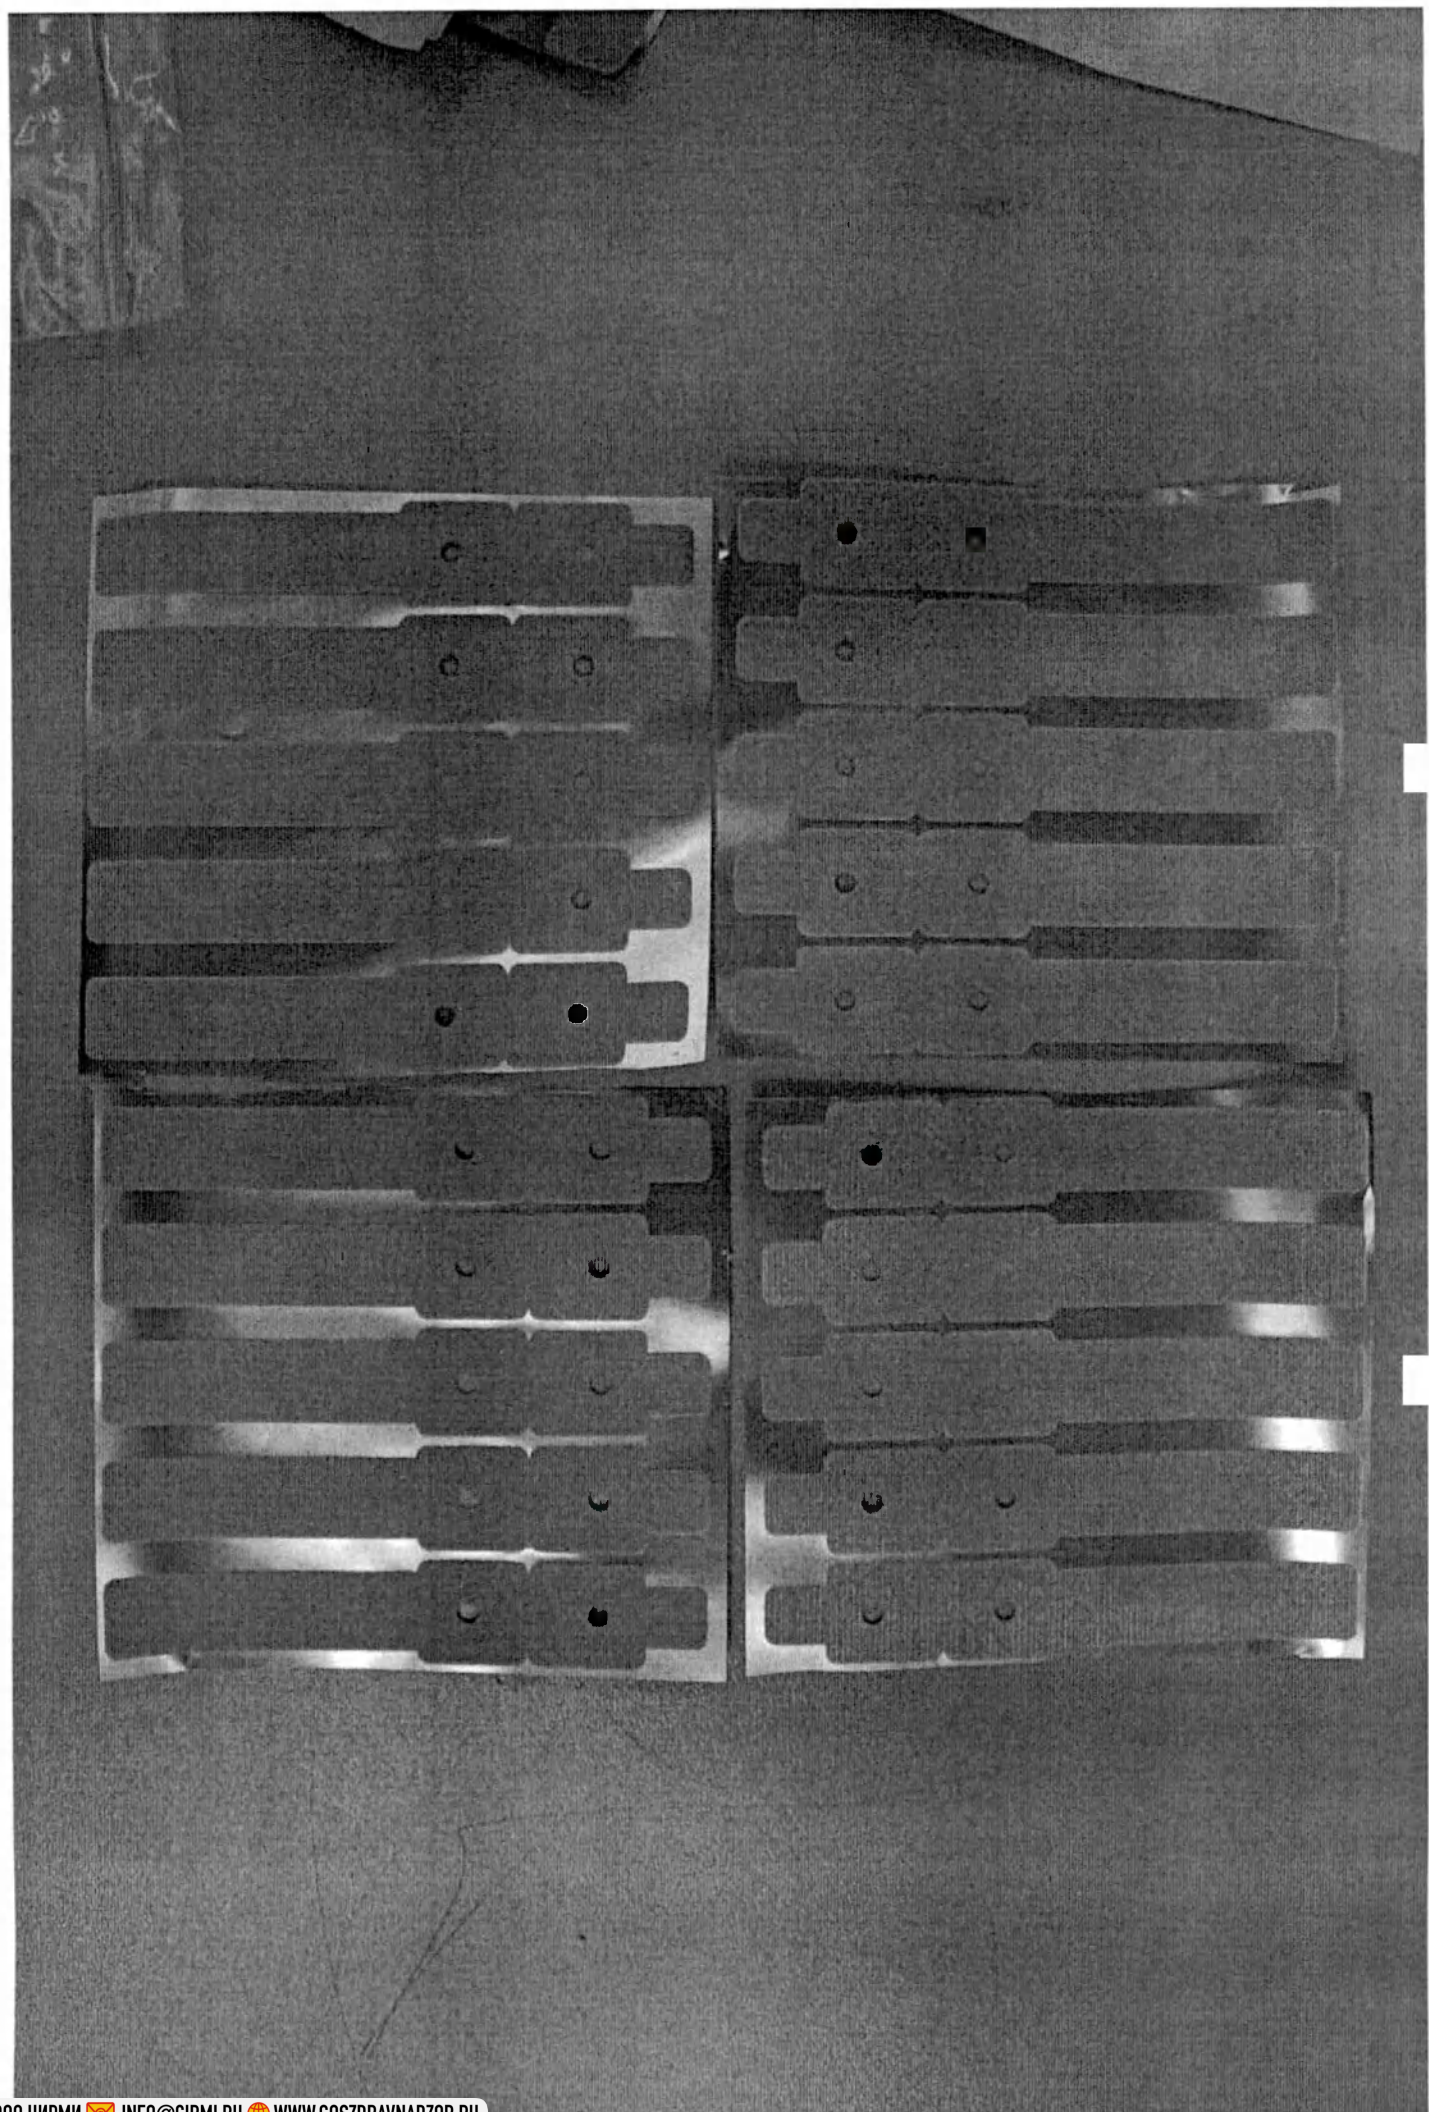

2. Ремешки для крепления датчиков серии HTM800:

HTM-E025, (в упаковке, с маркировкой)



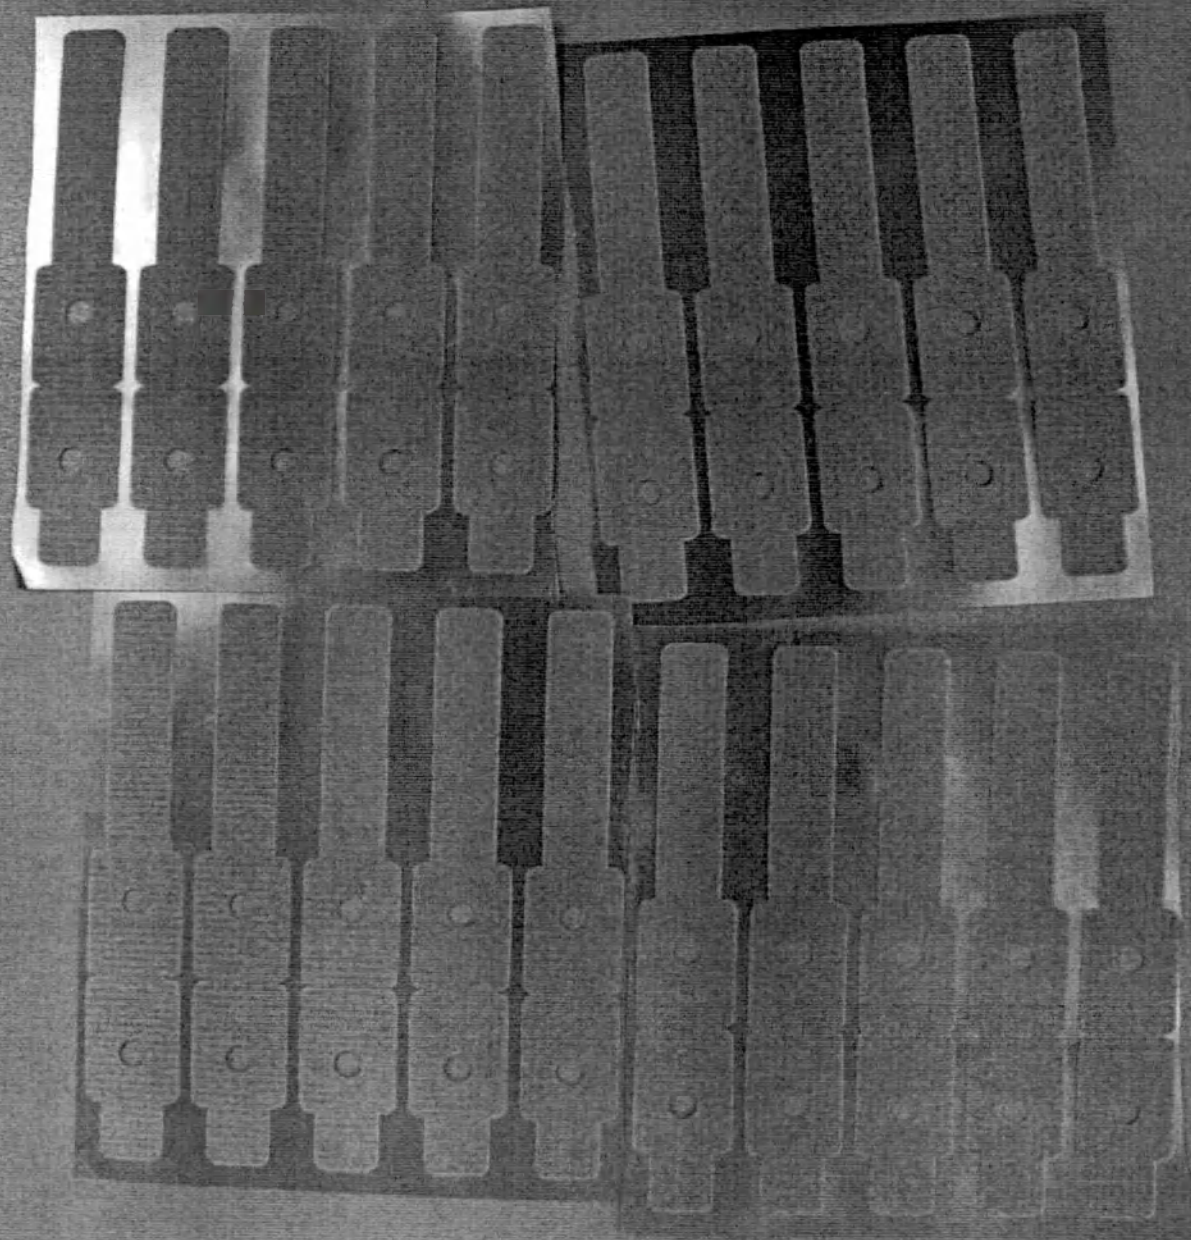

2. Ремешки для крепления датчиков серии HTM800:

HTM-Y04. (в упаковке, с маркировкой)

unimed
medical supplies



SpO2 Sensor Accessories

REF HTM-Y04-E019

Reusable Neonate silicon tape For use with
Y senso or Nellcor D-YS sensor



LOT



20140213001



Unimed Medical Supplies Inc
No.37,Yanshan Road,Shekou,
Shenzhen,China 518067


EC REP

Geranswara
Rua Jos Rodrigues Miguls n141,
2670-466 Montijo, Portugal




2014/02/13


Exp.date 2016/02/13

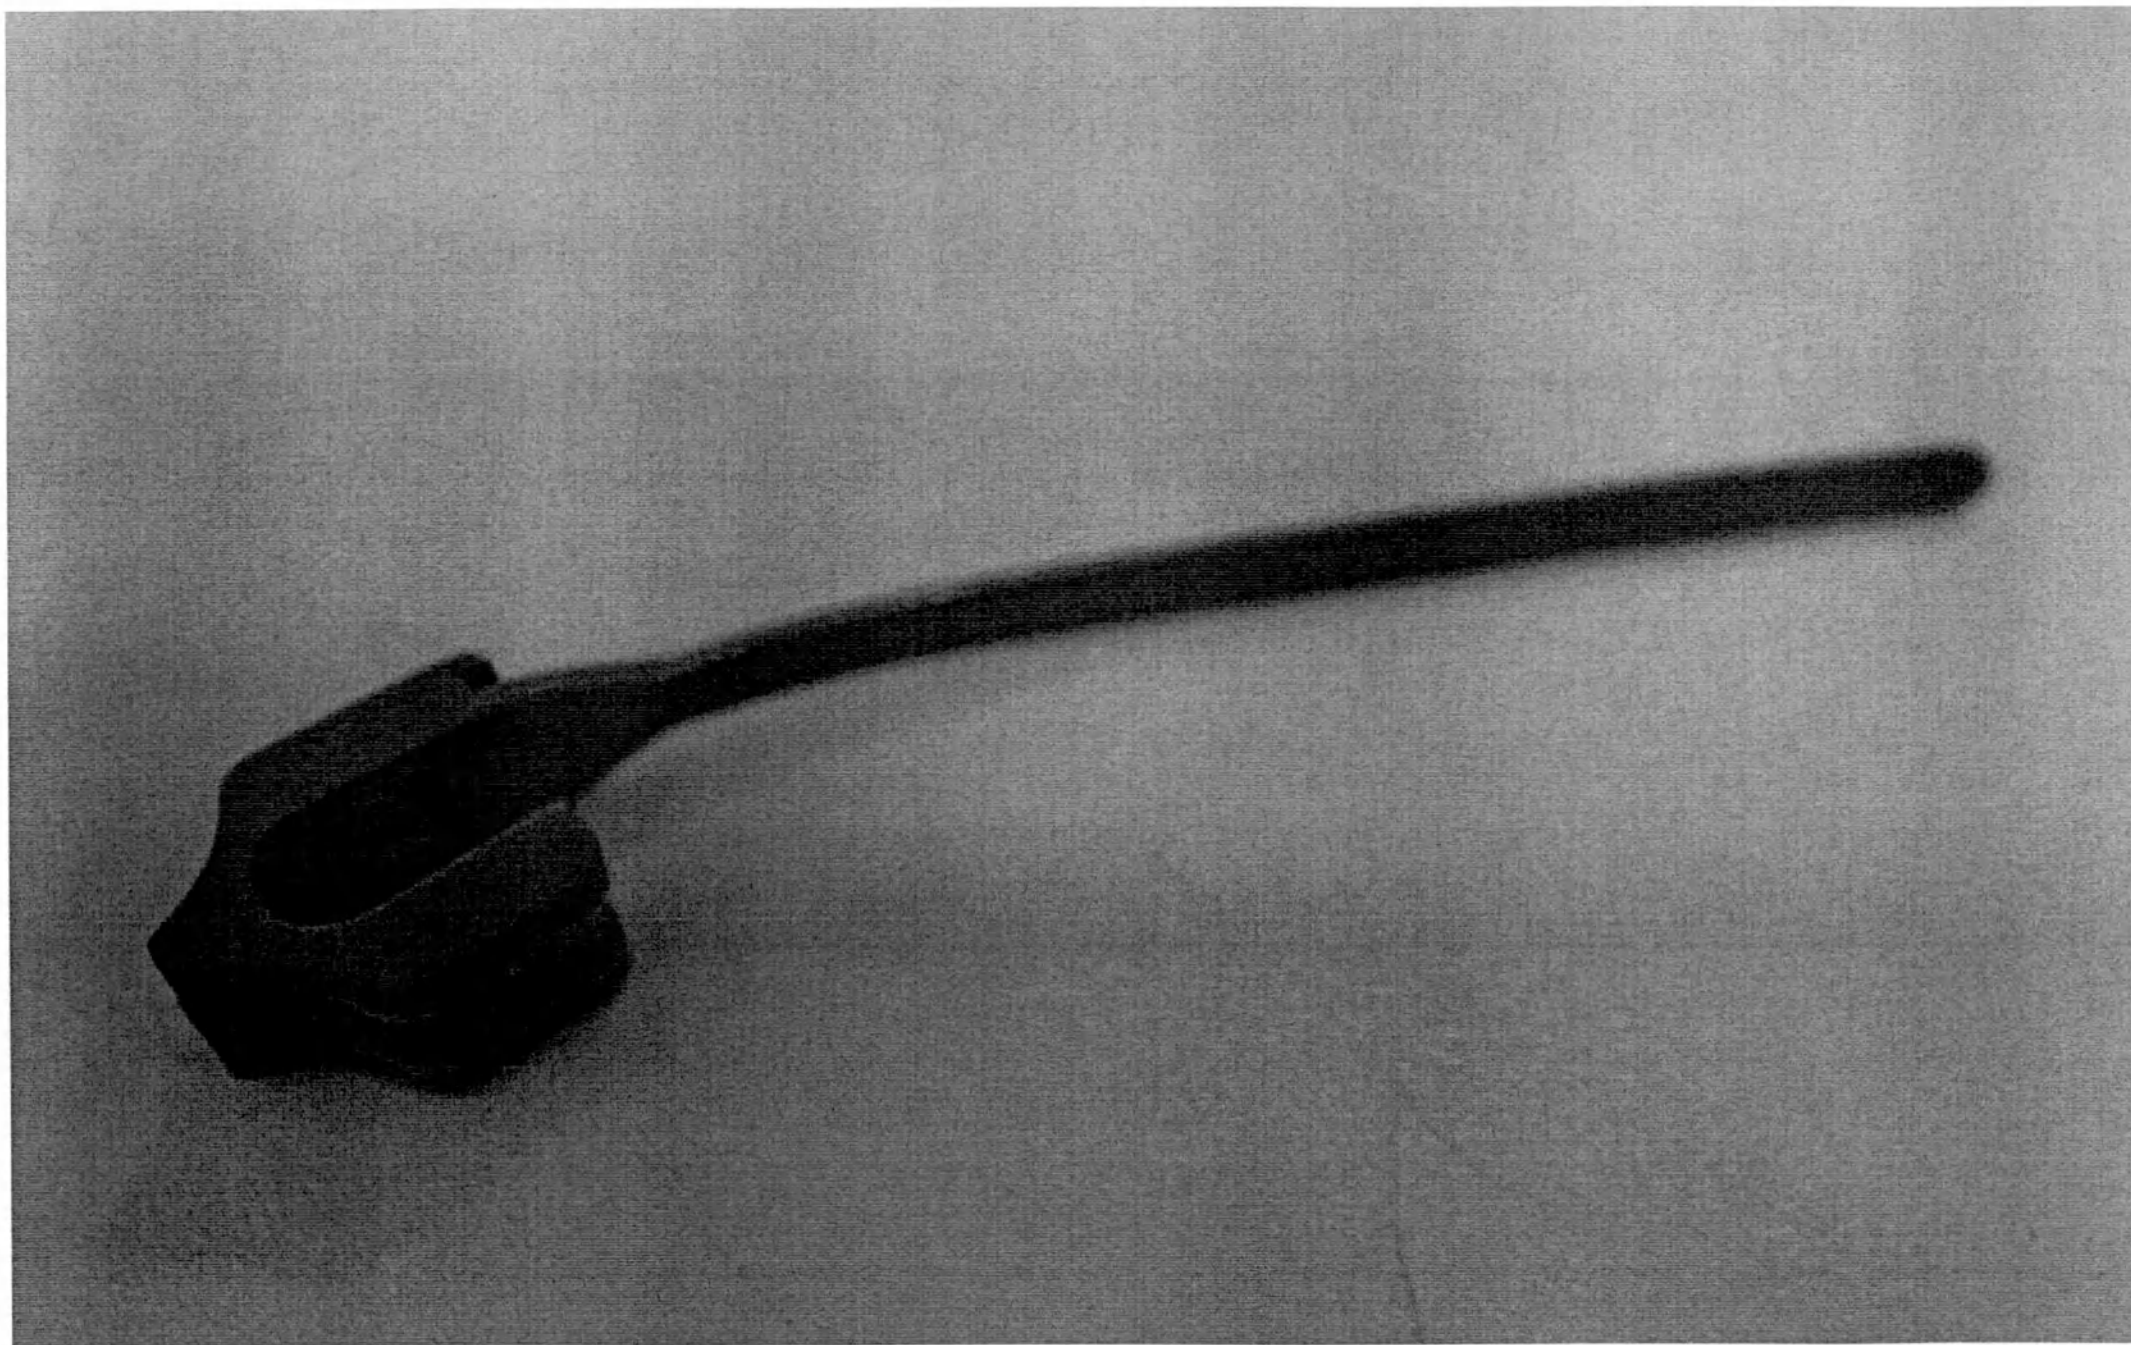

3. Ленты для крепления датчиков серии НТМ800Е: НТМ-DPTA, НТМ -DPTP, НТМ -DPTN

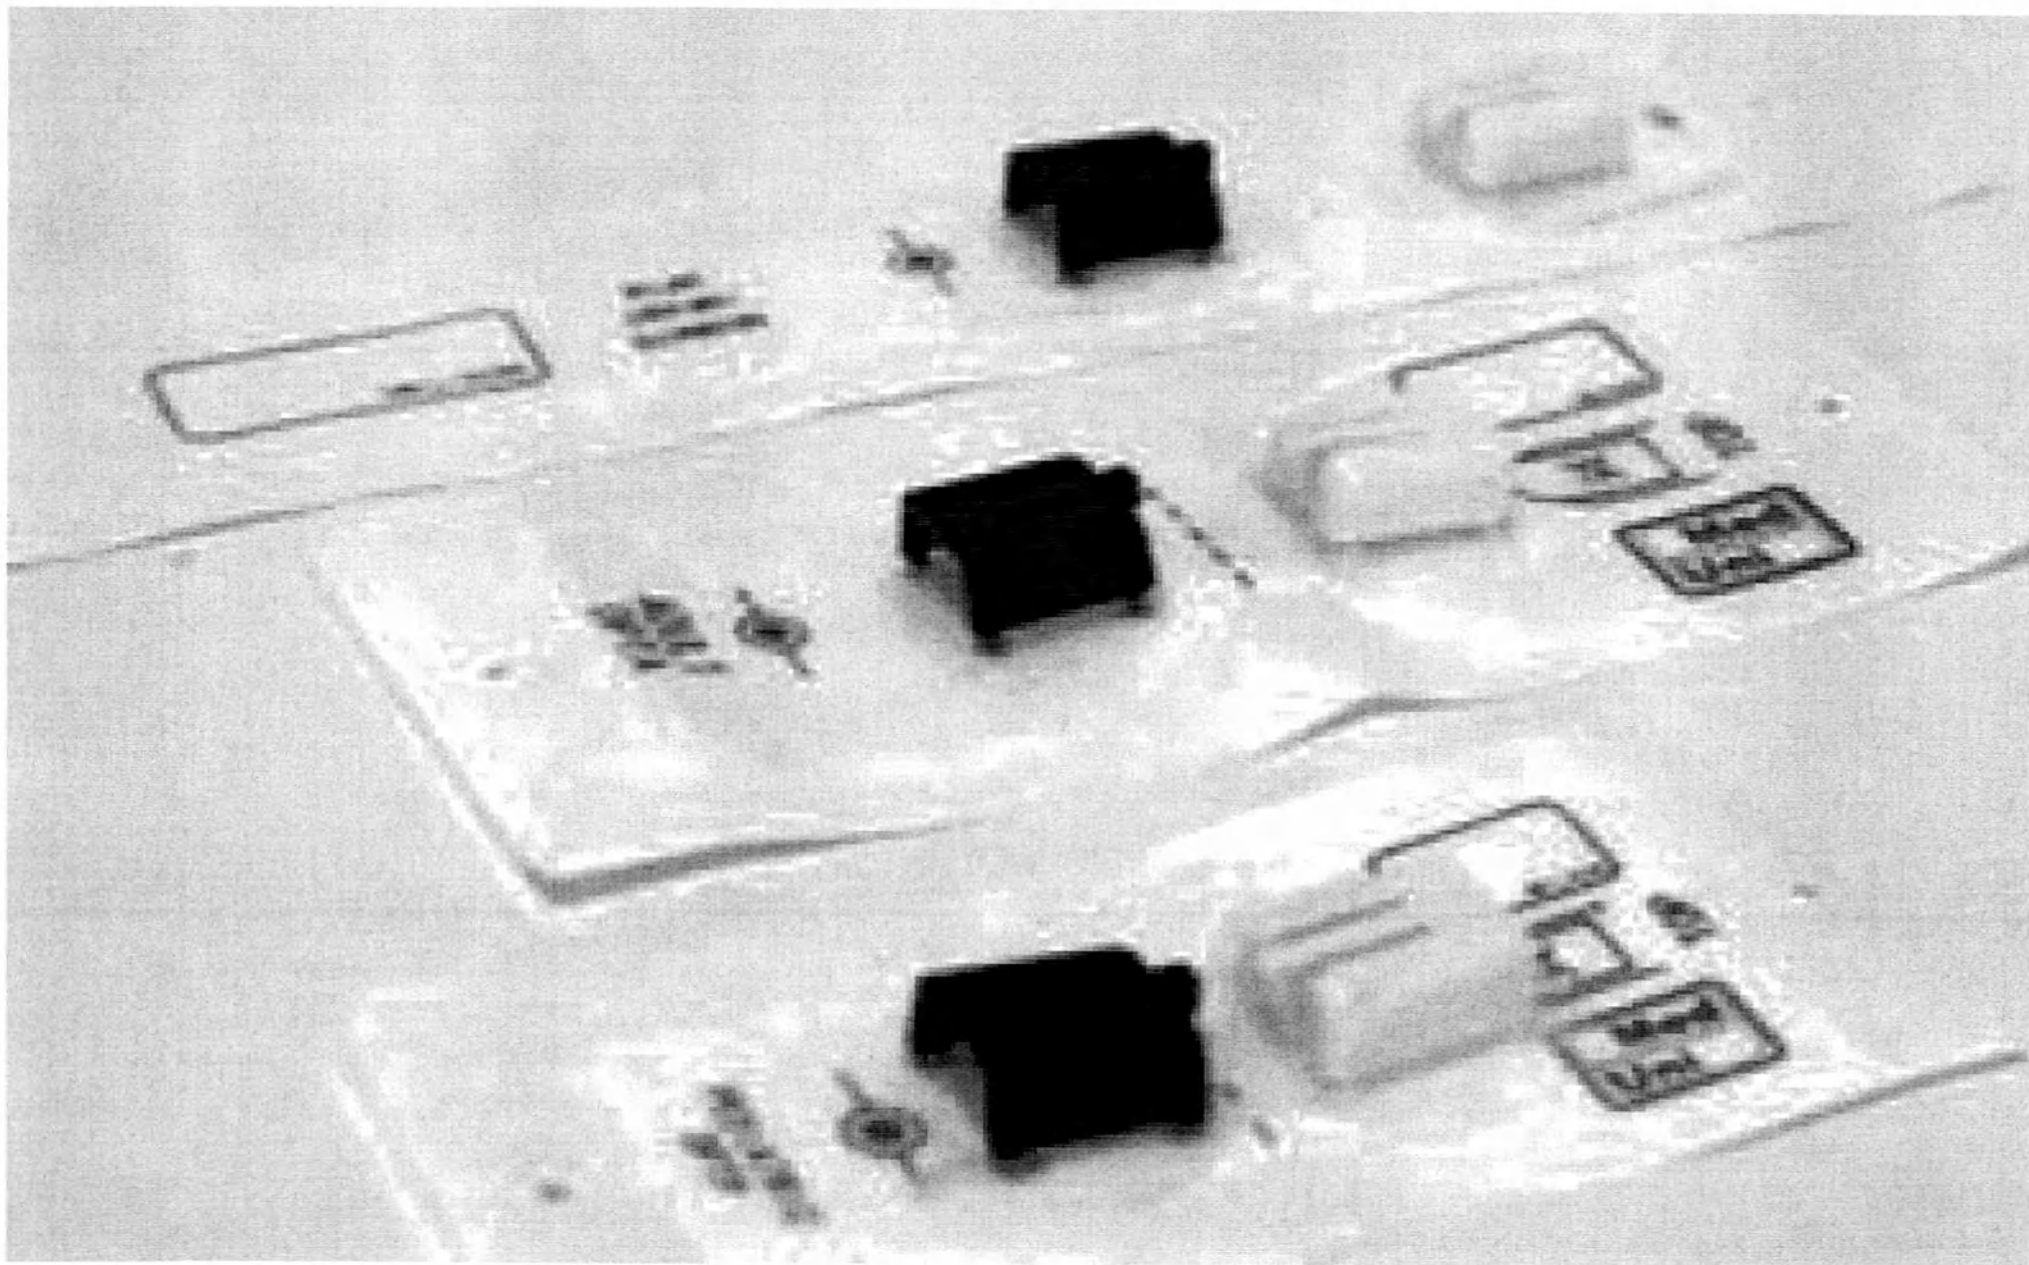


4. Ремешки для фиксации кабеля датчика на запястье НТМ-Т002.

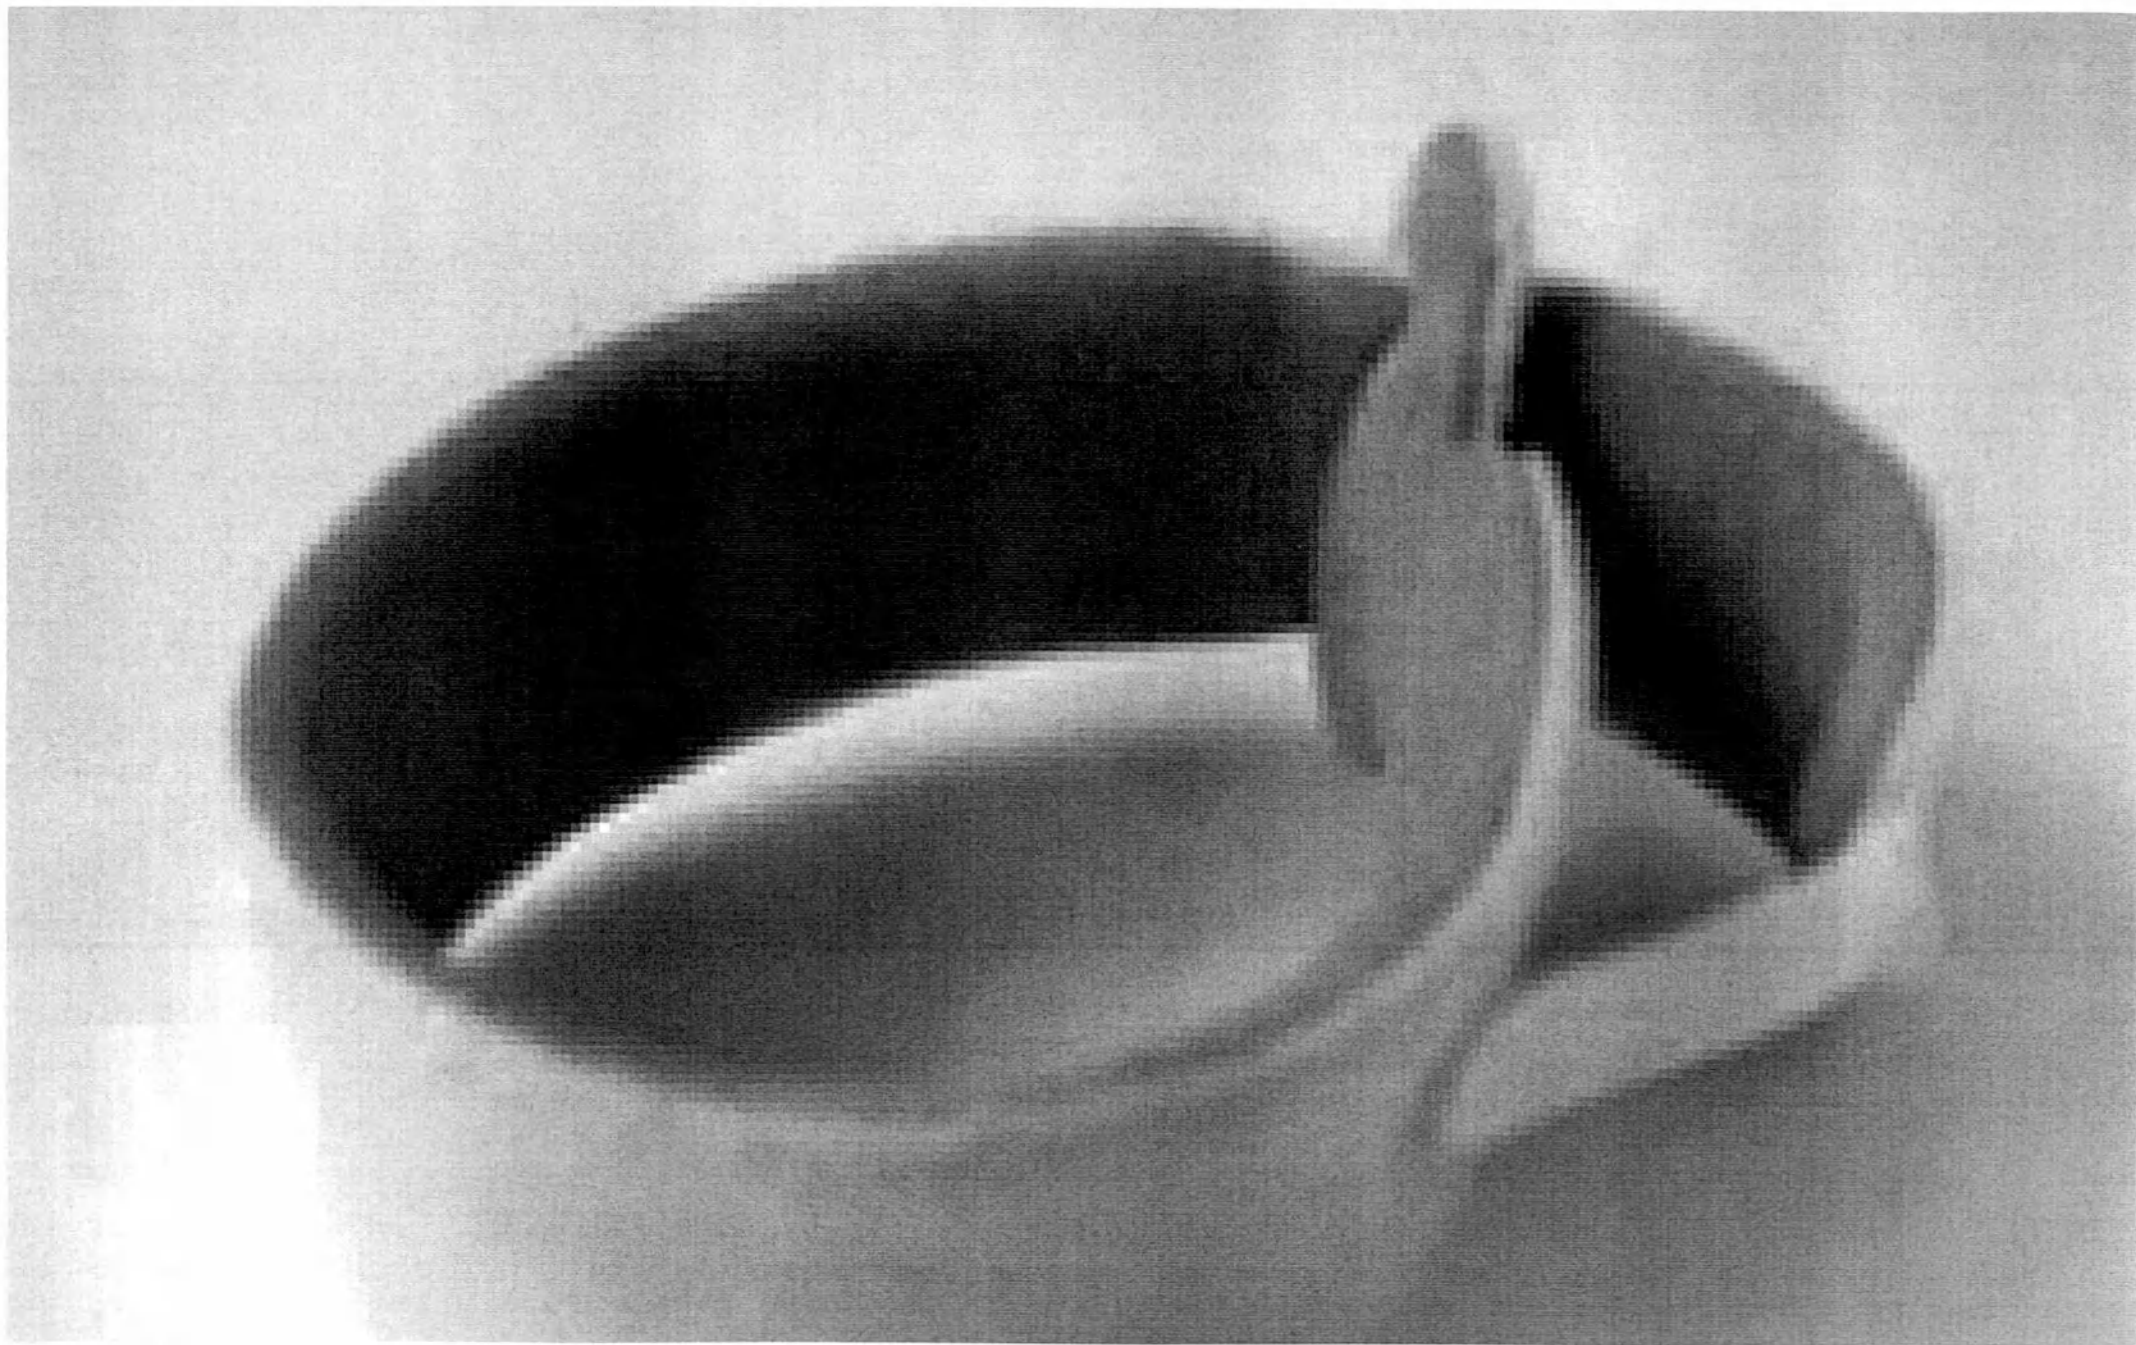


5. Пластиковые клипсы для крепления датчиков:
НТМ-УЕС



HTM-UVC

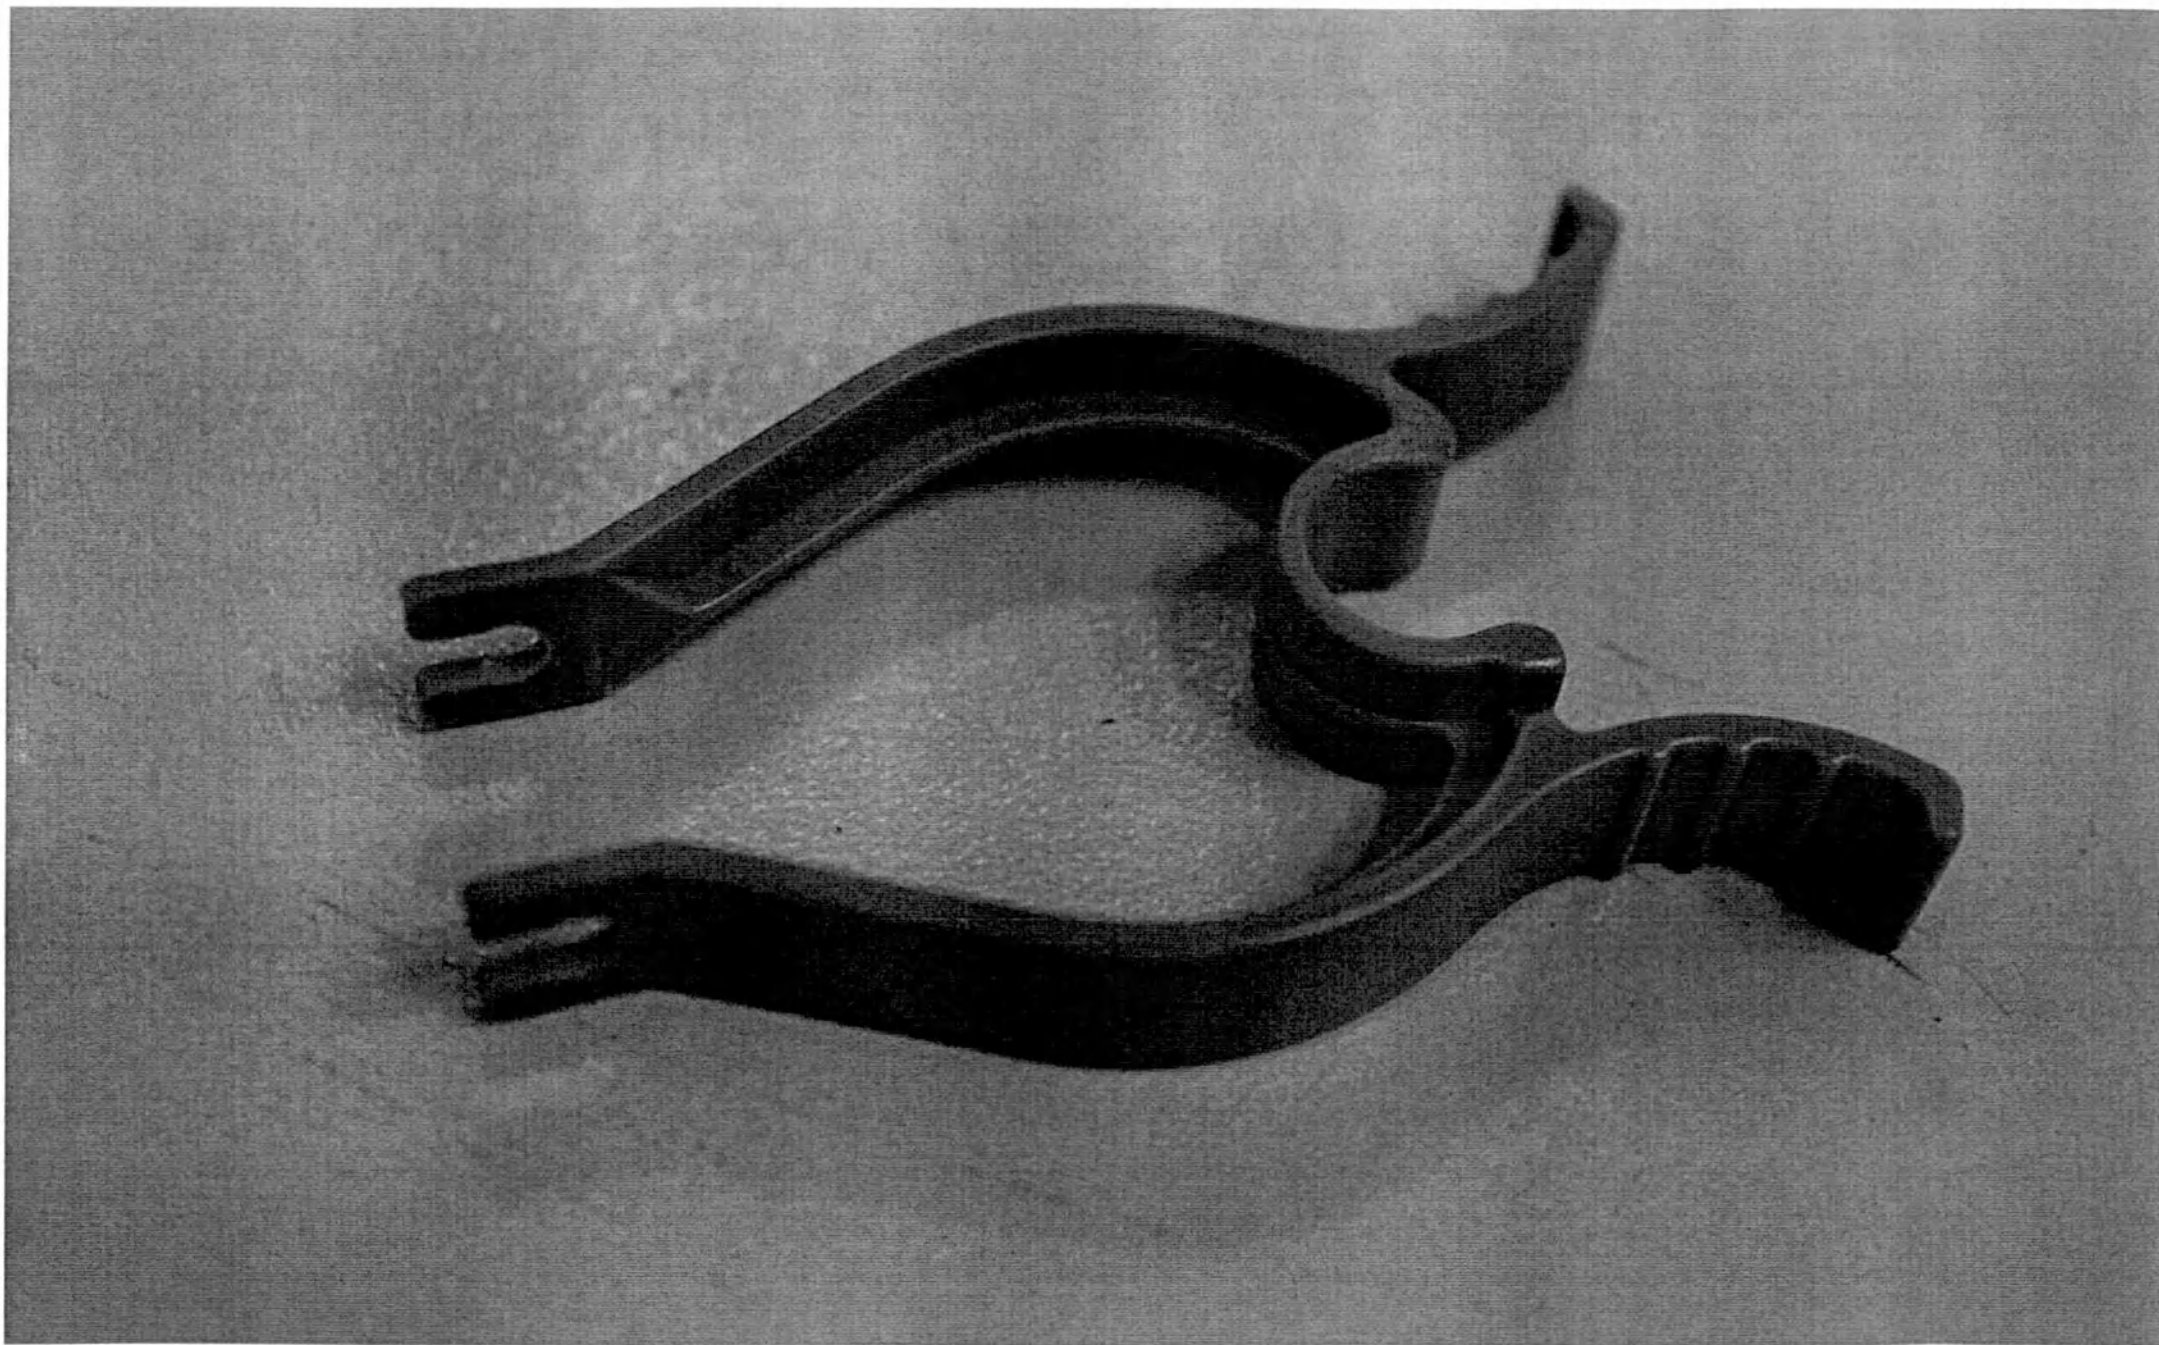

прошито, скреплено печатью
~~49 (оригинал)~~ лист(ов)
Генеральный директор
ООО «ХТМ»
 Гущин В.Н.
«23» марта 2015 г.

