





Система модульная MODUL CPAP для проведения CPAP терапии в условиях оказания экстренной медицинской помощи с принадлежностями в собранном виде

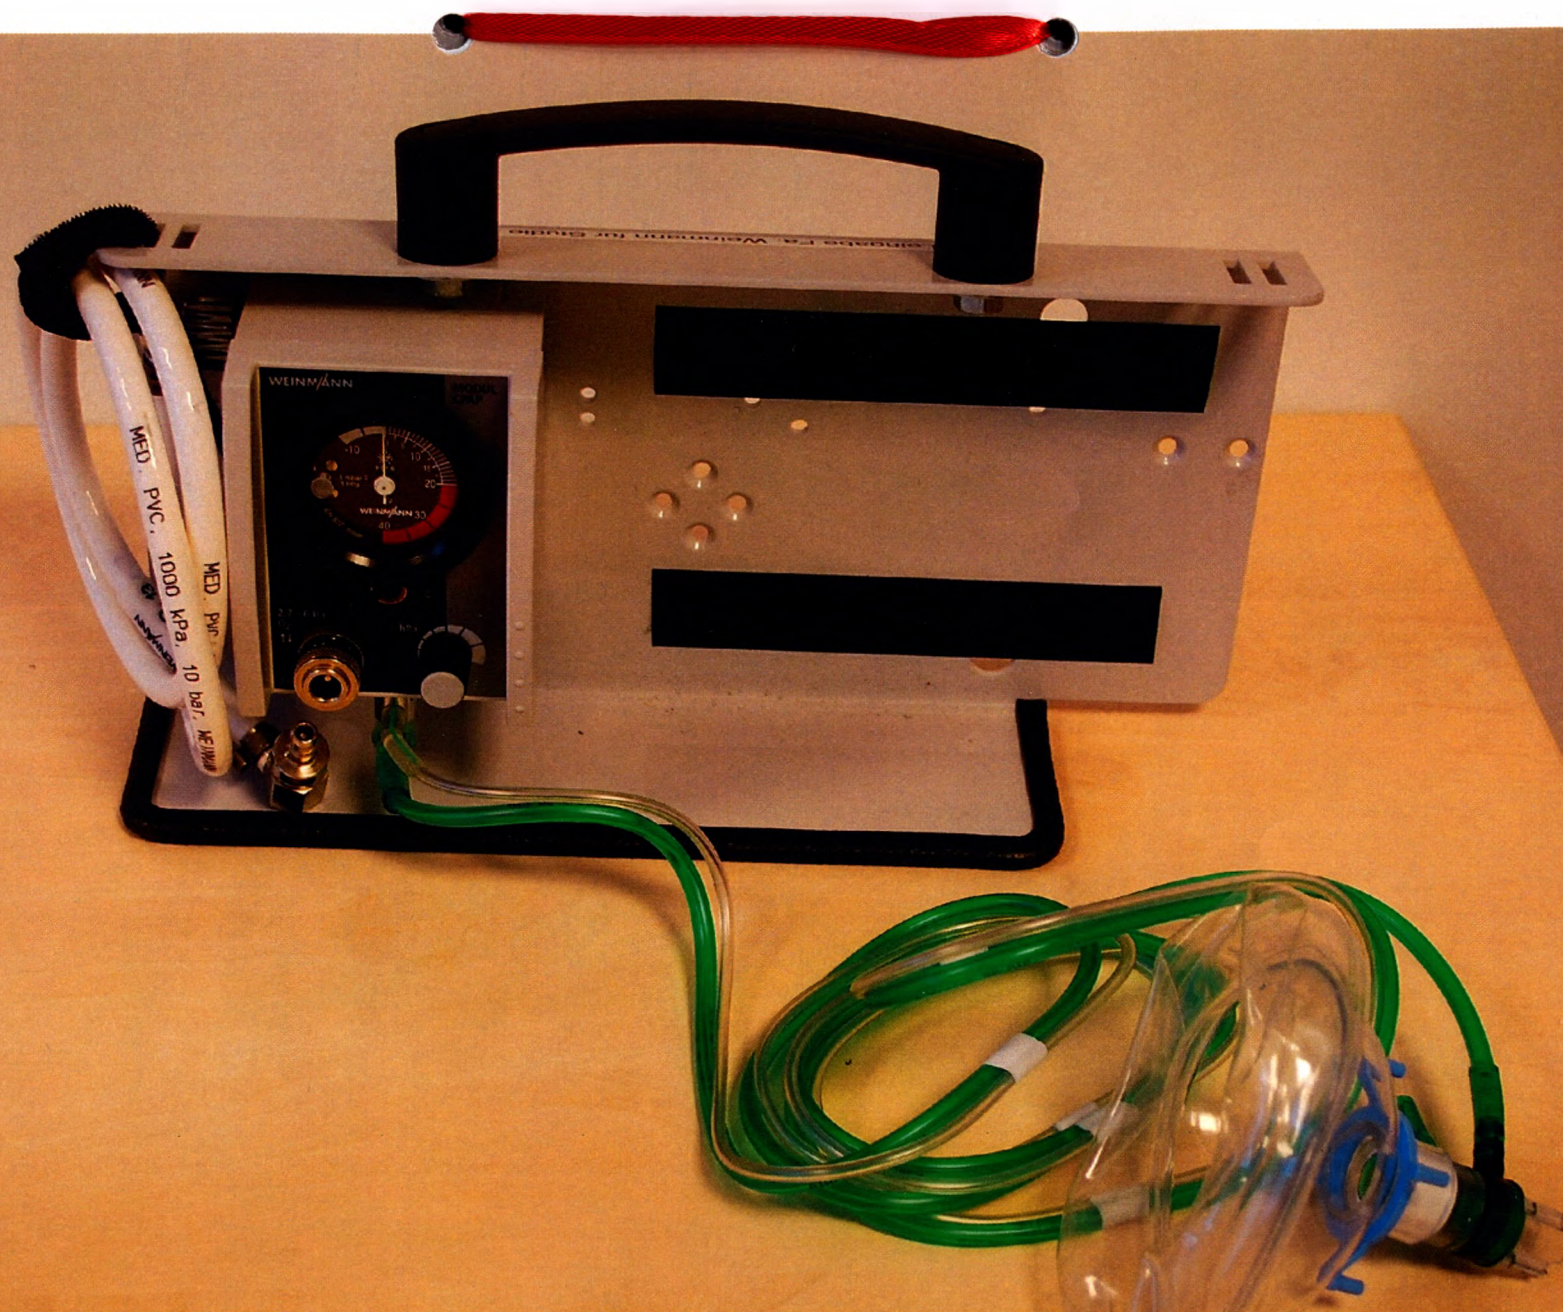

Аппарат MODUL CPAP


Маркировка Apparata Modul CPAP

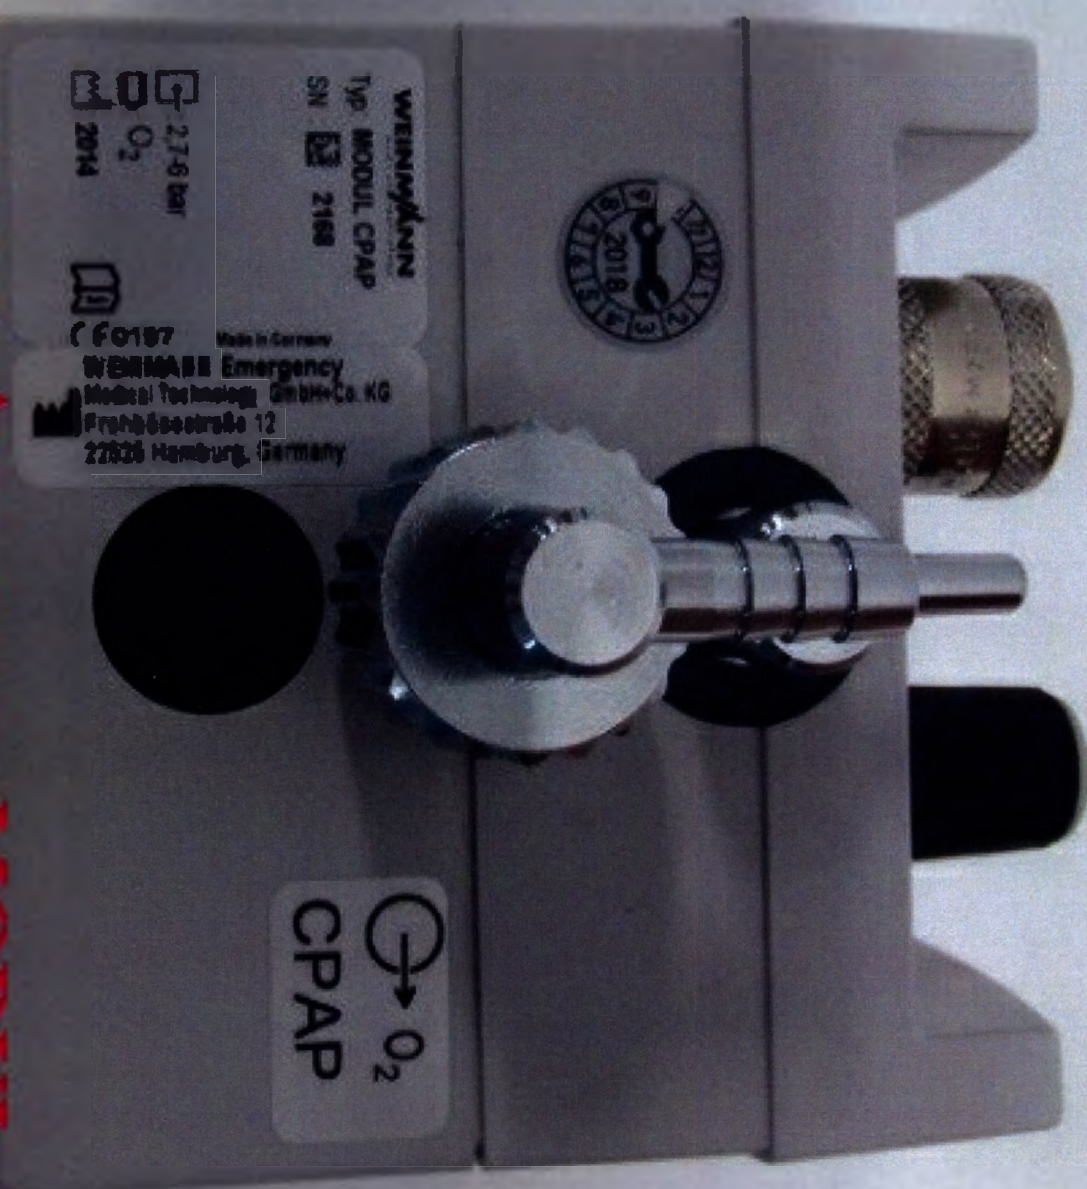

	CPAP BOUSSIGNAC - WEINMANN MODUL CPAP IS EEN WEGWEGPARTIËL EN ALLEEN BESTEMD OM SAMEN MET DE WEINMANN MODUL CPAP TE GEBRUIKEN VOORBEREIDING VAN DE PATIËNT, KEUZE VAN HET MASKER Leg de patiënt de therapiestappen uit. Laat de patiënt de mond half openen (afb. 1). Definieer de afstand tussen de neuswortel en de neus-kin rimpel. Kies het beste masker voor de afstand. Het masker moet de mond omsluiten. VOORBEREIDING VAN HET SYSTEEM, ZUURSTOFVOORZIEGING Open de zuurstoffles. Schakel de WEINMANN MODUL CPAP (afb. 2) in. Als er zuurstof uit de O₂-uitgang ontwijkt, schakelt u hem uit door de draaier naar links te draaien (afb. 3). CPAP-MONTAGE Sluit de transparante slang van het CPAP Boussignac-systeem aan op de drukmeetsluiting van de WEINMANN MODUL CPAP (afb. 4). Sluit de groene slang van het CPAP Boussignac-systeem aan op de zuurstofuitgang van de WEINMANN MODUL CPAP (afb. 4). THERAPIS-UITVOERING BIJ EEN BEWAARTE PATIËNT Verbind de CPAP Boussignac met het masker (afb. 5). Plaats met uw ene hand het masker op het gezicht van de patiënt en plaats de andere hand achter het hoofd van	CPAP BOUSSIGNAC - WEINMANN MODUL CPAP IS EEN WEGWEGPARTIËL EN ALLEEN BESTEMD OM SAMEN MET DE WEINMANN MODUL CPAP TE GEBRUIKEN Подготовка пациента, Выбор маски Объясните пациенту этапы терапии. Попросите пациента приоткрыть рот. Определите расстояние между верхней частью подбородка. Выберите наиболее подходящую для размера маску. Маска должна окатывать рот. Подготовка системы, Подкачка Откройте кислородный баллон. Включите WEINMANN MODUL CPAP (рис. 2). Когда кислород начнет выходить из отключите его, повернув регулятор Монтаж CPAP Подсоедините прозрачную трубку к Boussignac к штуцеру измерения для WEINMANN MODUL CPAP (рис. 4). Подсоедините зеленую трубку системы к выходу кислорода на WEINMANN MODUL CPAP (рис. 4). Терапия для пациента Соедините CPAP Boussignac с маской. Наложите пациенту одной рукой на другую руку положите за голову на
---	--	---




Устройство Буссиньяка одноразовое

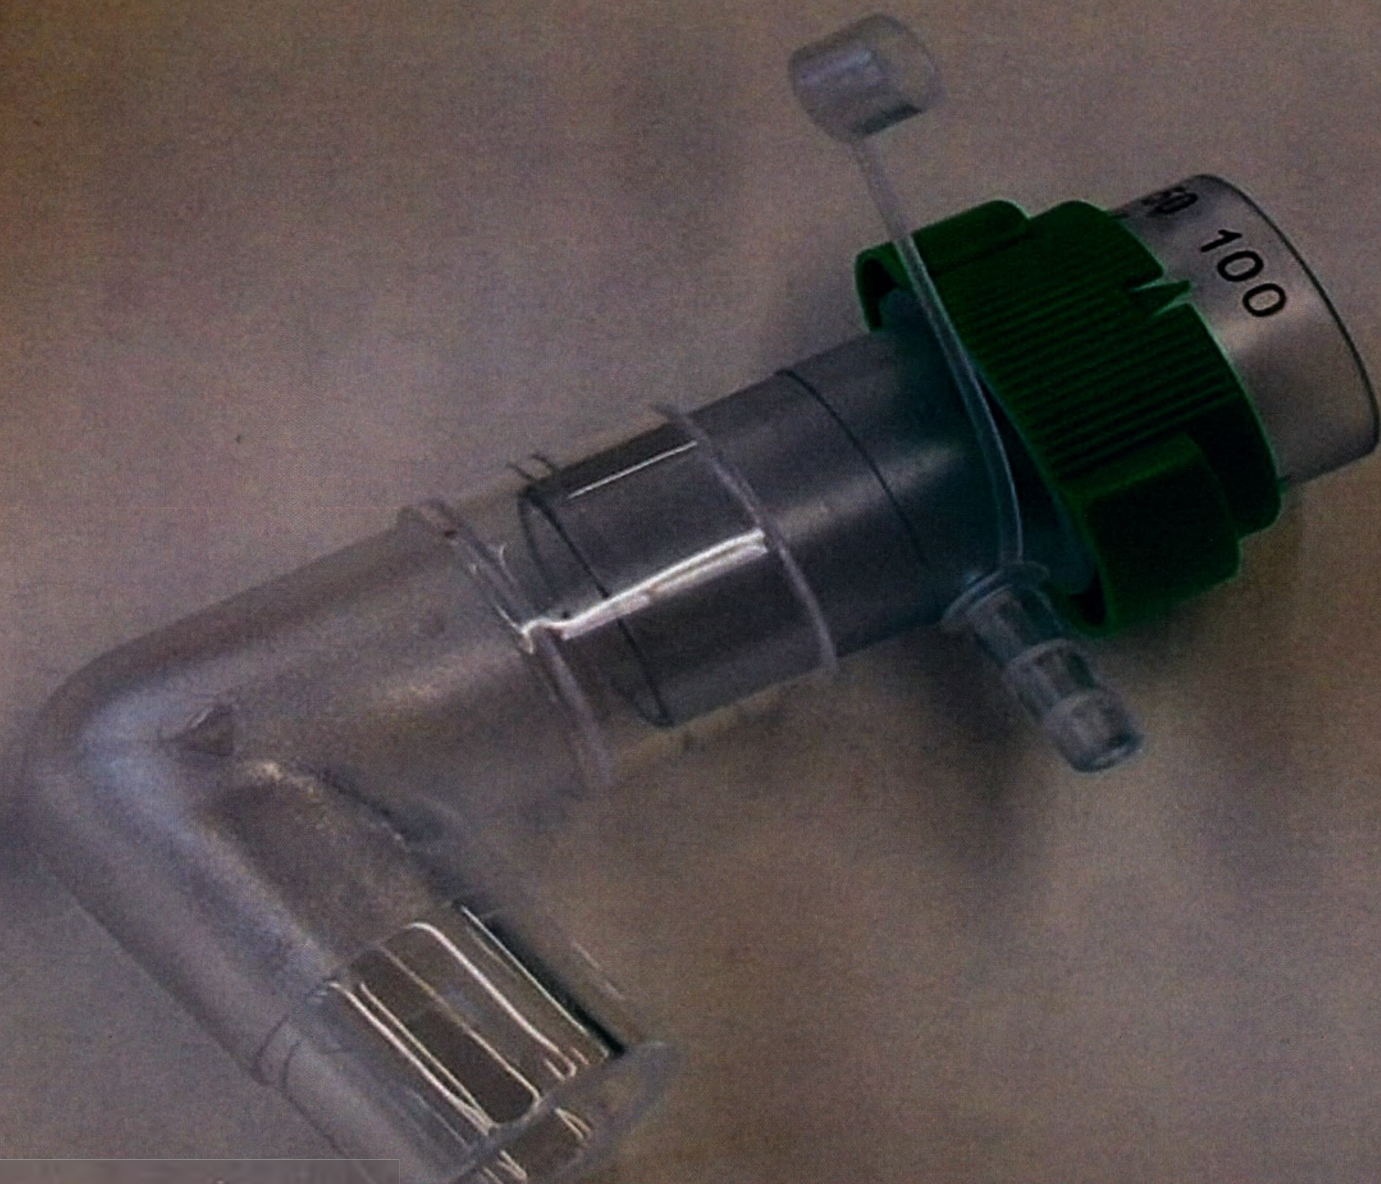

Регулятор концентрации кислорода одноразовый

Небулайзер одноканальный

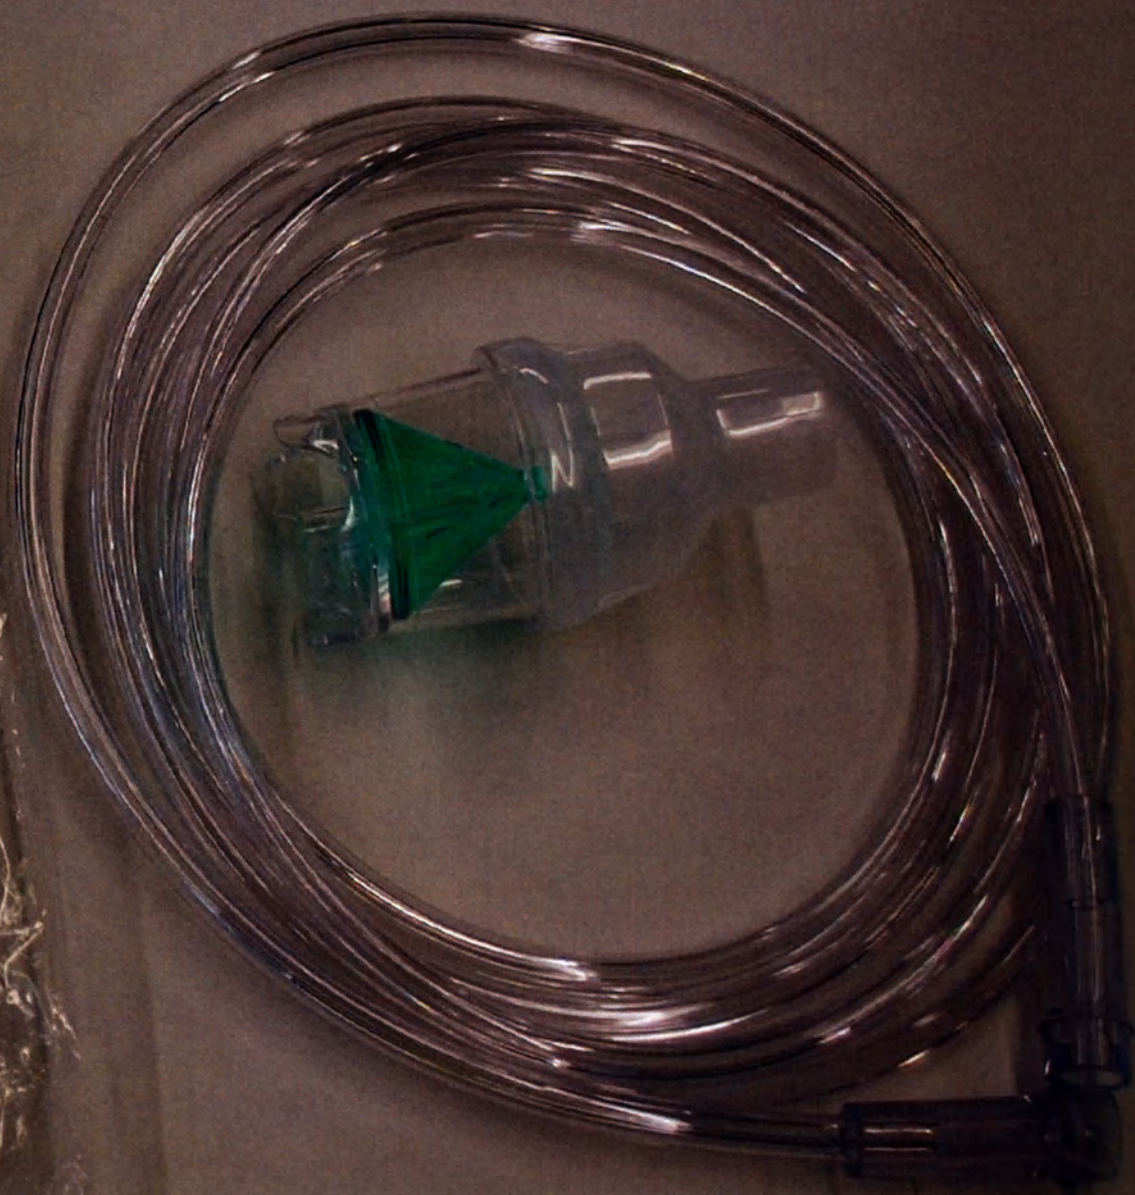

Модульная

MODUL Oxygen

MODUL Suction

MODUL Combi

MODUL Interface

MODUL CPAP

WM 22200

WM 22220

WM 22210

WM 22230

WM 29100

Описание и инструкция по пользованию прибором

Описание и инструкция по пользованию прибором

WEINMANN
medical technology




Адаптер



Маска одноразовая детская

Маска одноразовая Взрослая

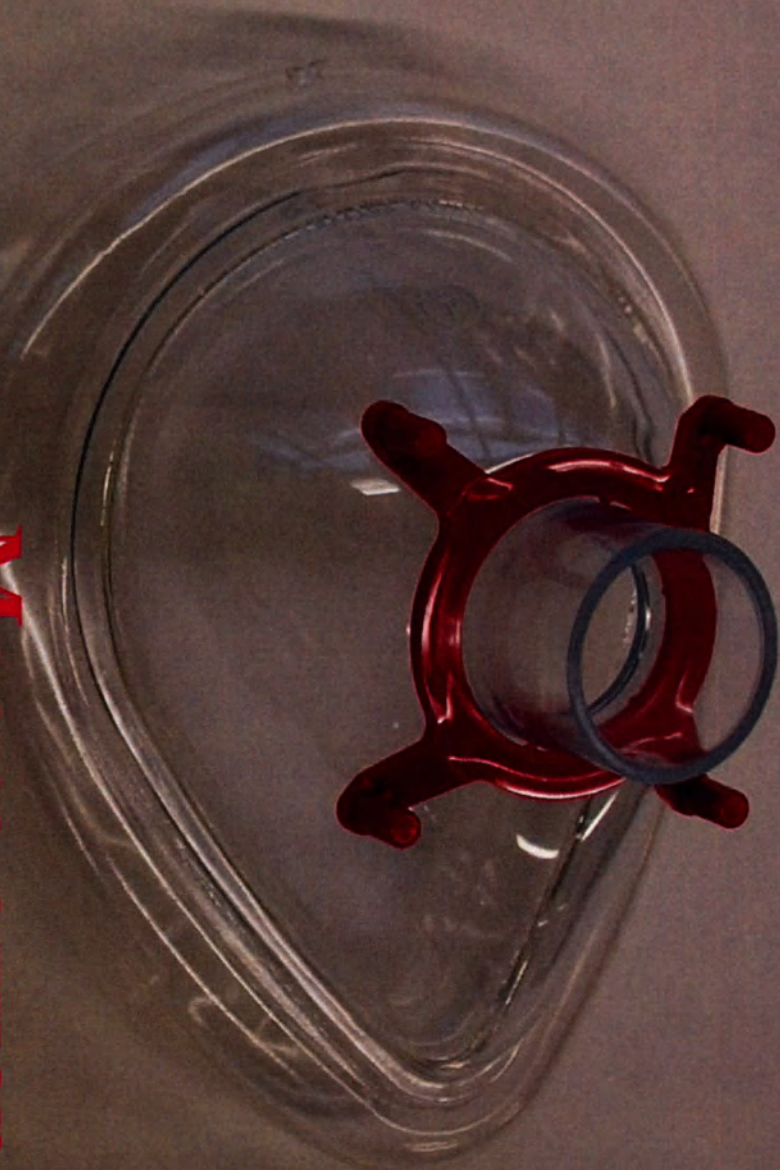

Маска одноразовая взрослая, увеличенная





Набор одноразовых масок и оголовья



Маска многоразовая детская



Маска многообразная взрослых

Маска многообразная взрослых, увеличенная



Набор многообразных масок



Оголовье



Кольцо для оголовья



Переходник угловой




Переходник прямой



Переходник угловой для газового контура



Переходник угловой для контура давления

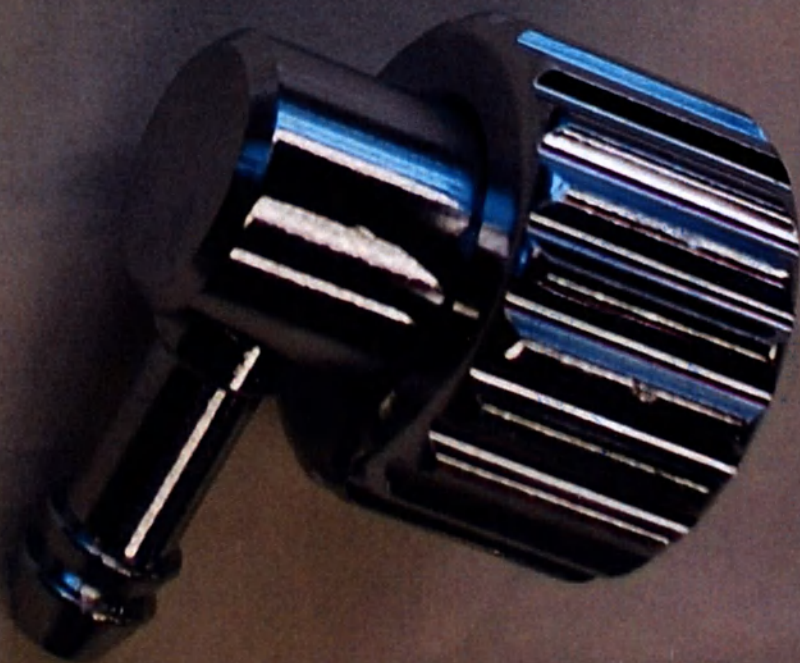

ПРОШТО И
ПРОНУМЕРОВАНО
22 ЛИСТОВ

