

Медицинская Техника и Сервис

ООО «МедТиС»

127055, г. Москва, ул. Новослободская, д. 14/19, стр. 1

ОГРН 1117746469598, ОКПО 92512096

ИНН 7707752015, КПП 770701001

р/с 40702810838040026967

в ОАО «Сбербанк России» г. Москва,

к/с 30101810400000000225, БИК 044525225


Тел. (499) 500-38-59, e-mail: info@medtis.dyndns.org

В Федеральную службу по надзору в
сфере здравоохранения Российской
Федерации (Росздравнадзор РФ)


Приложение к Заявлению для государственной регистрации
медицинского изделия “Аппарат наркозно-дыхательный Prima с
принадлежностями, варианты исполнения: Prima 450, Prima 460,
производства «Пенлон Лимитед» (Penlon Limited), Соединенное
Королевство Великобритании и Северной Ирландии”.

Фотографические изображения общего вида медицинского изделия
вместе с принадлежностями, необходимыми для применения
медицинского изделия по назначению.

Аппарат наркозно-дыхательный Prima с принадлежностями,
варианты исполнения: Prima 450, Prima 460 (на фото Prima 450)

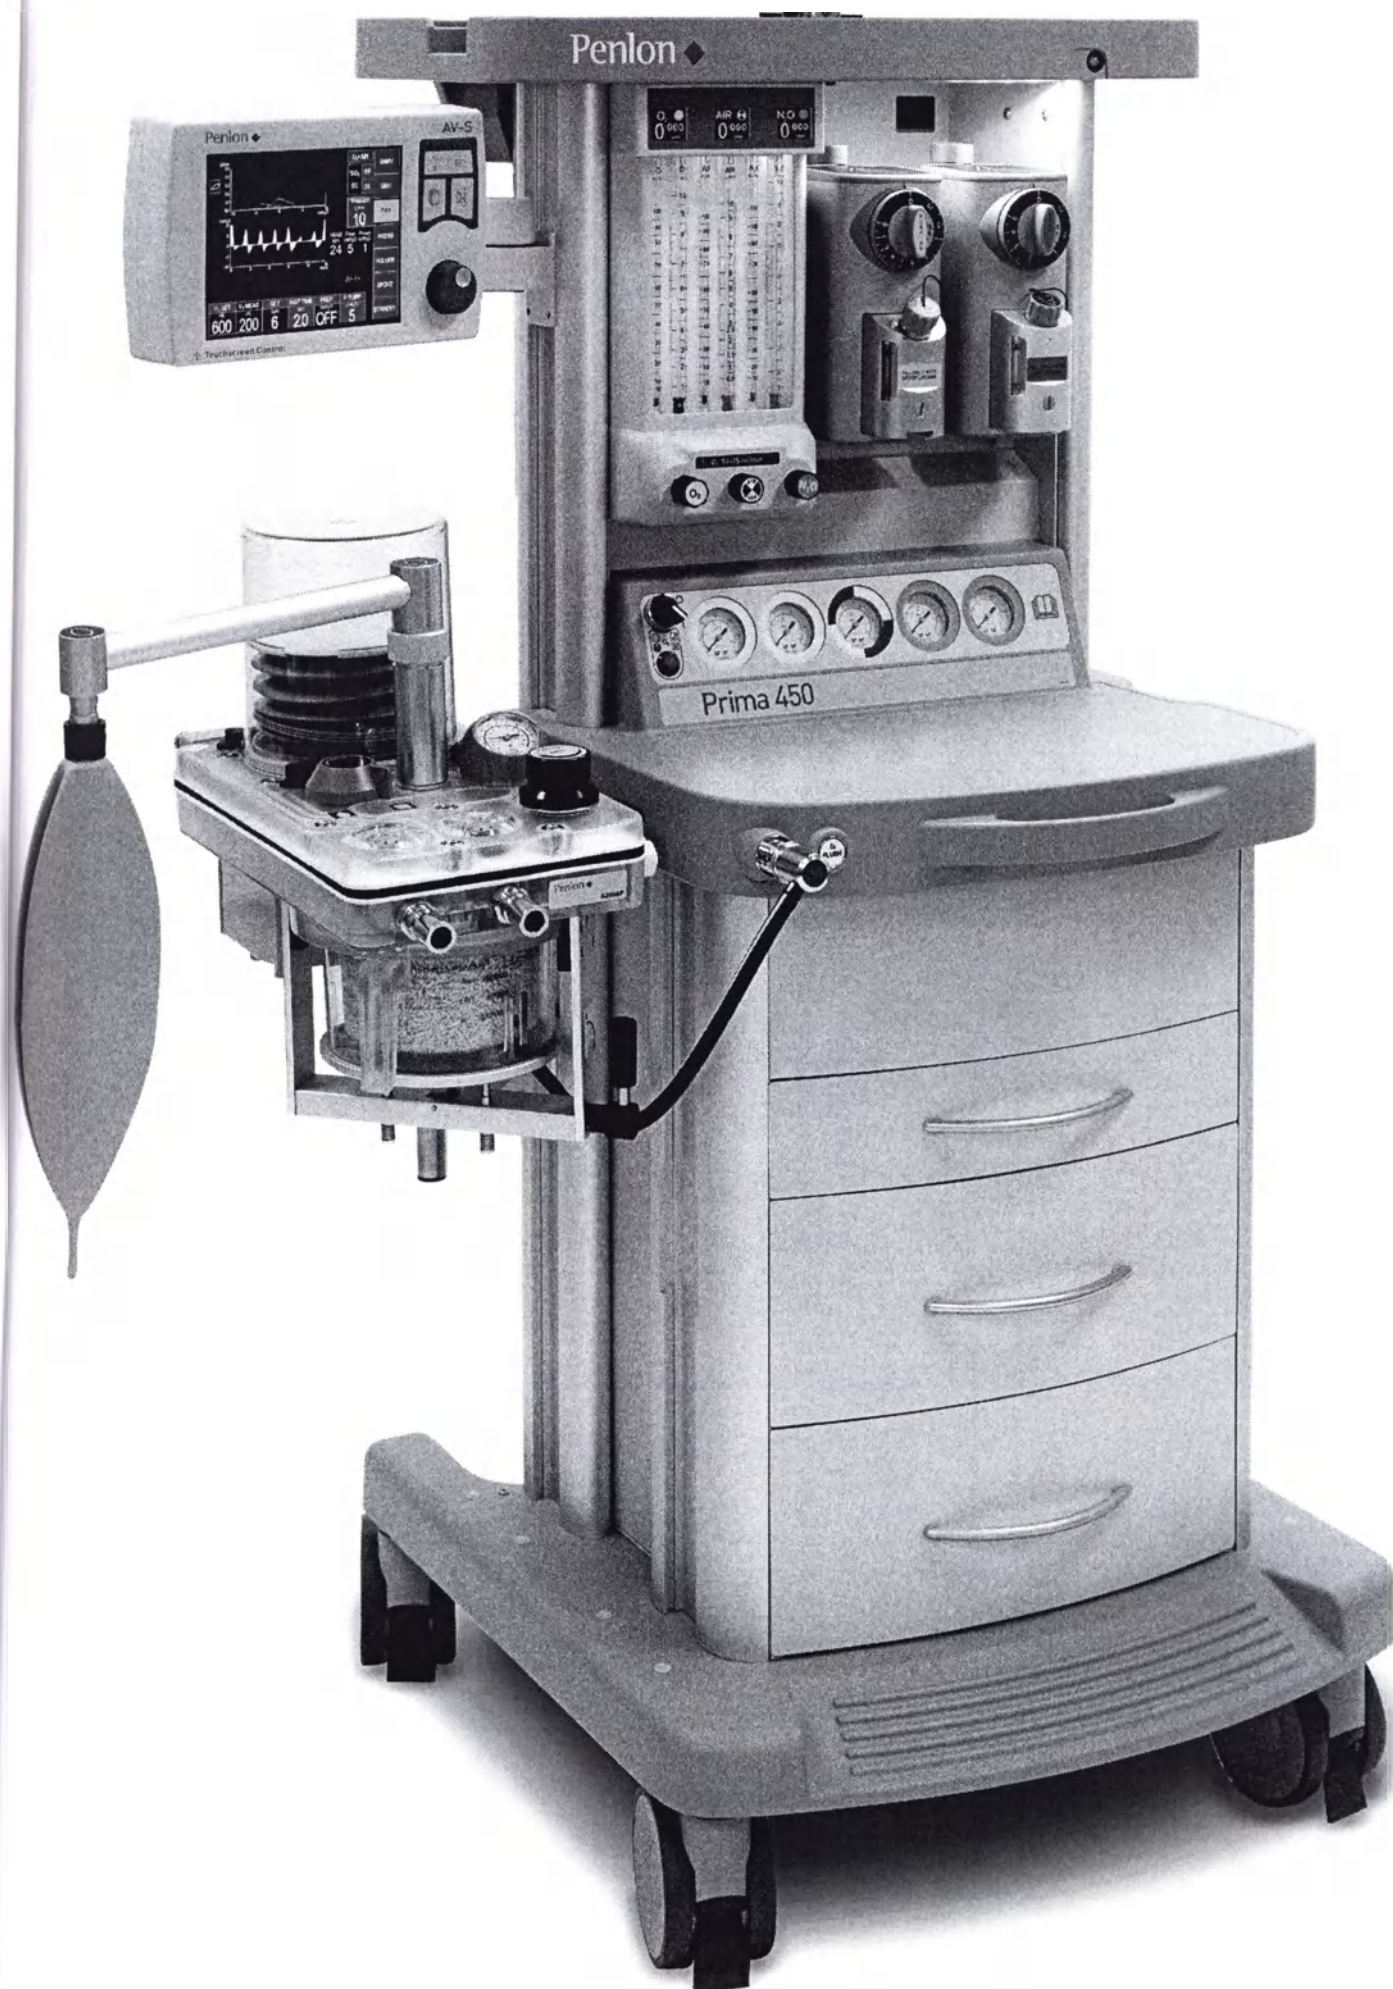


Аппарат наркозно-дыхательный Prima с принадлежностями,
варианты исполнения: Prima 450, Prima 460 (на фото Prima 460)

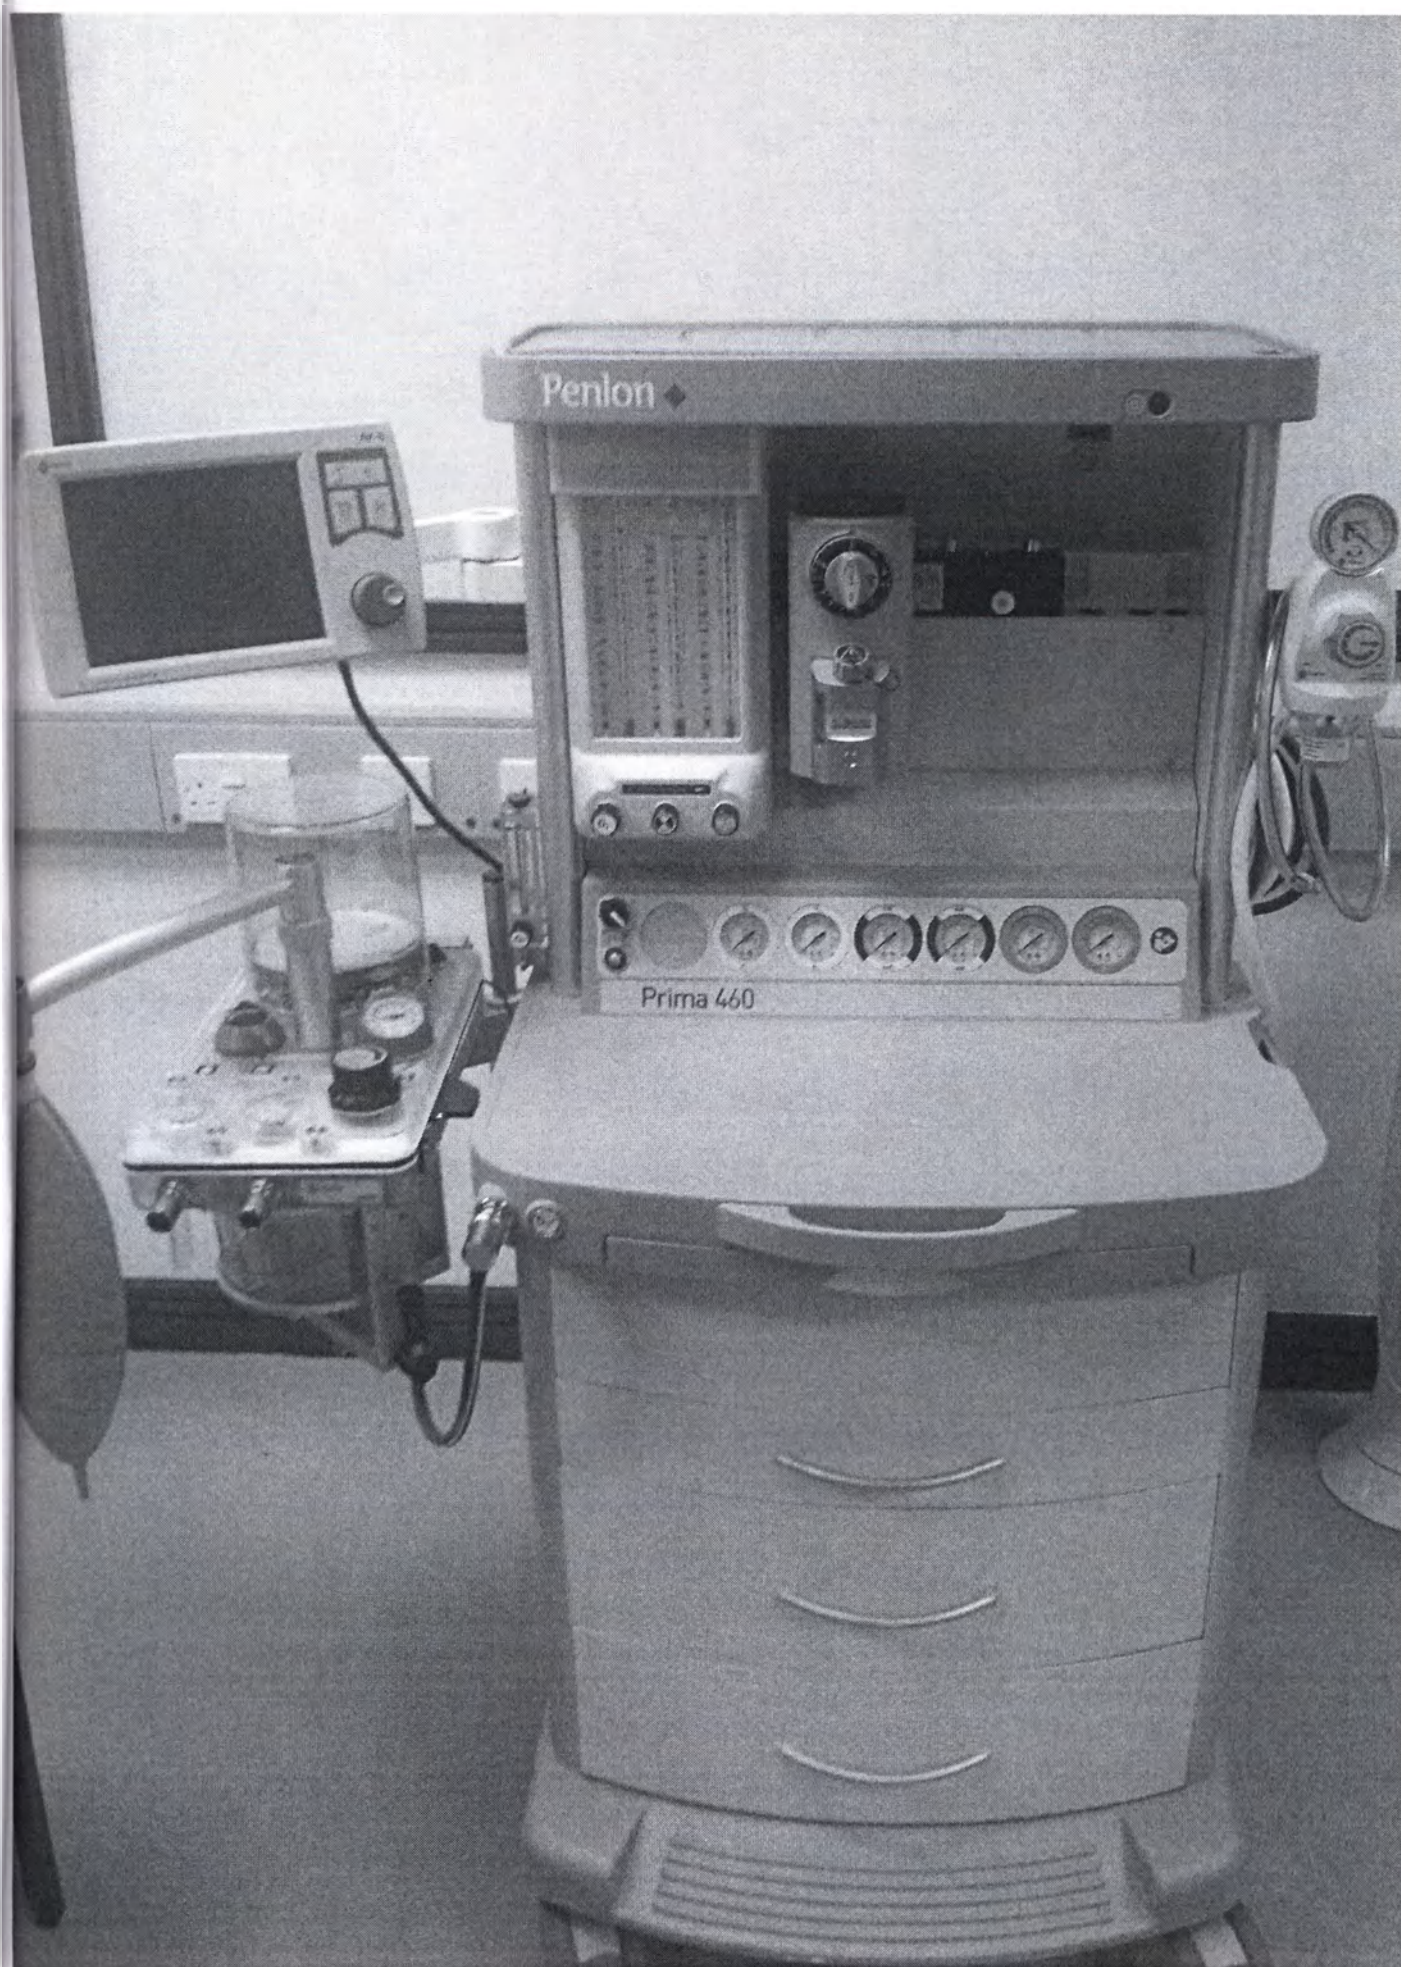



Блок аппарата базовый


(на фото Prima 450)

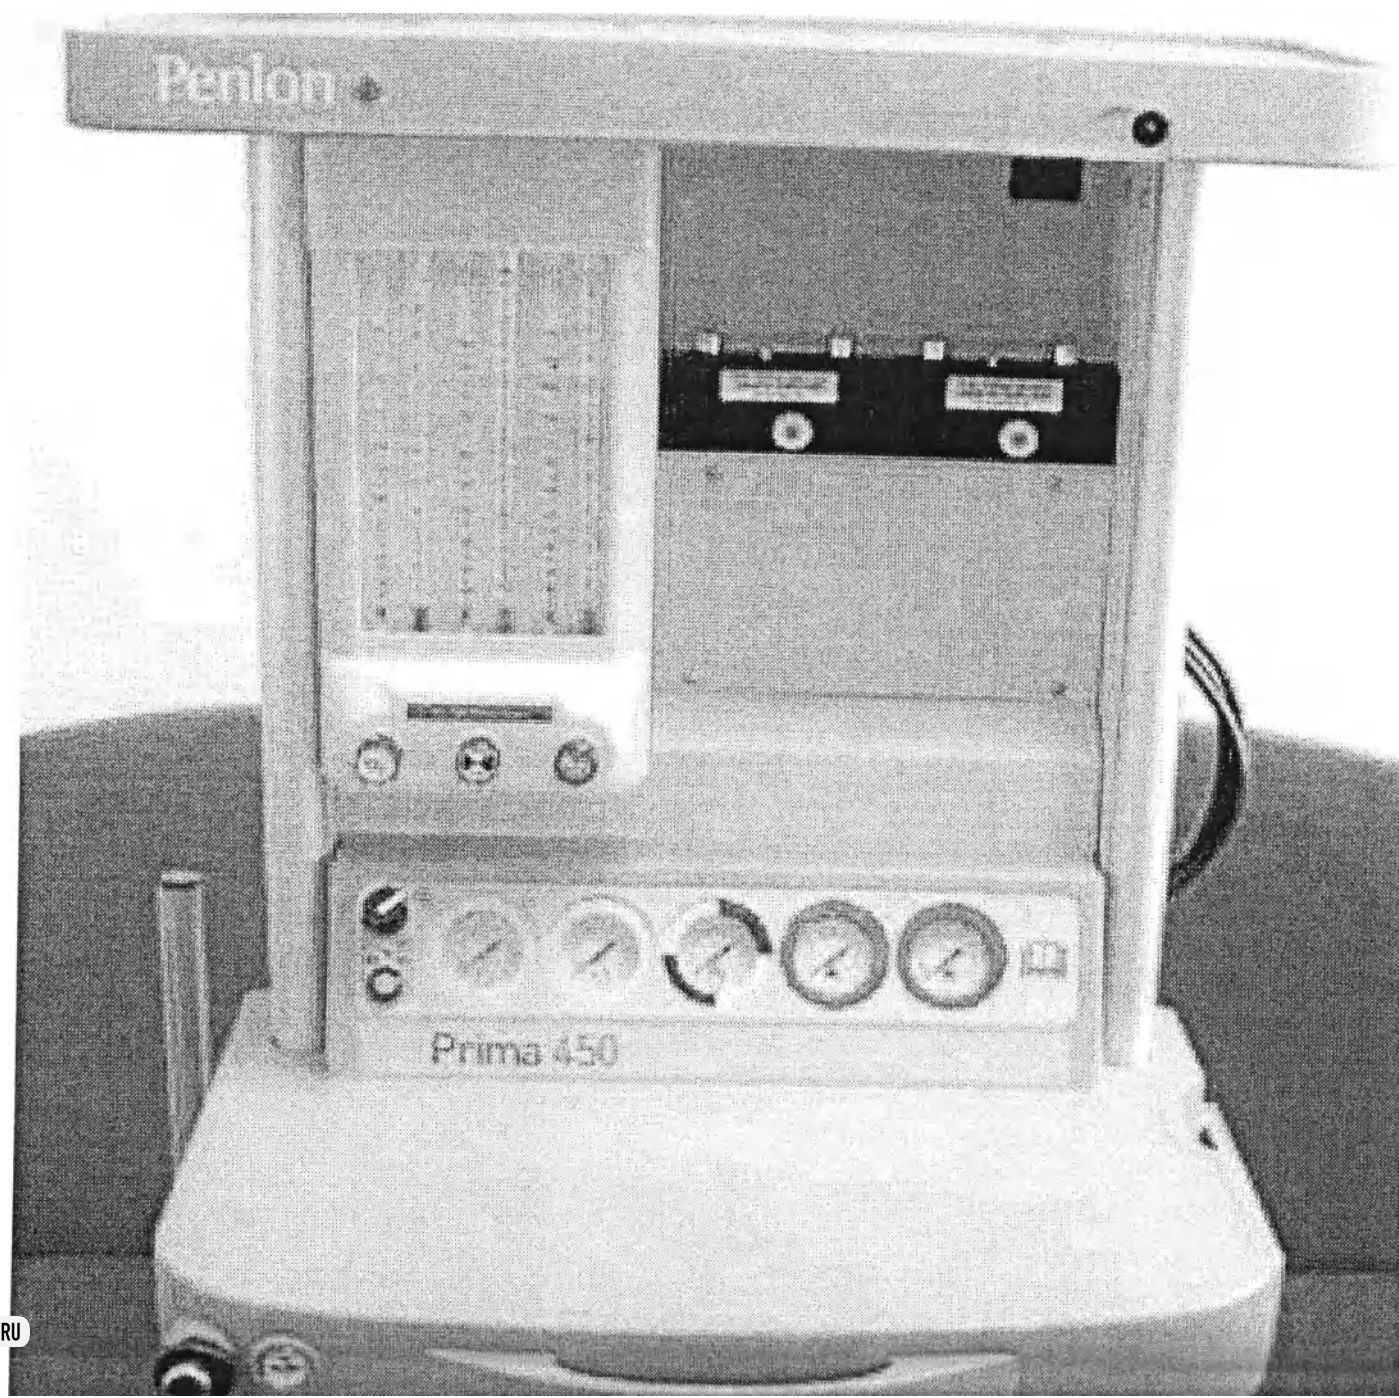




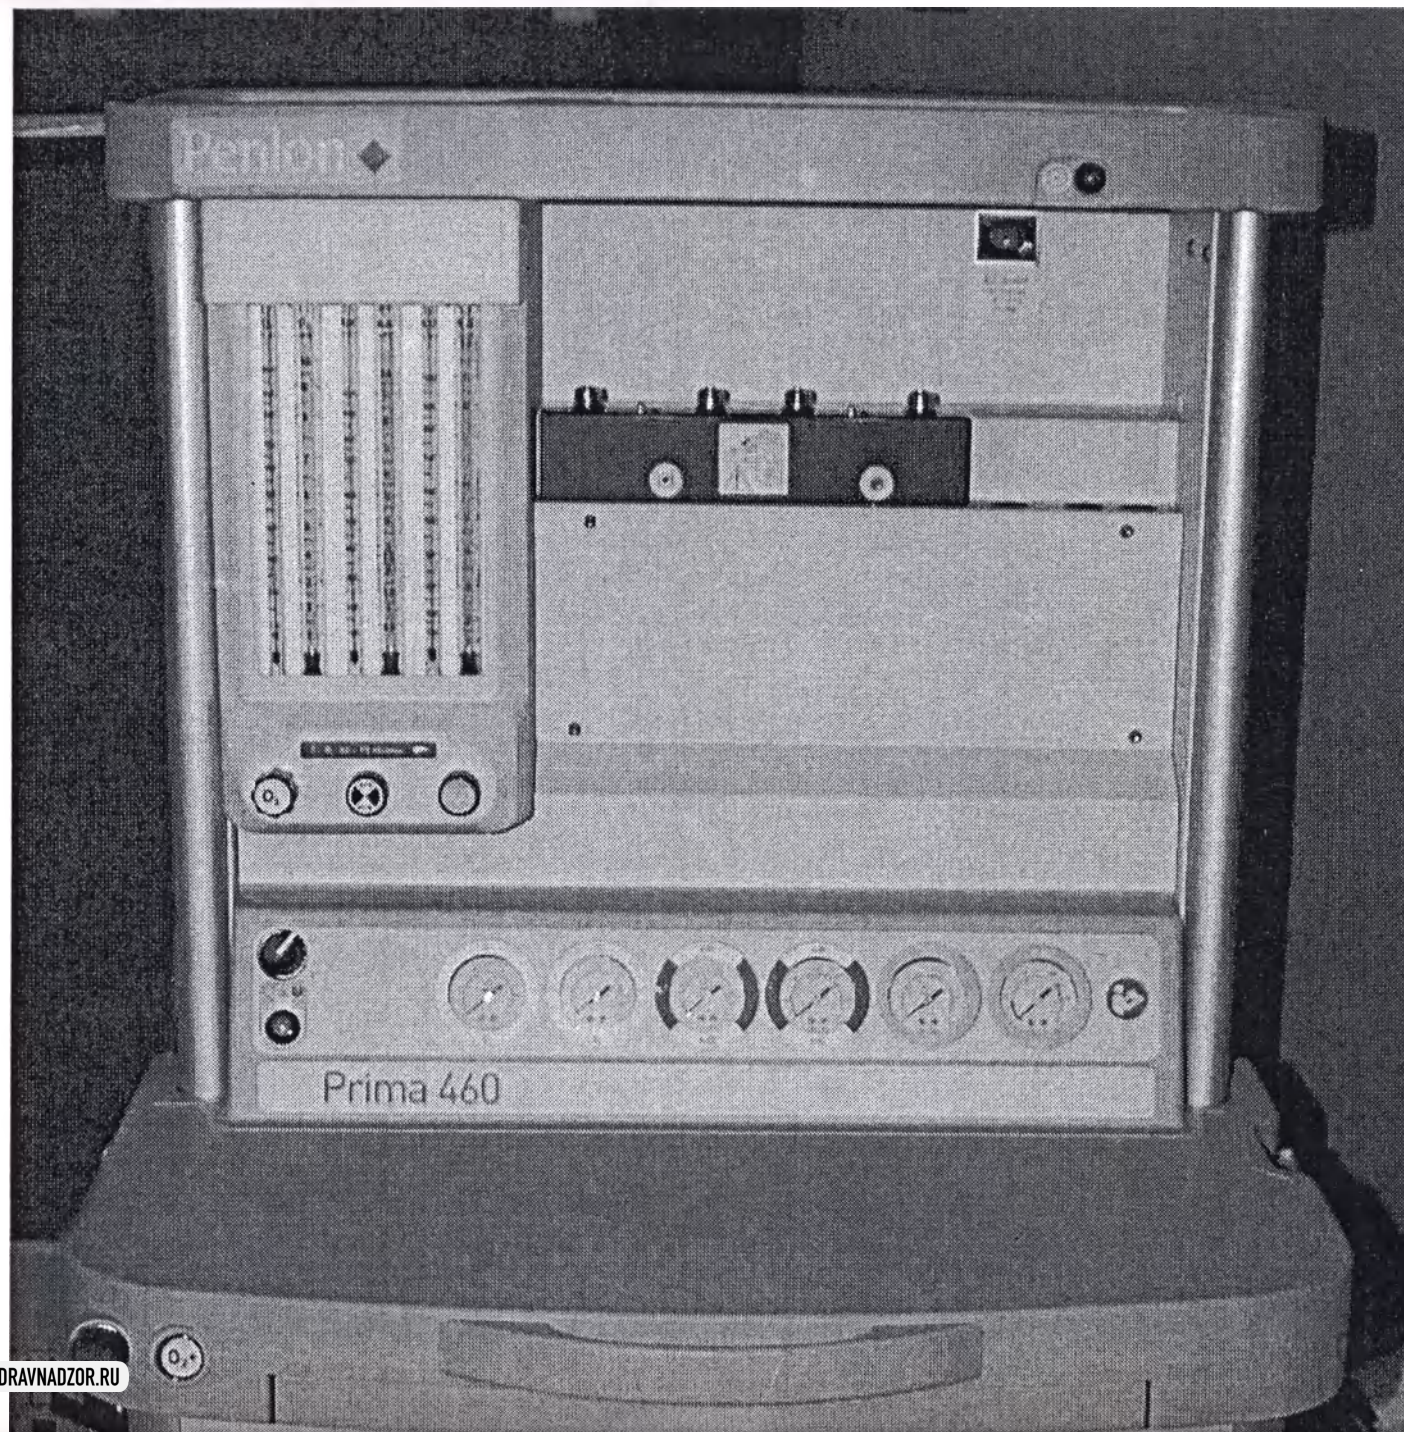


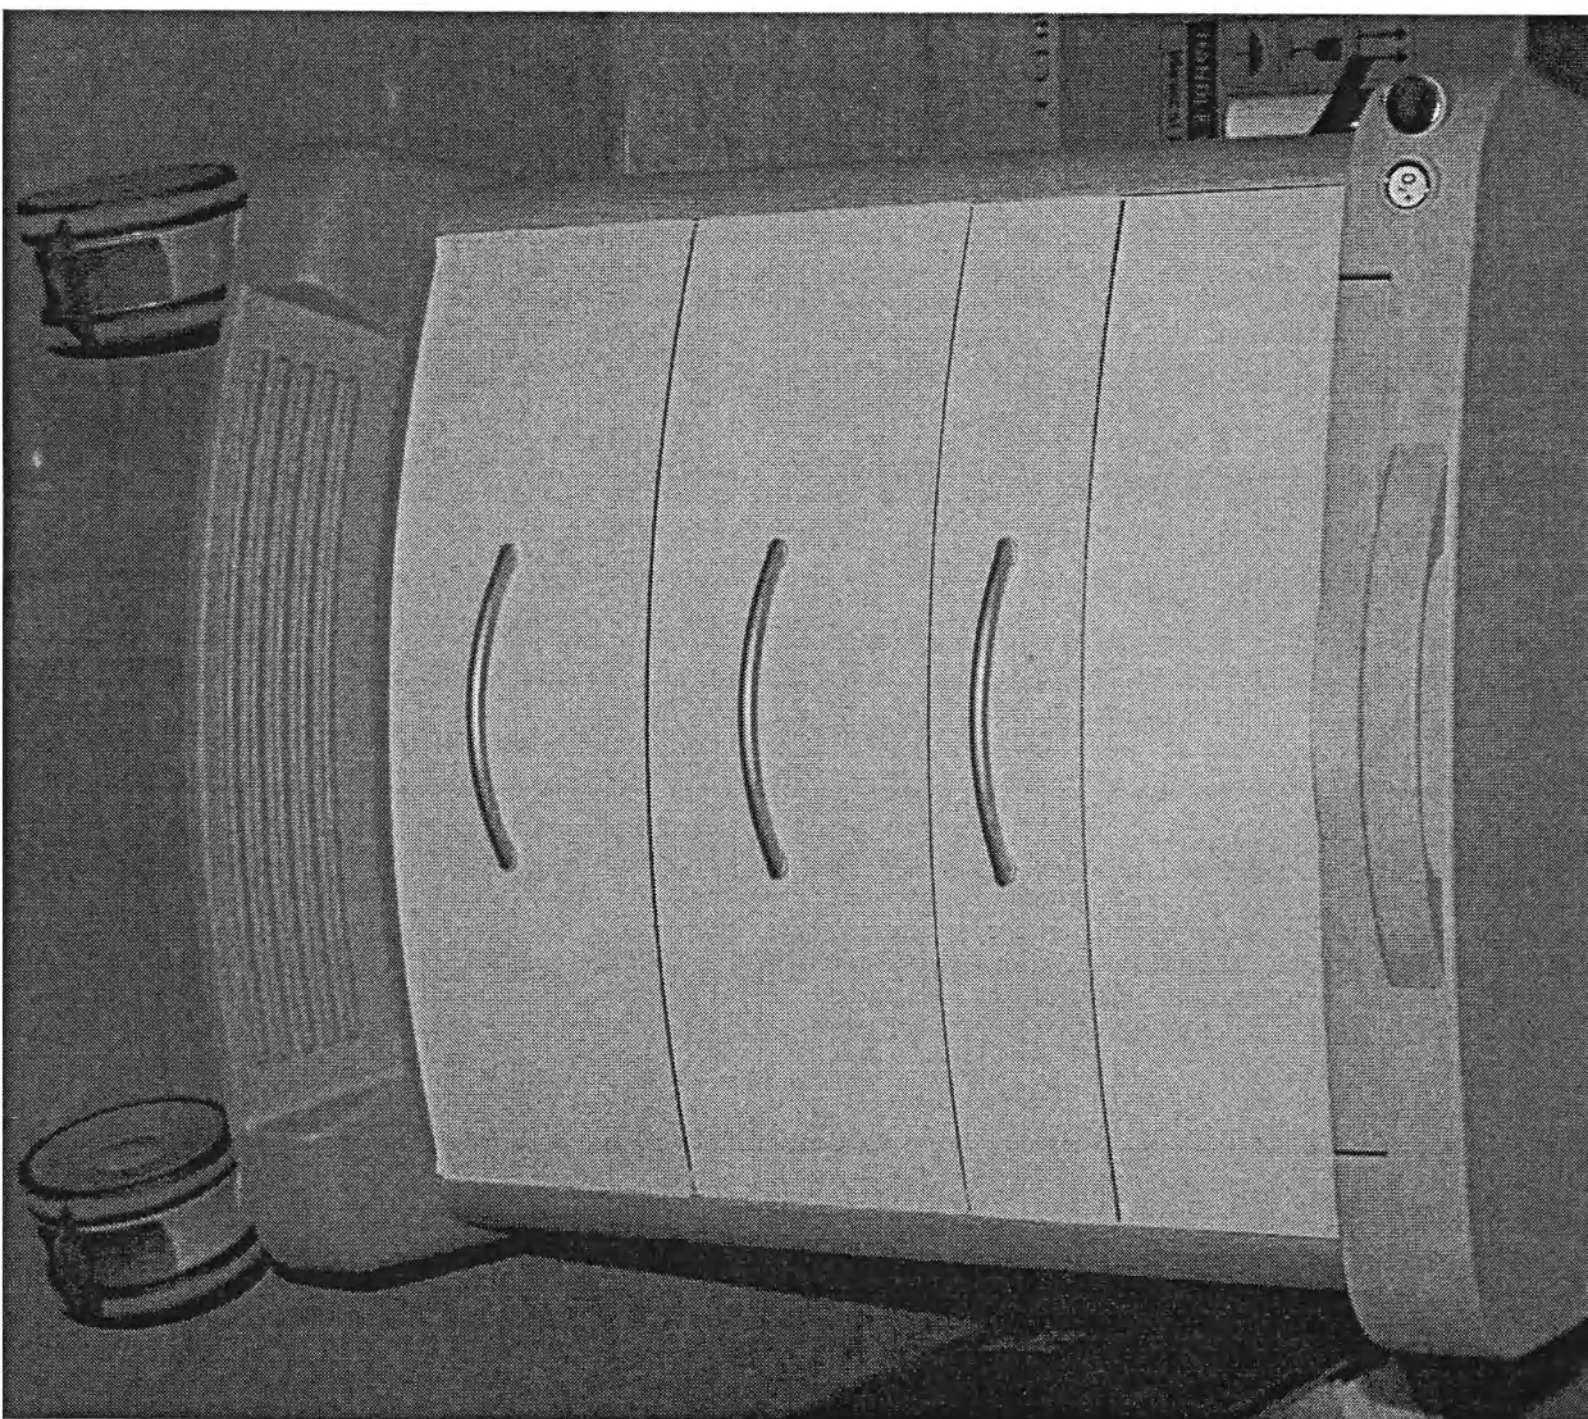


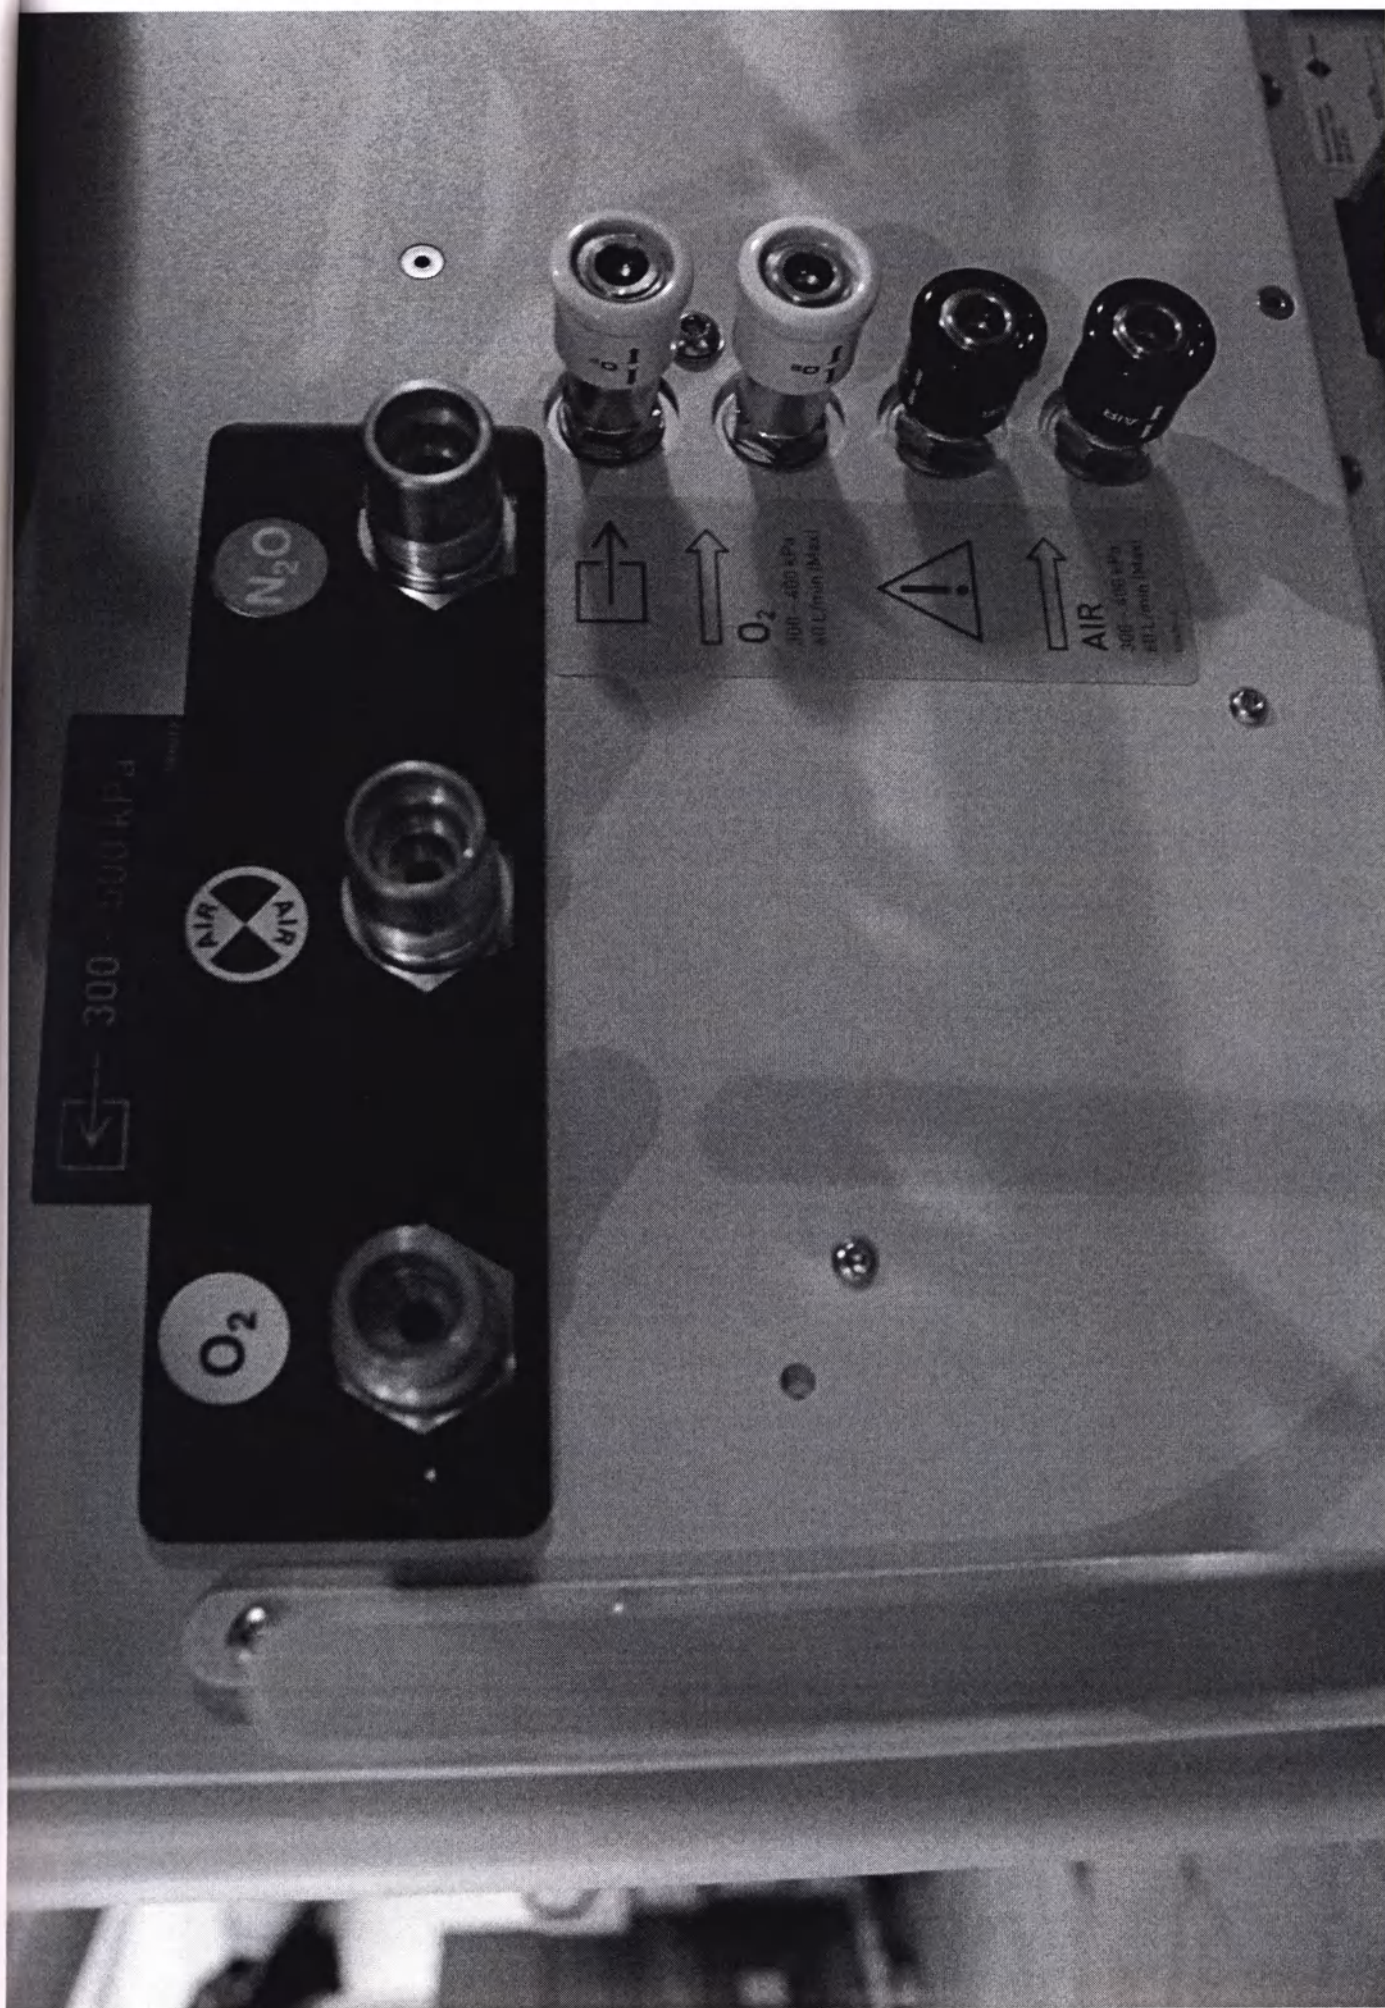

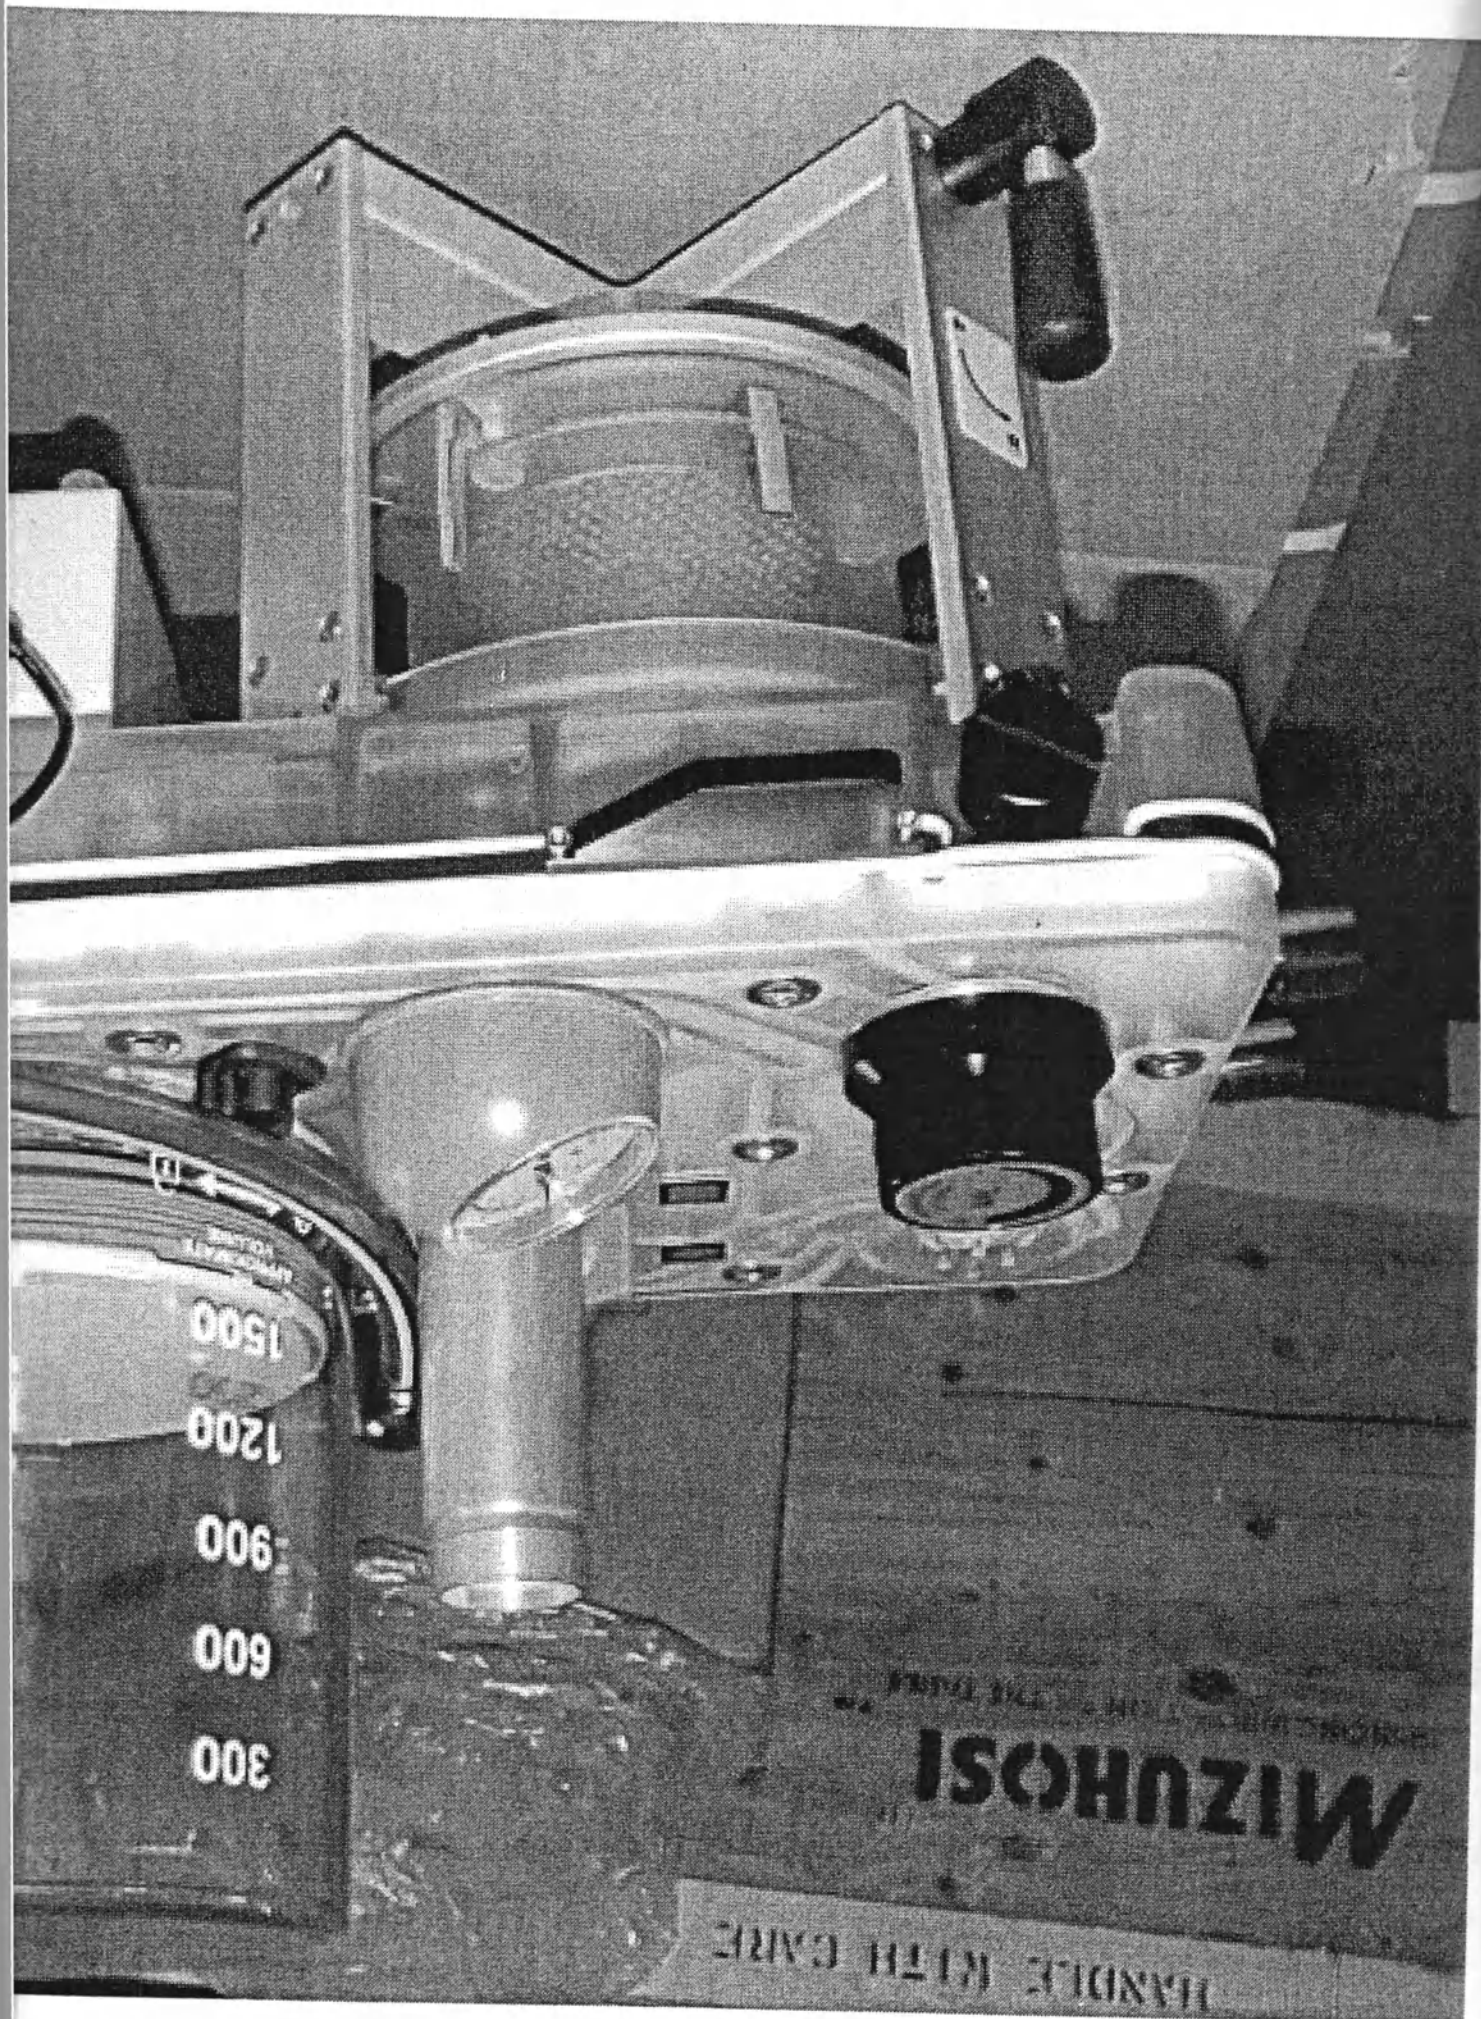

Вакуумная камера с подогревом, мехами, манометром и клапанами)

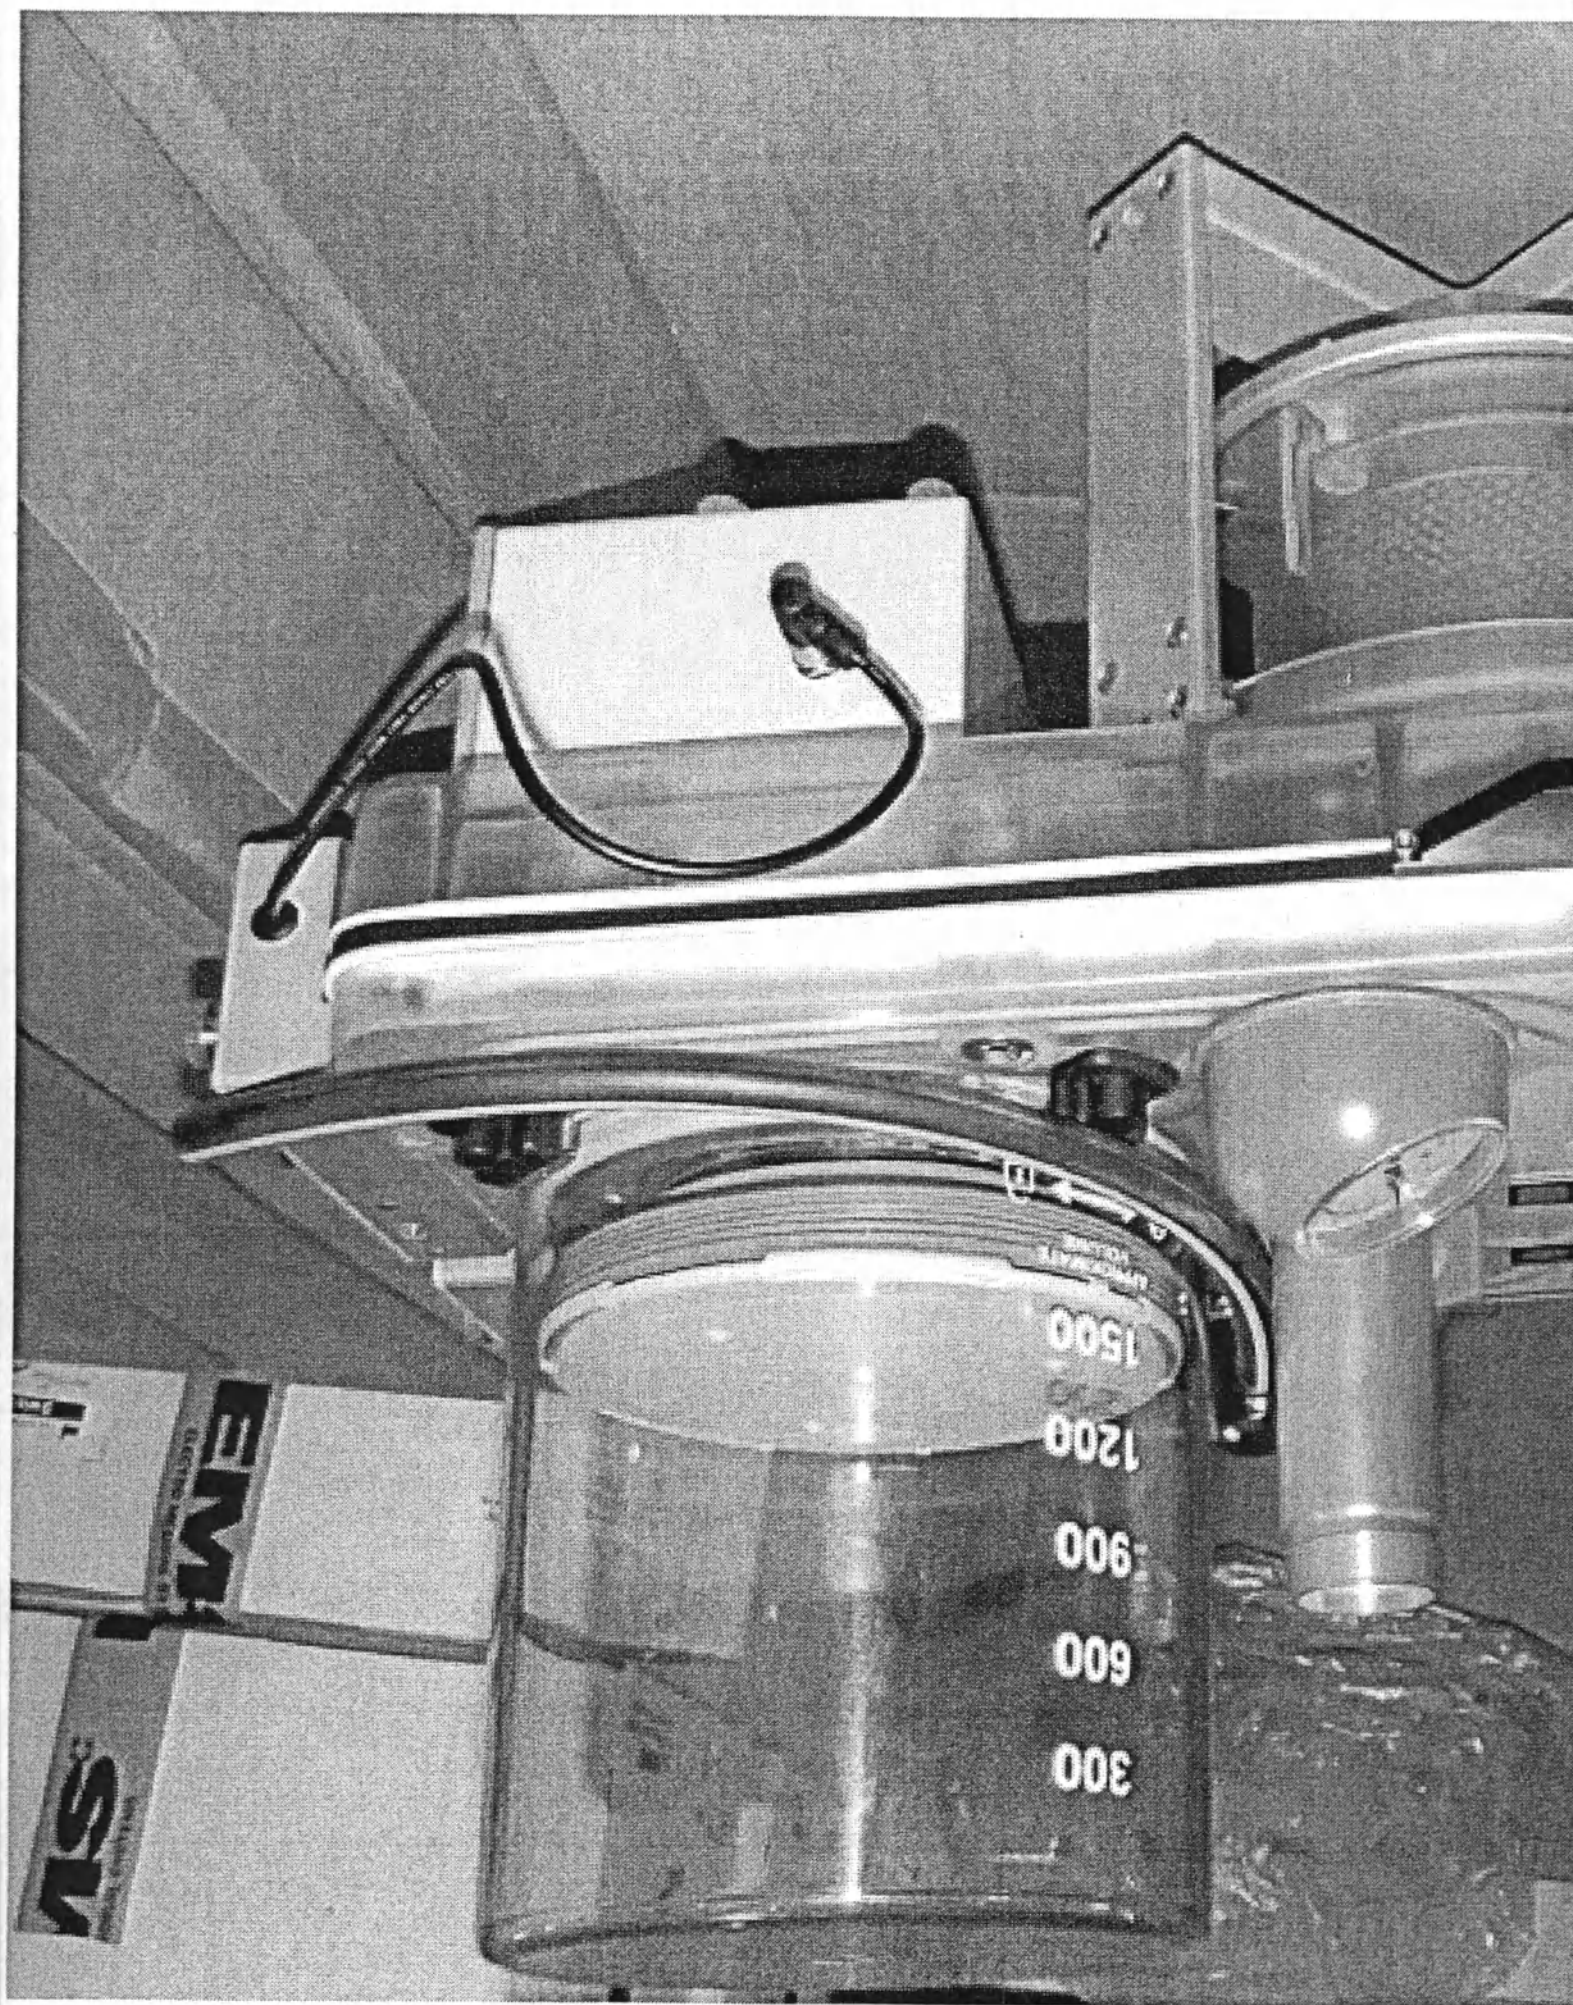

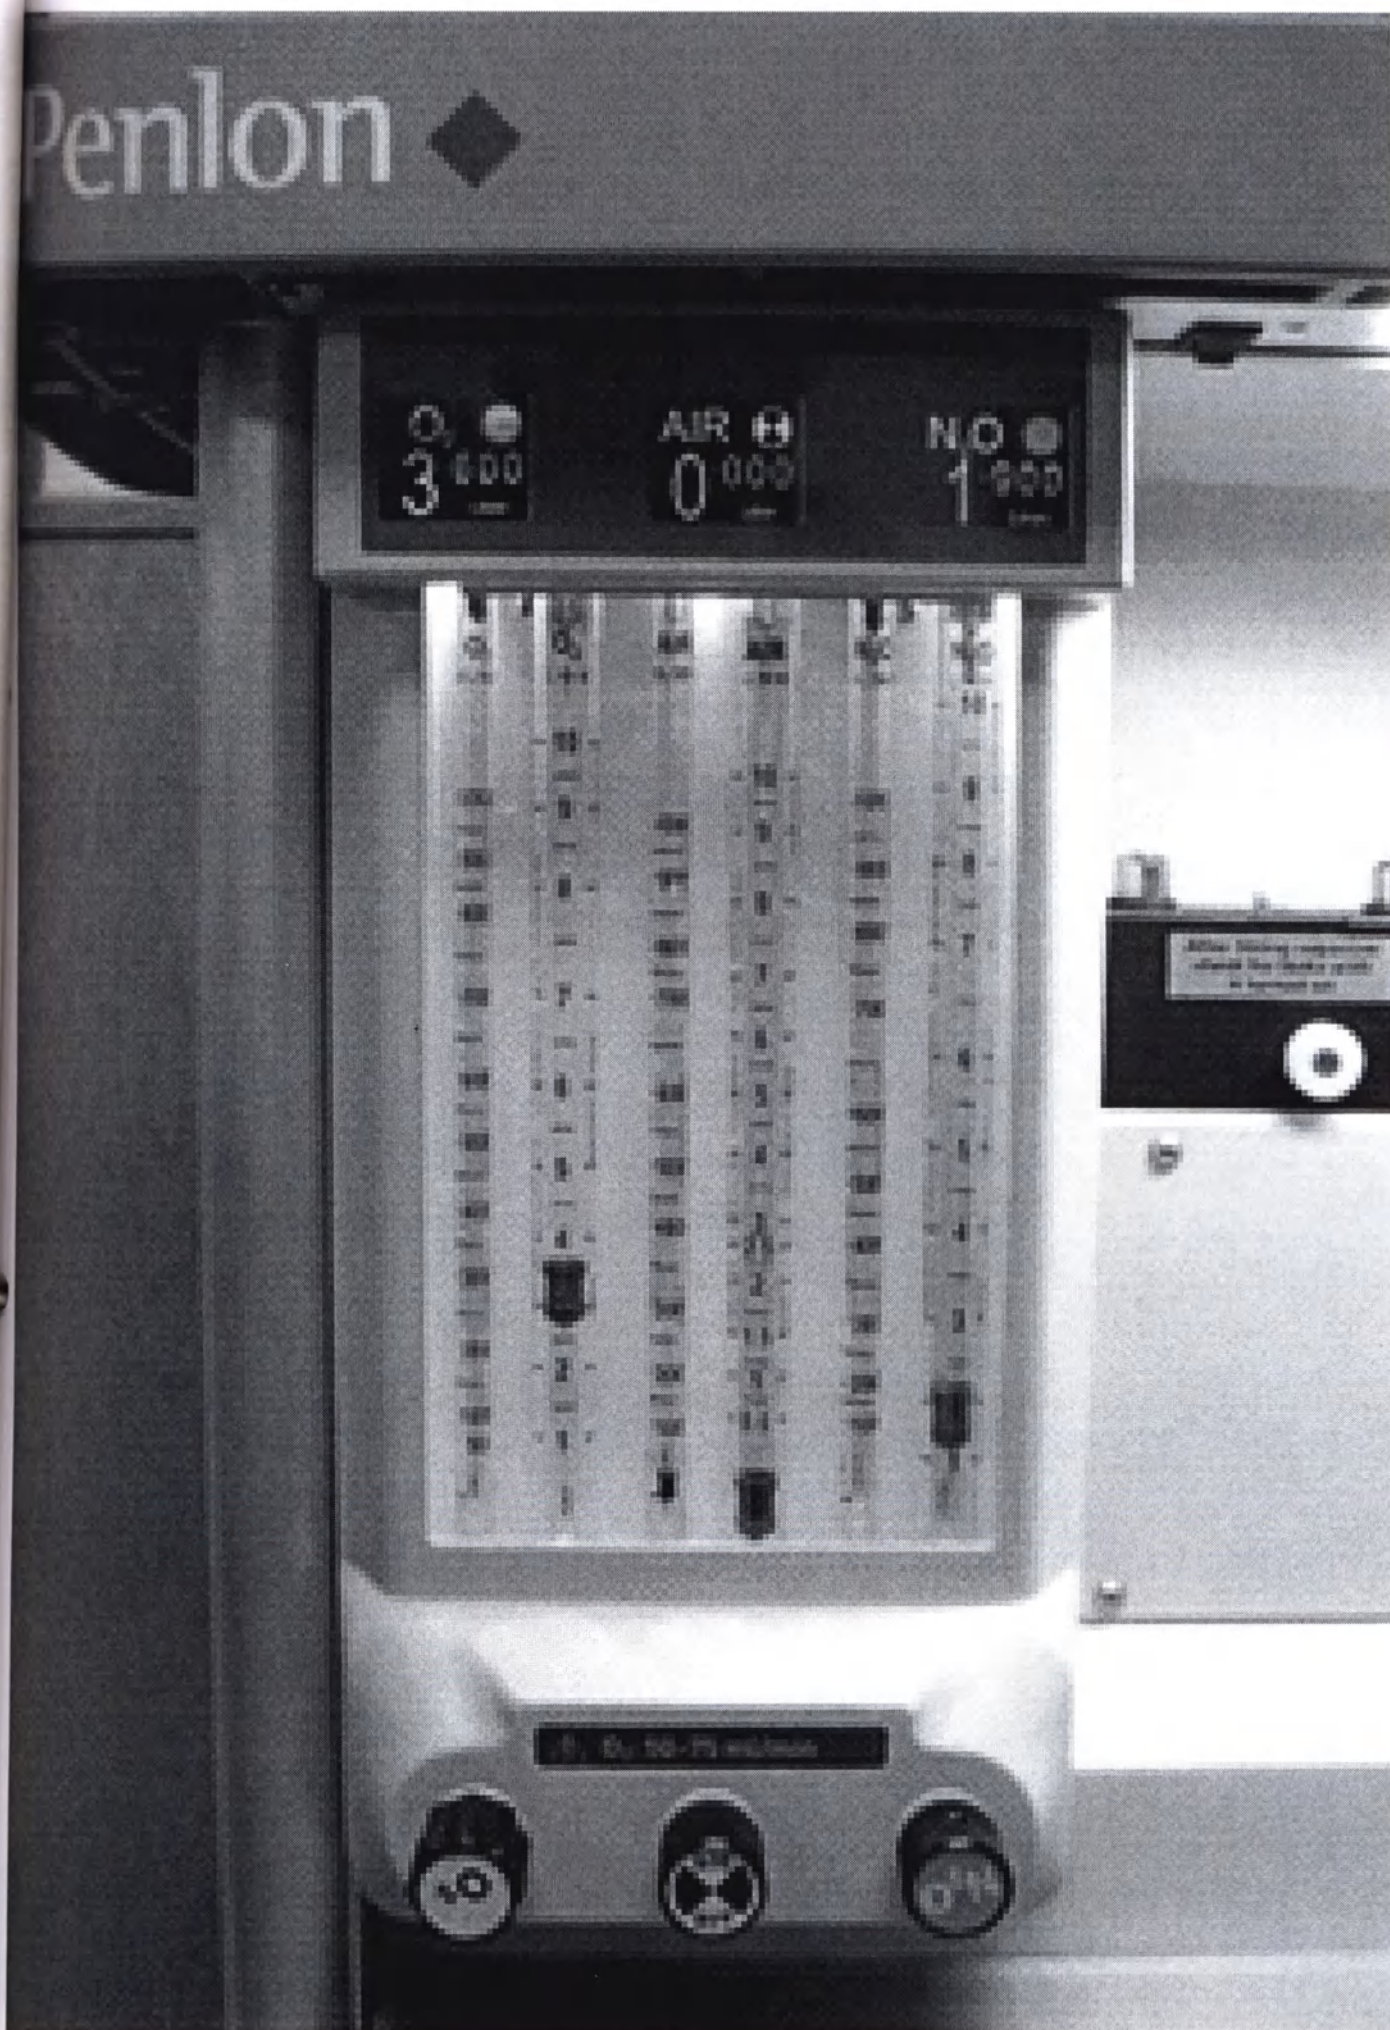

Вентилятор ИВЛ




Шланг вентилятора с адаптером




Аппарат наркозно-дыхательный Prima
модели: Prima 450, Prima 460


Руководство
по эксплуатации

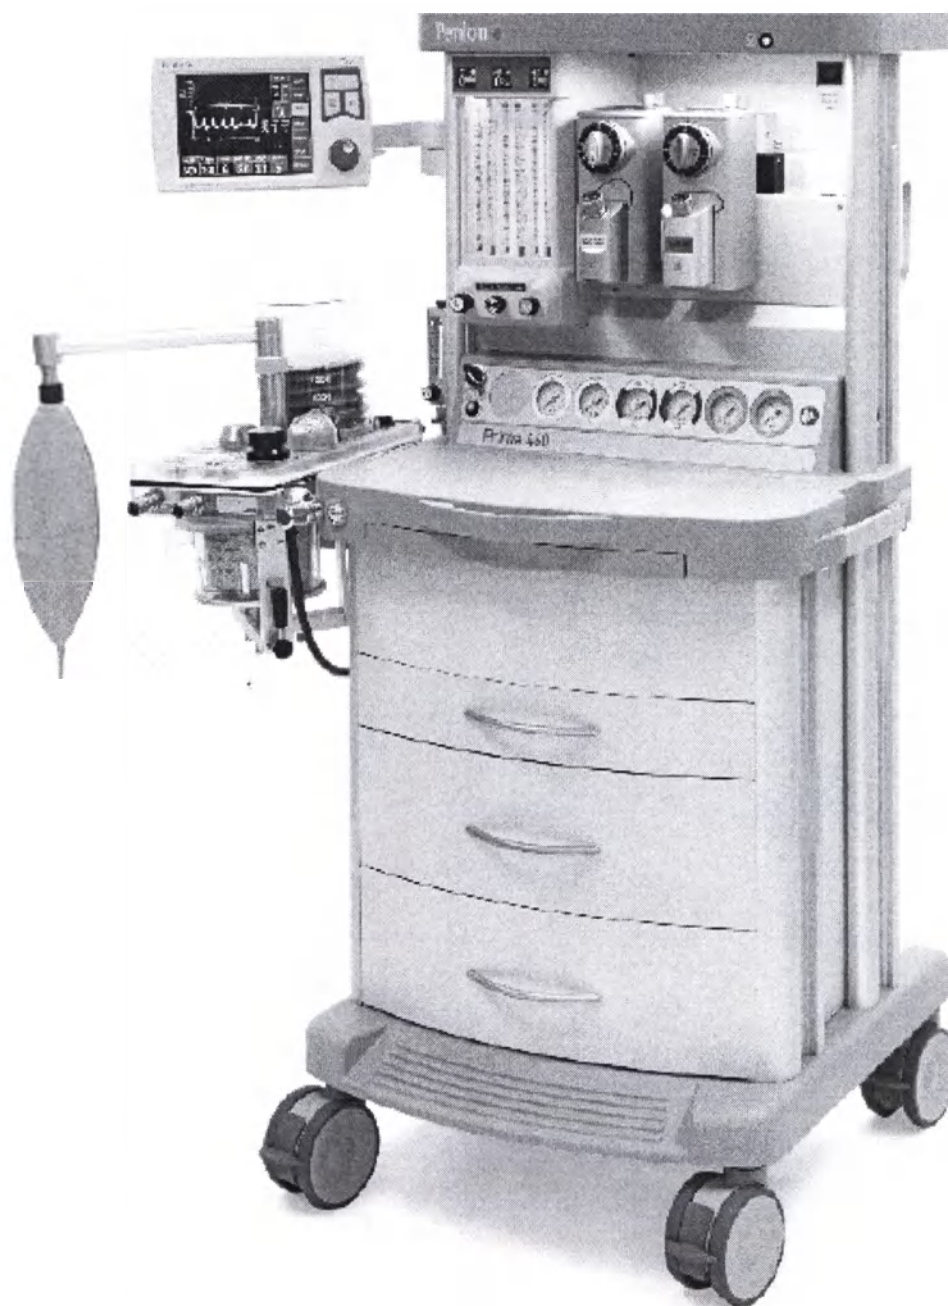

производства Penlon Ltd., Великобритания

Penlon ◆

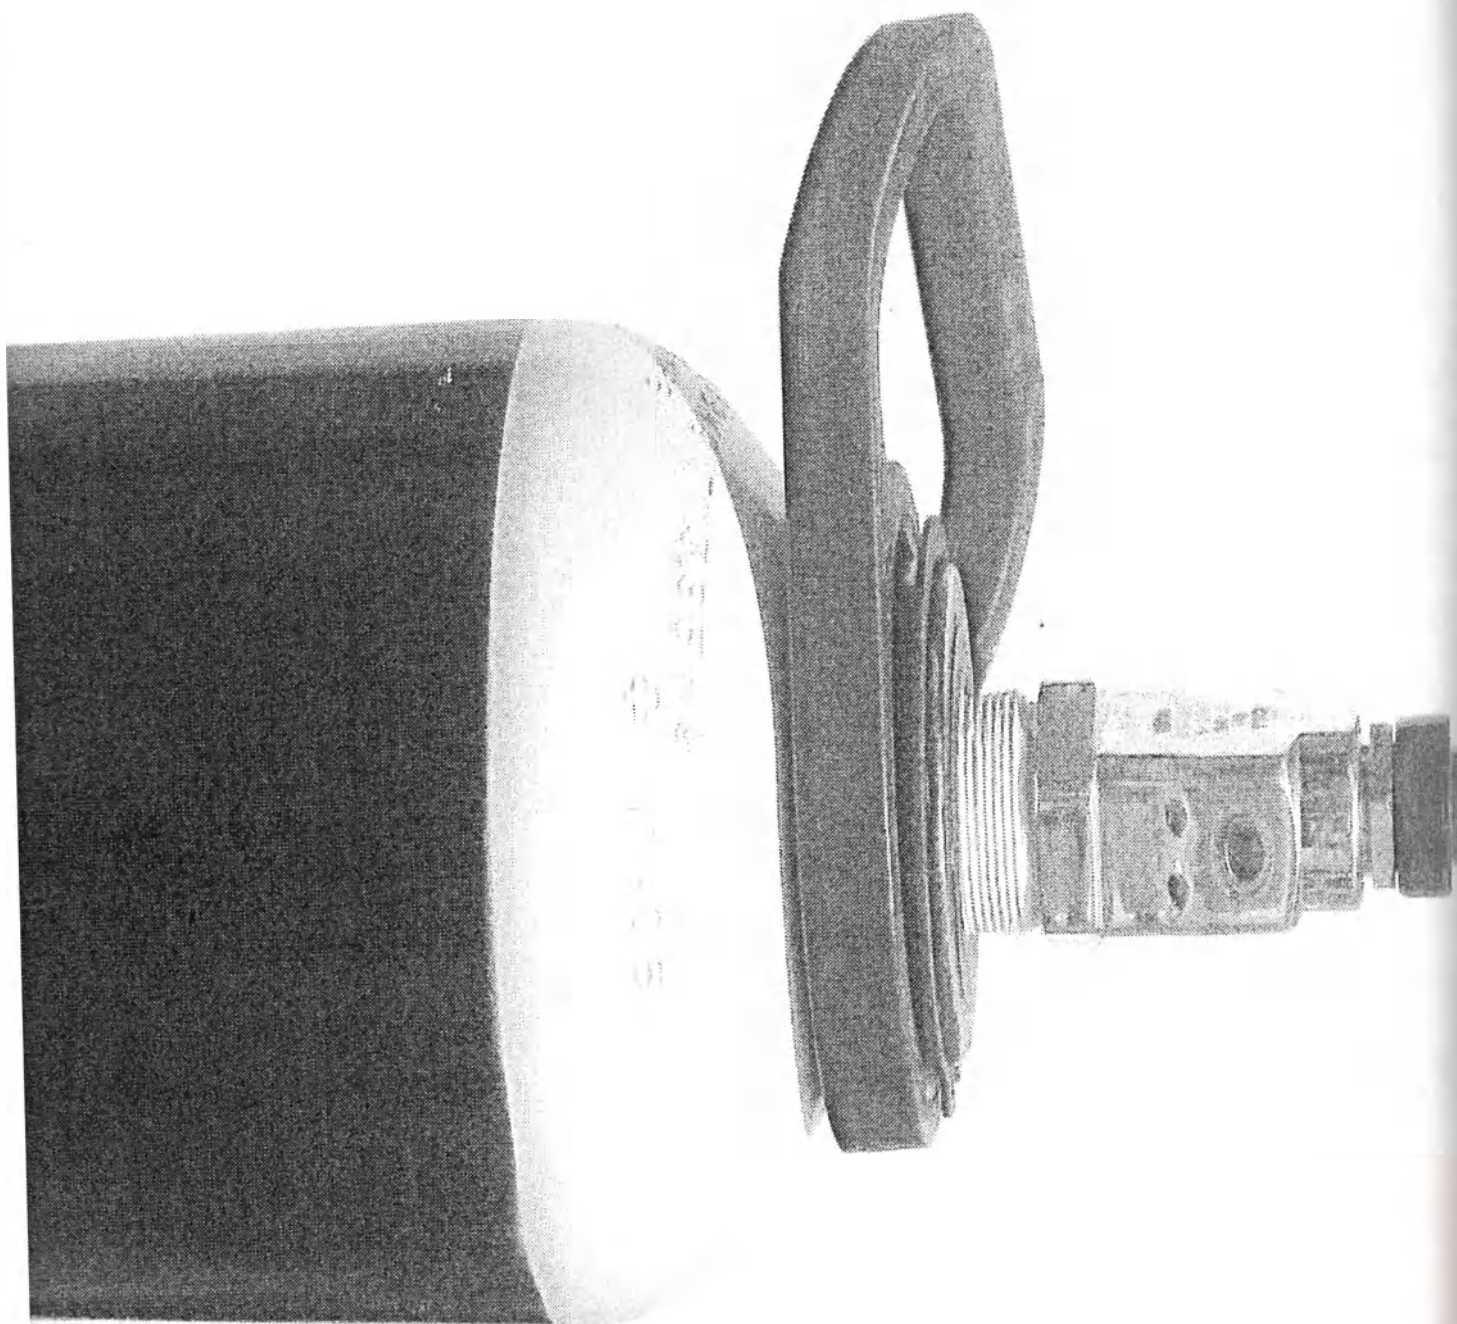

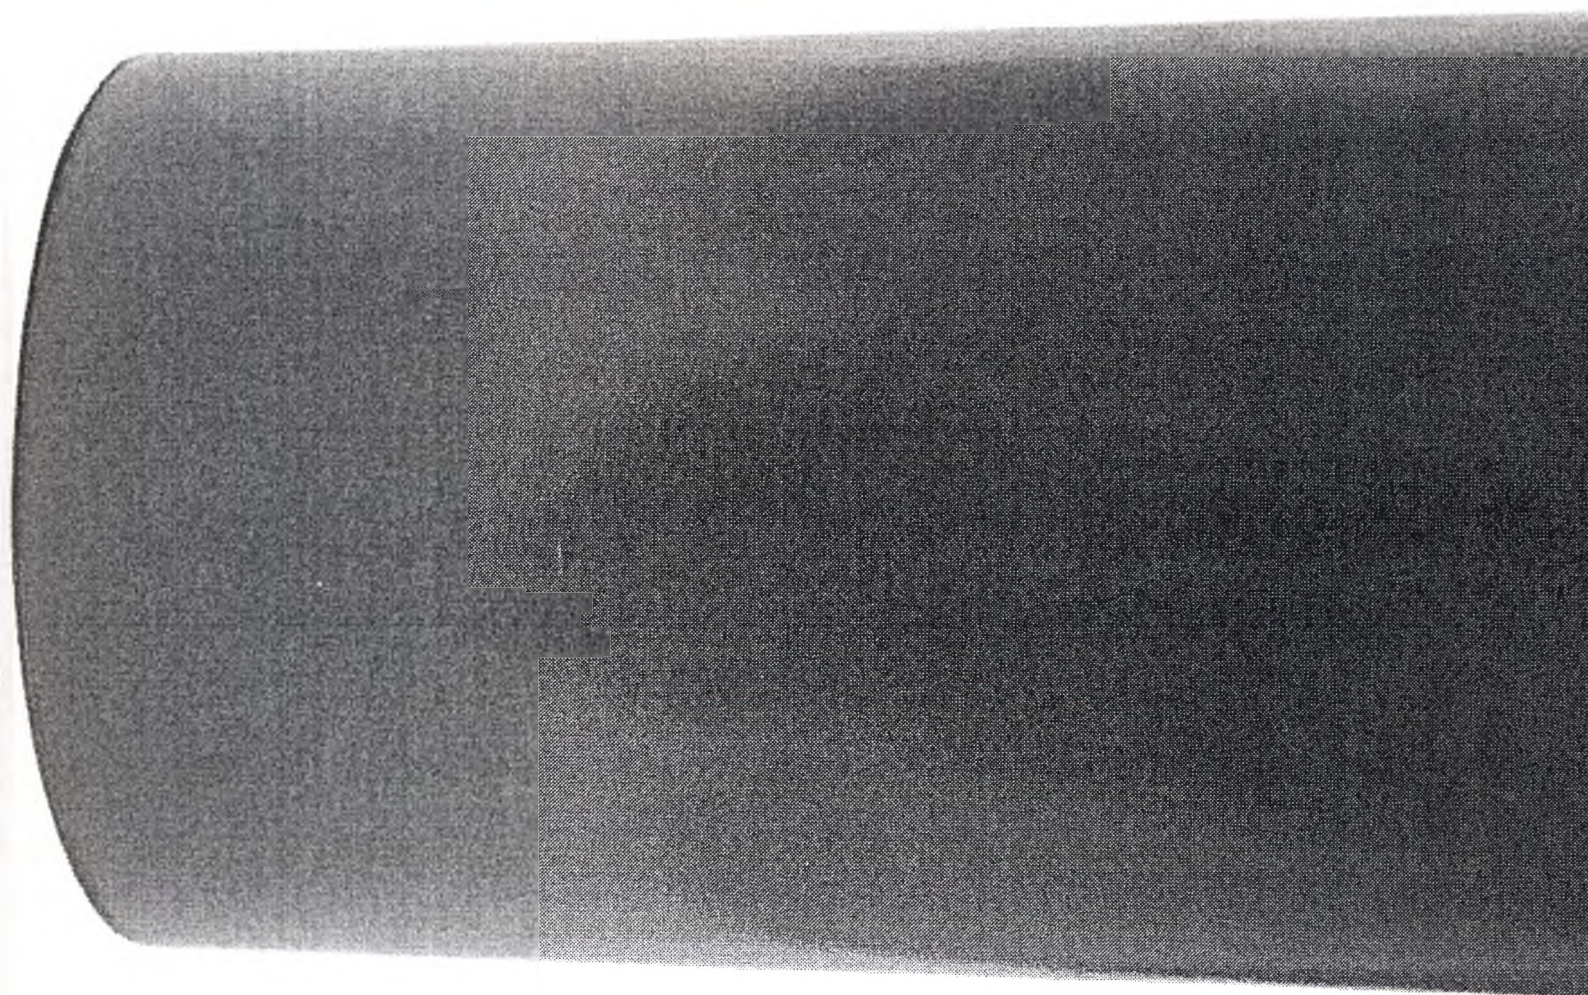

Баллон газовый для закиси азота




Баллон газовый для воздуха











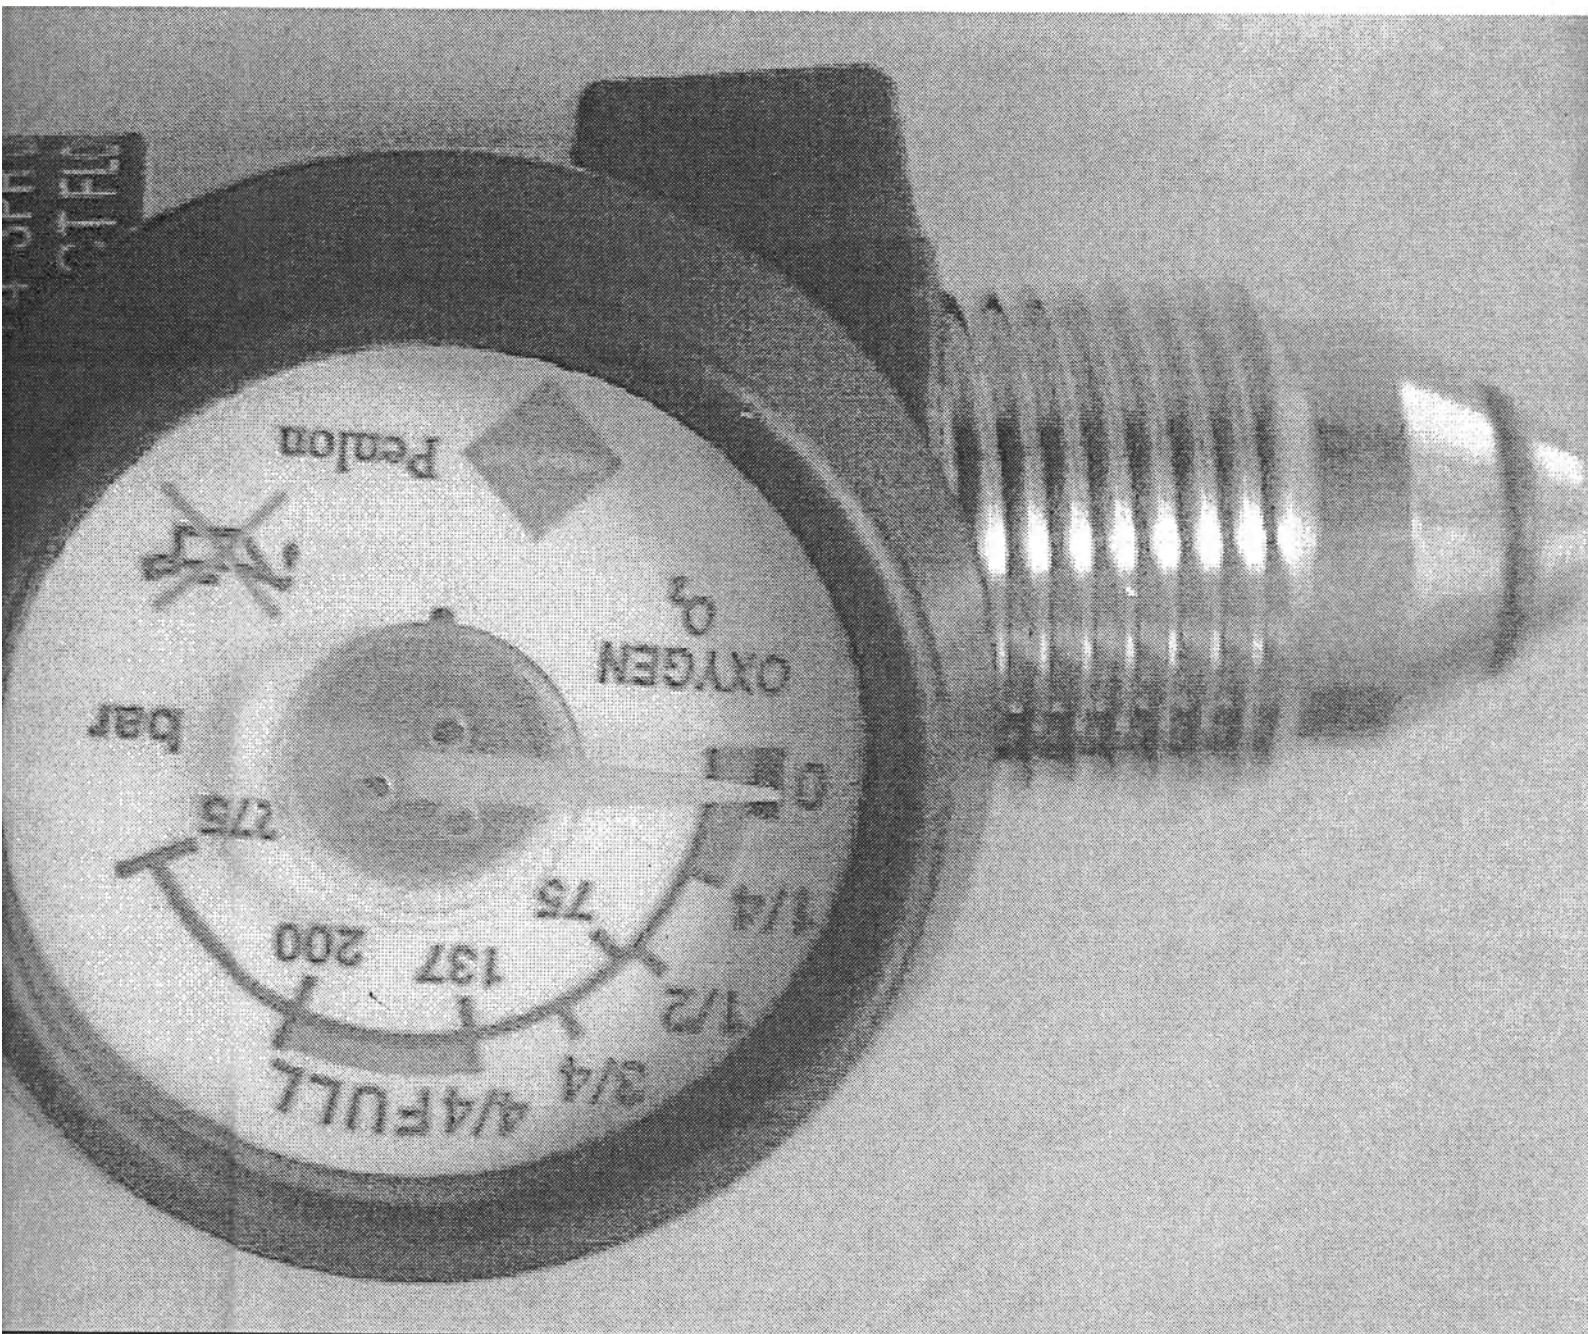

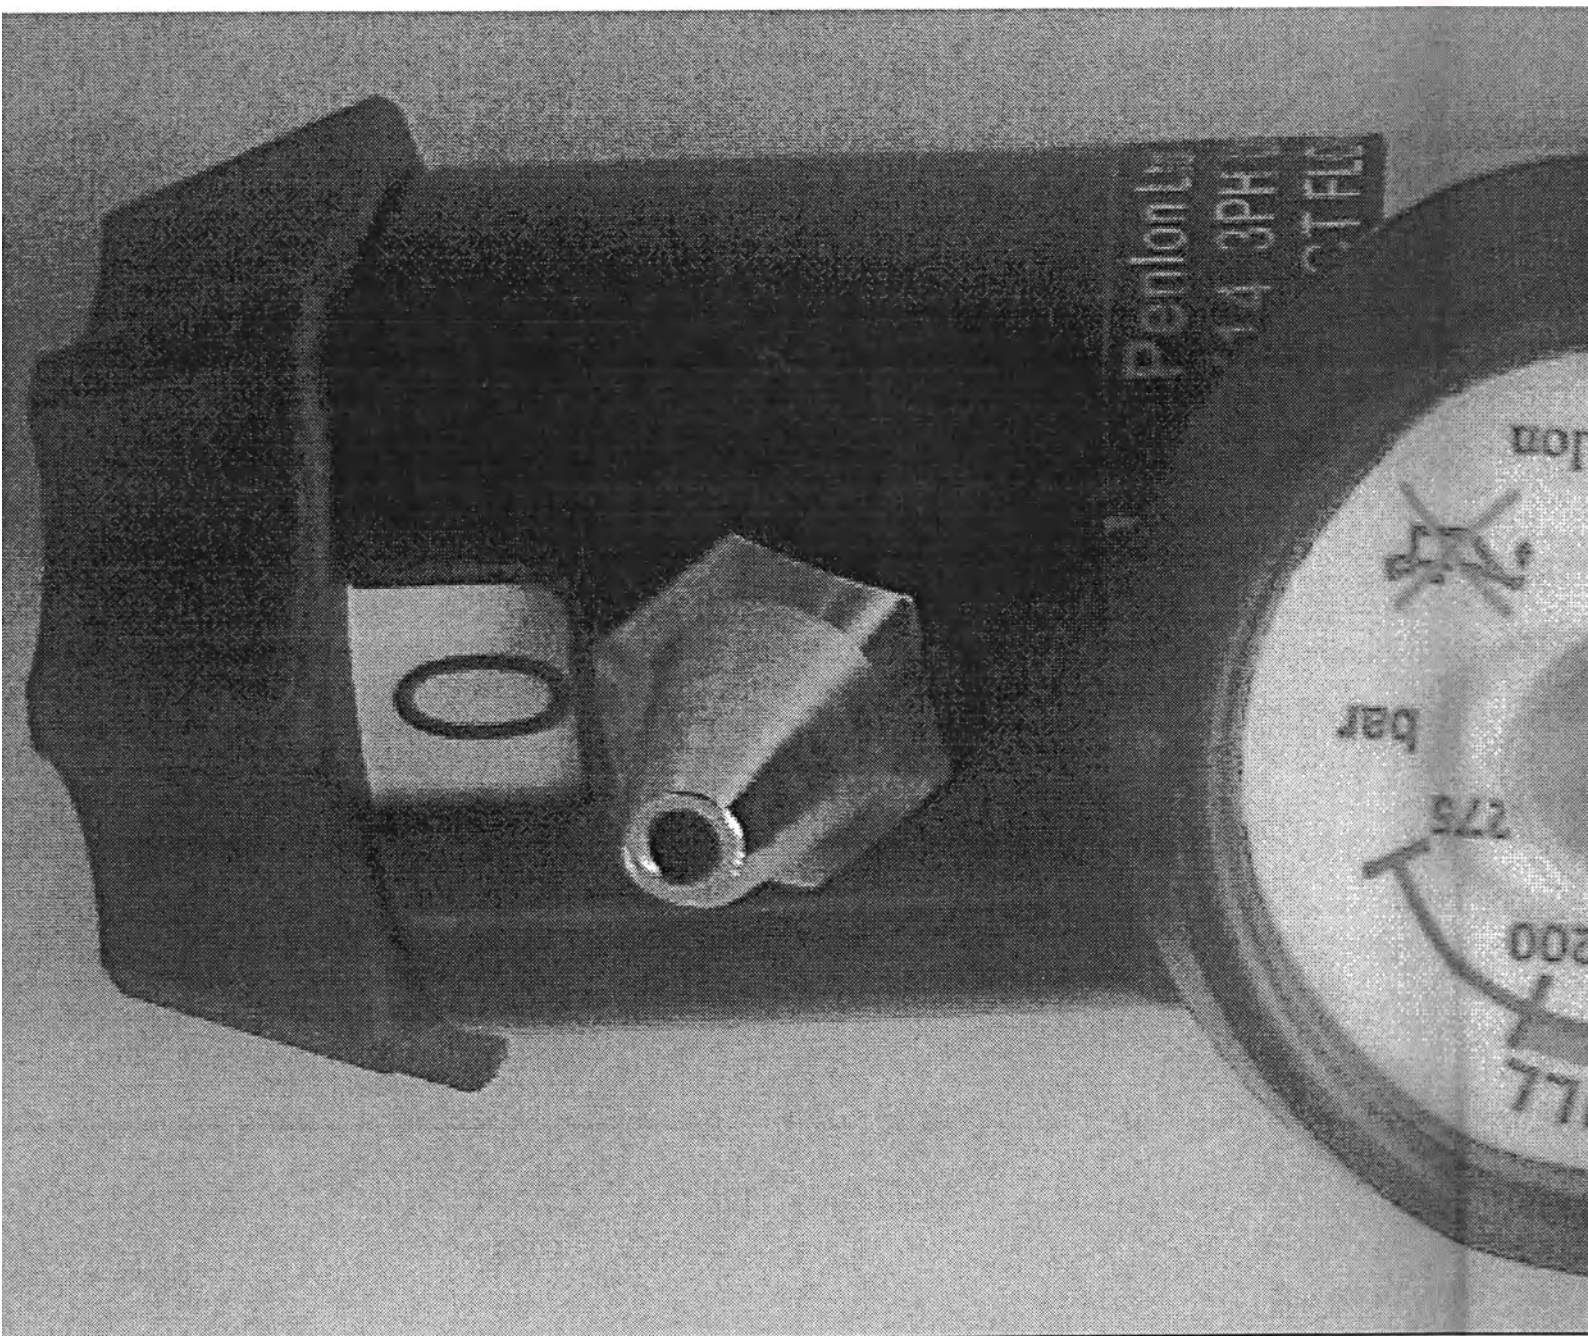


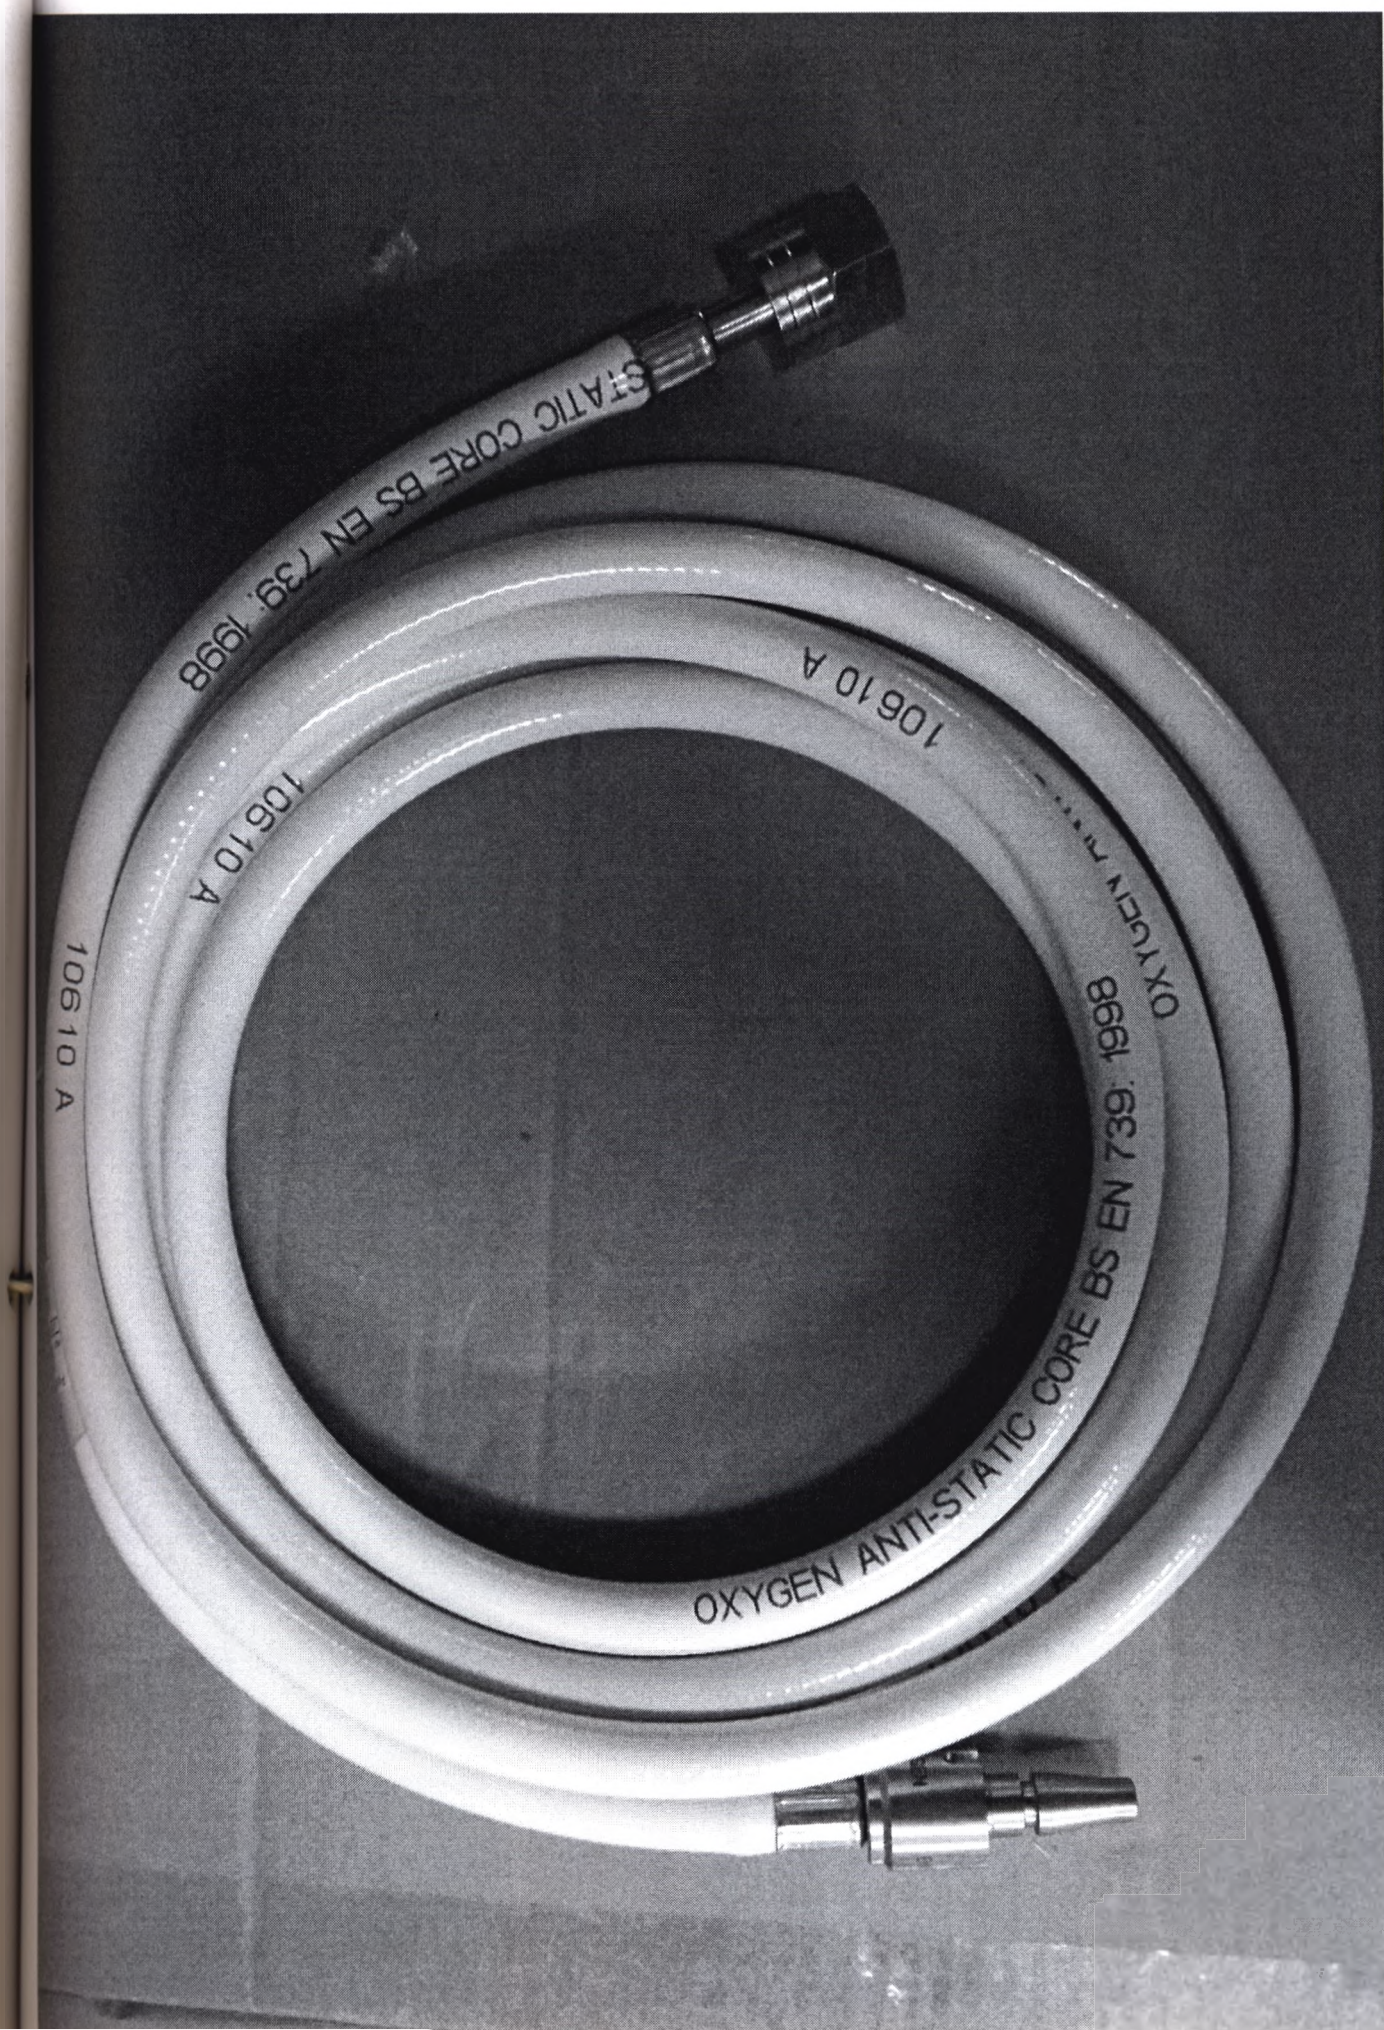







Шланги вакуума с коннекторами

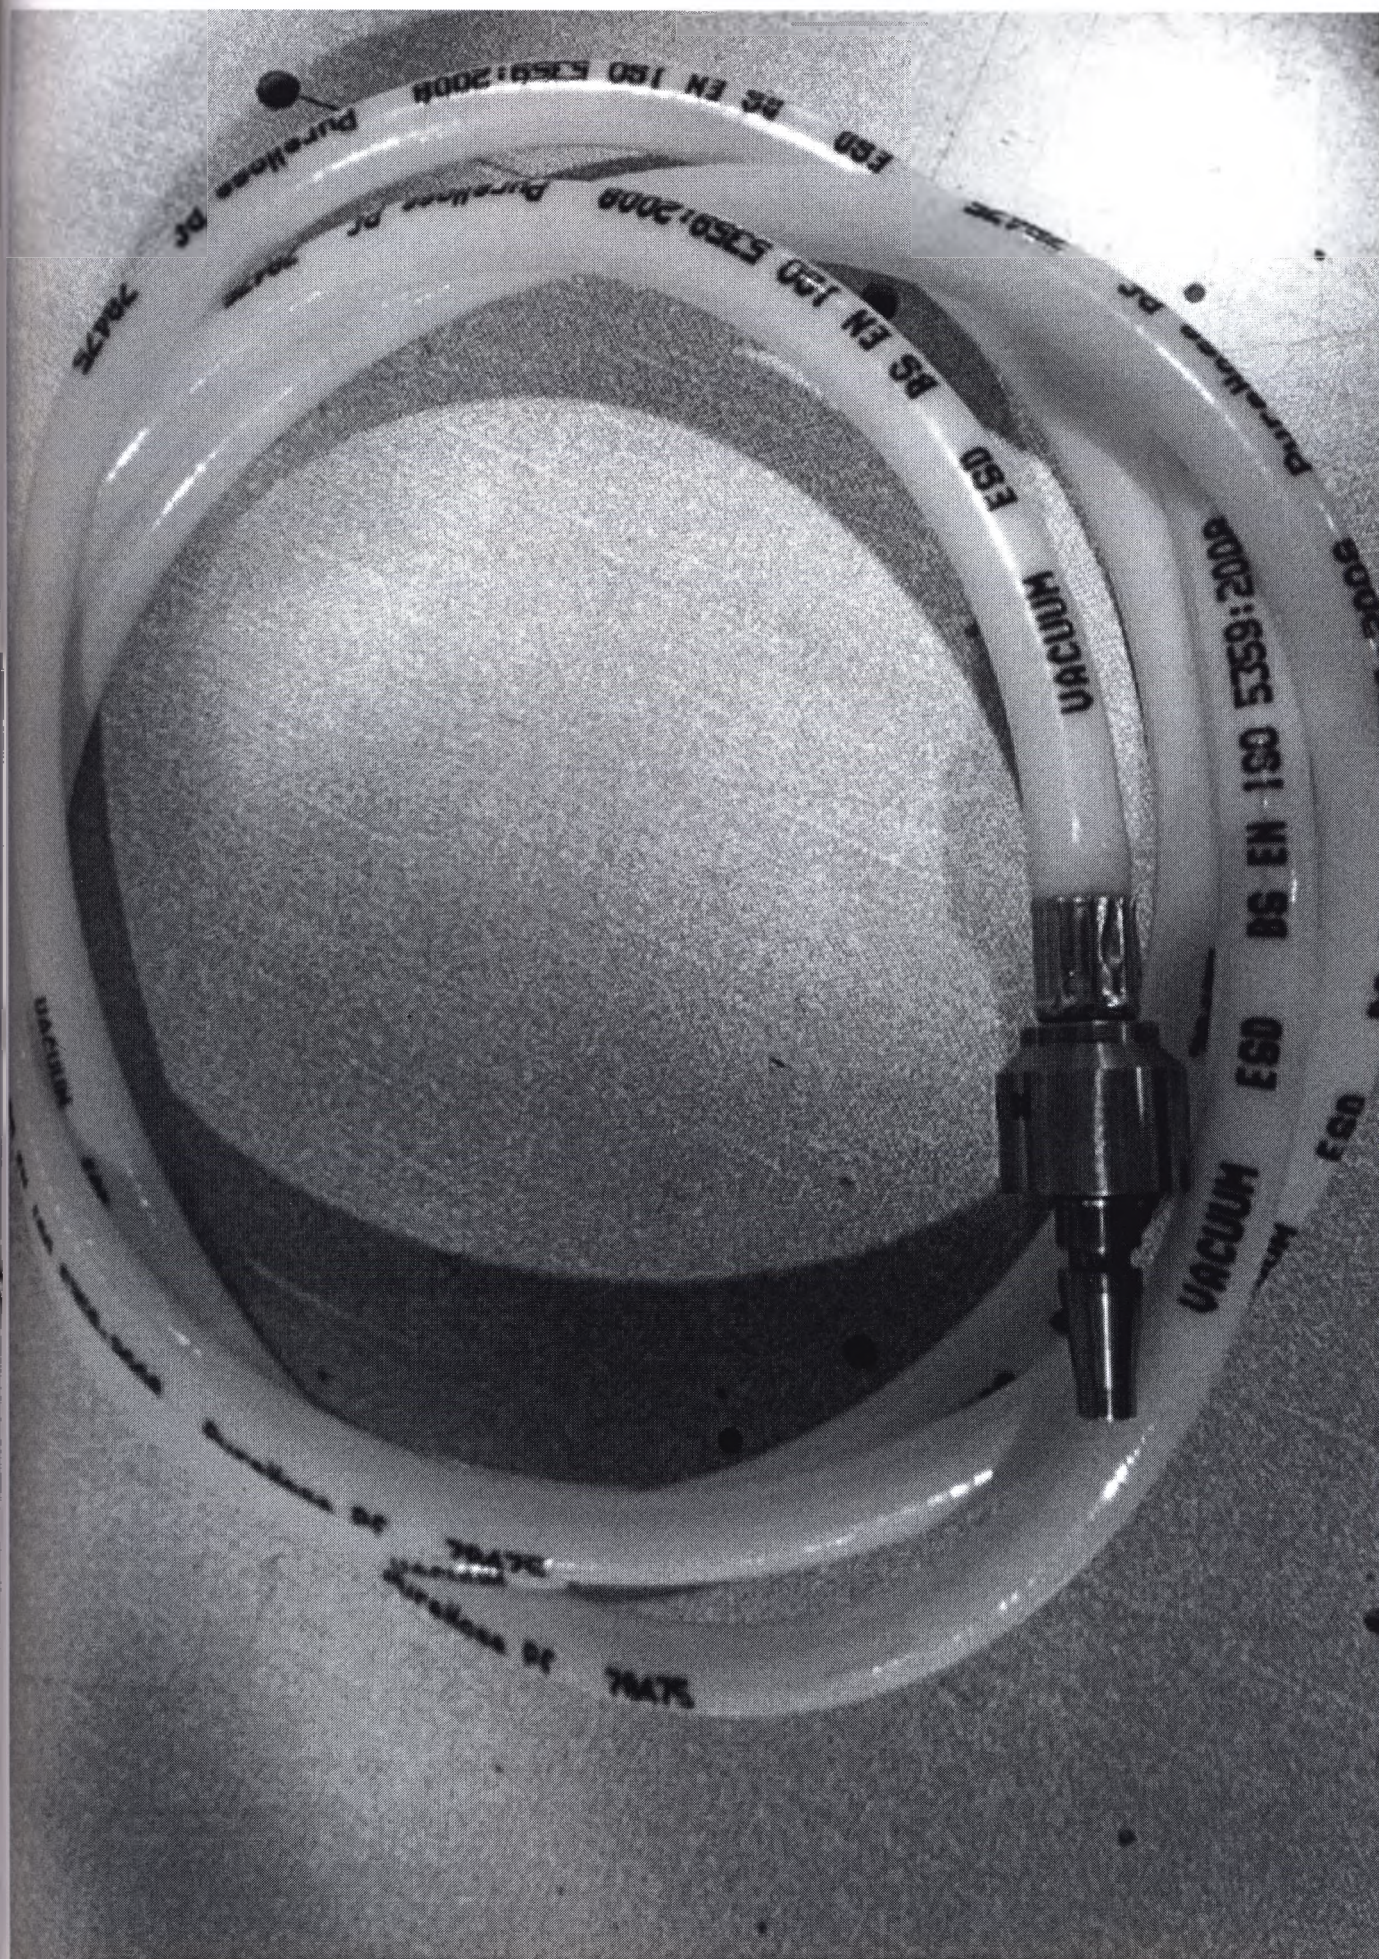




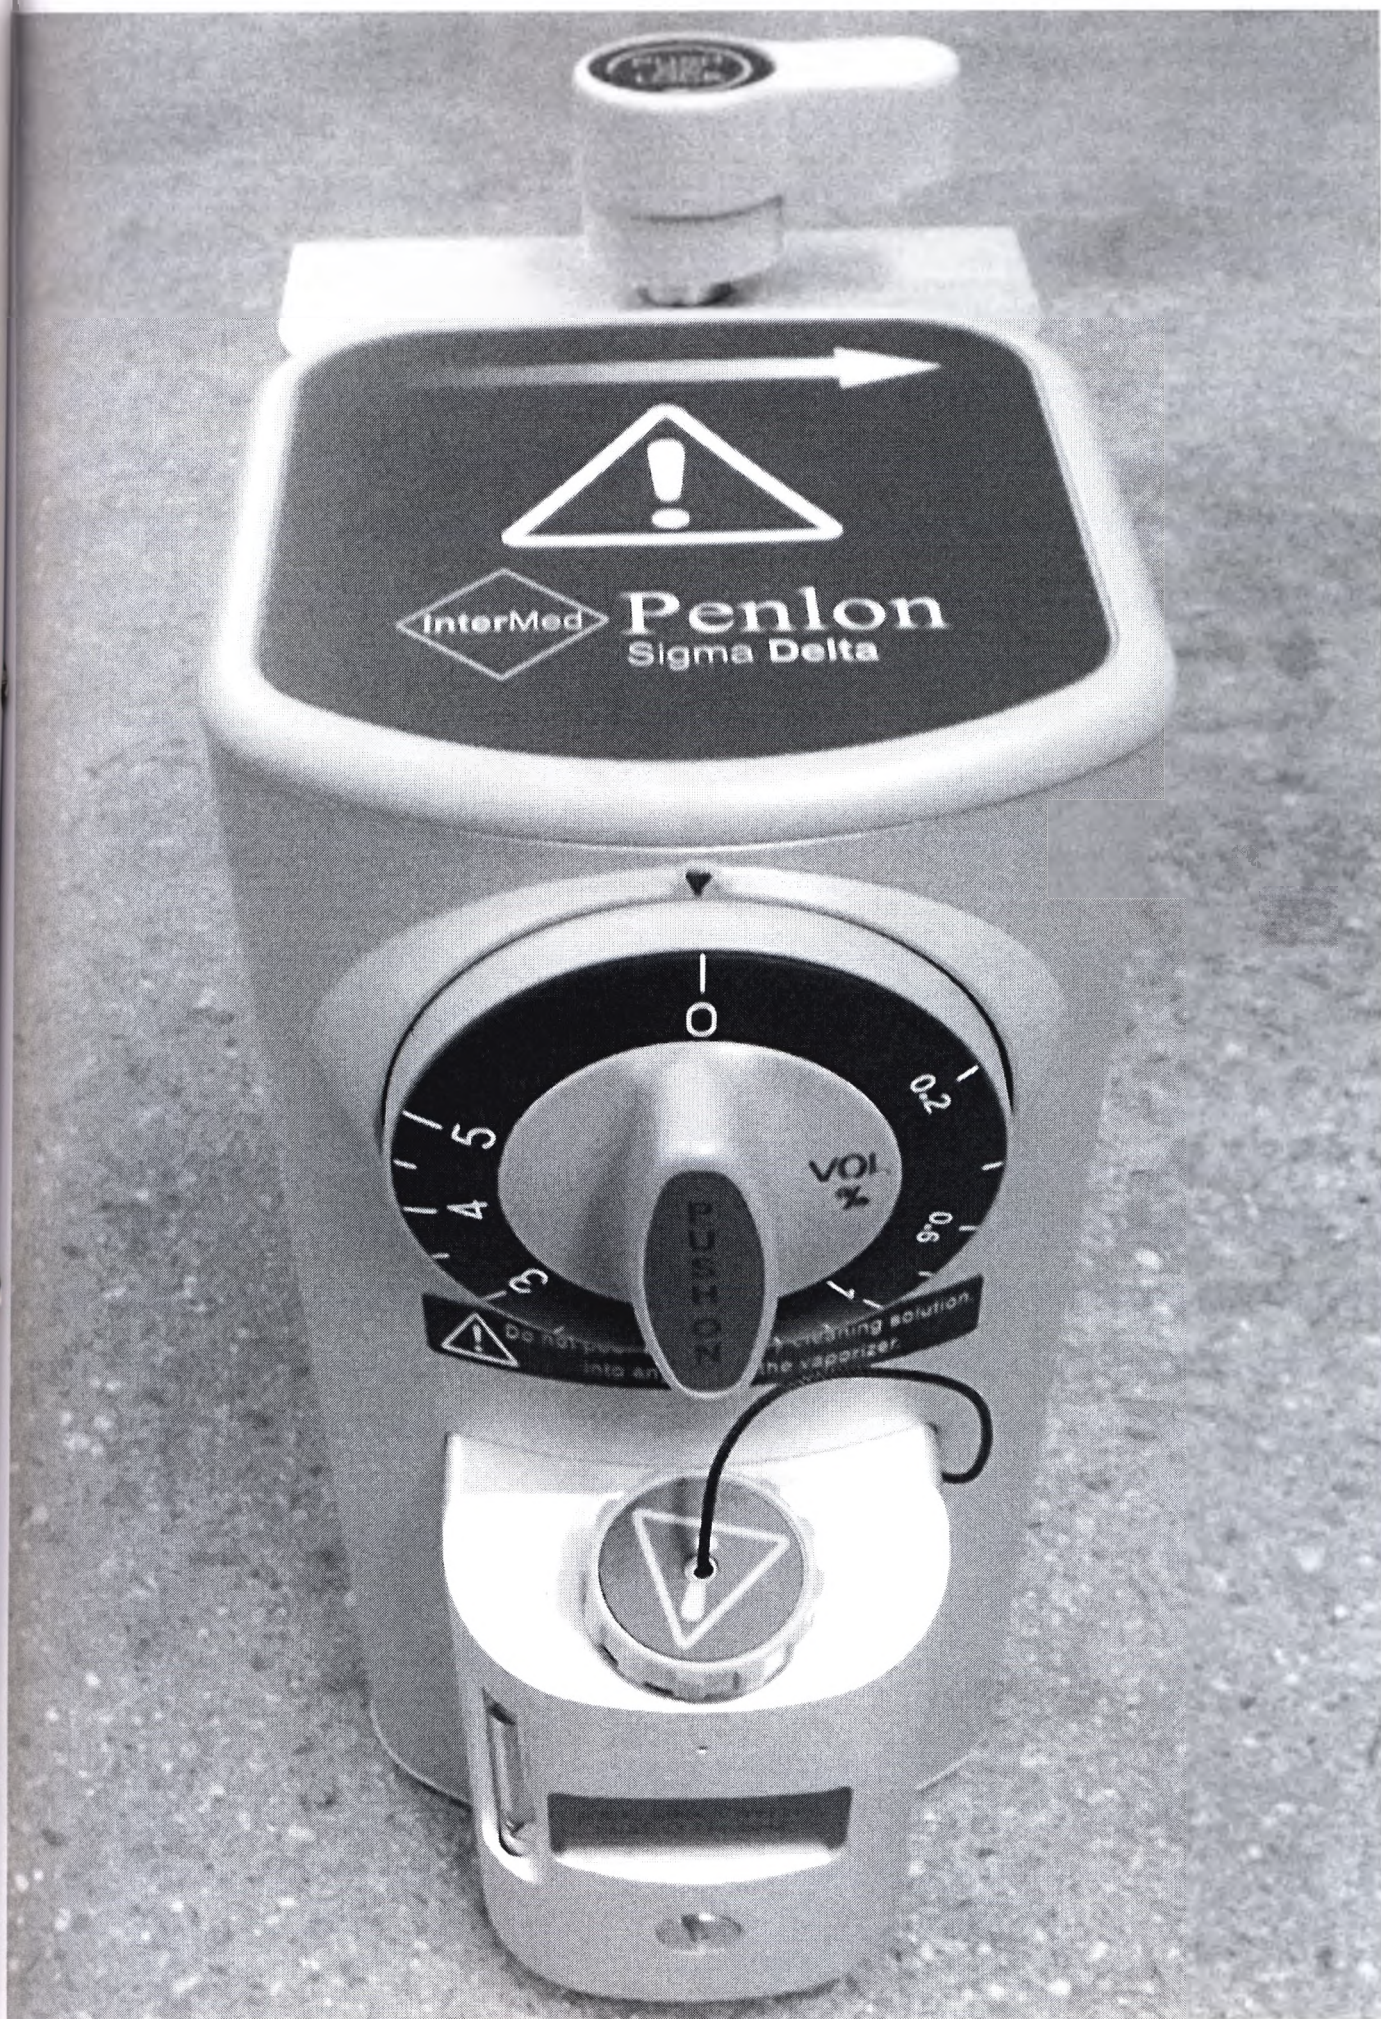

Испаритель Изофлорана

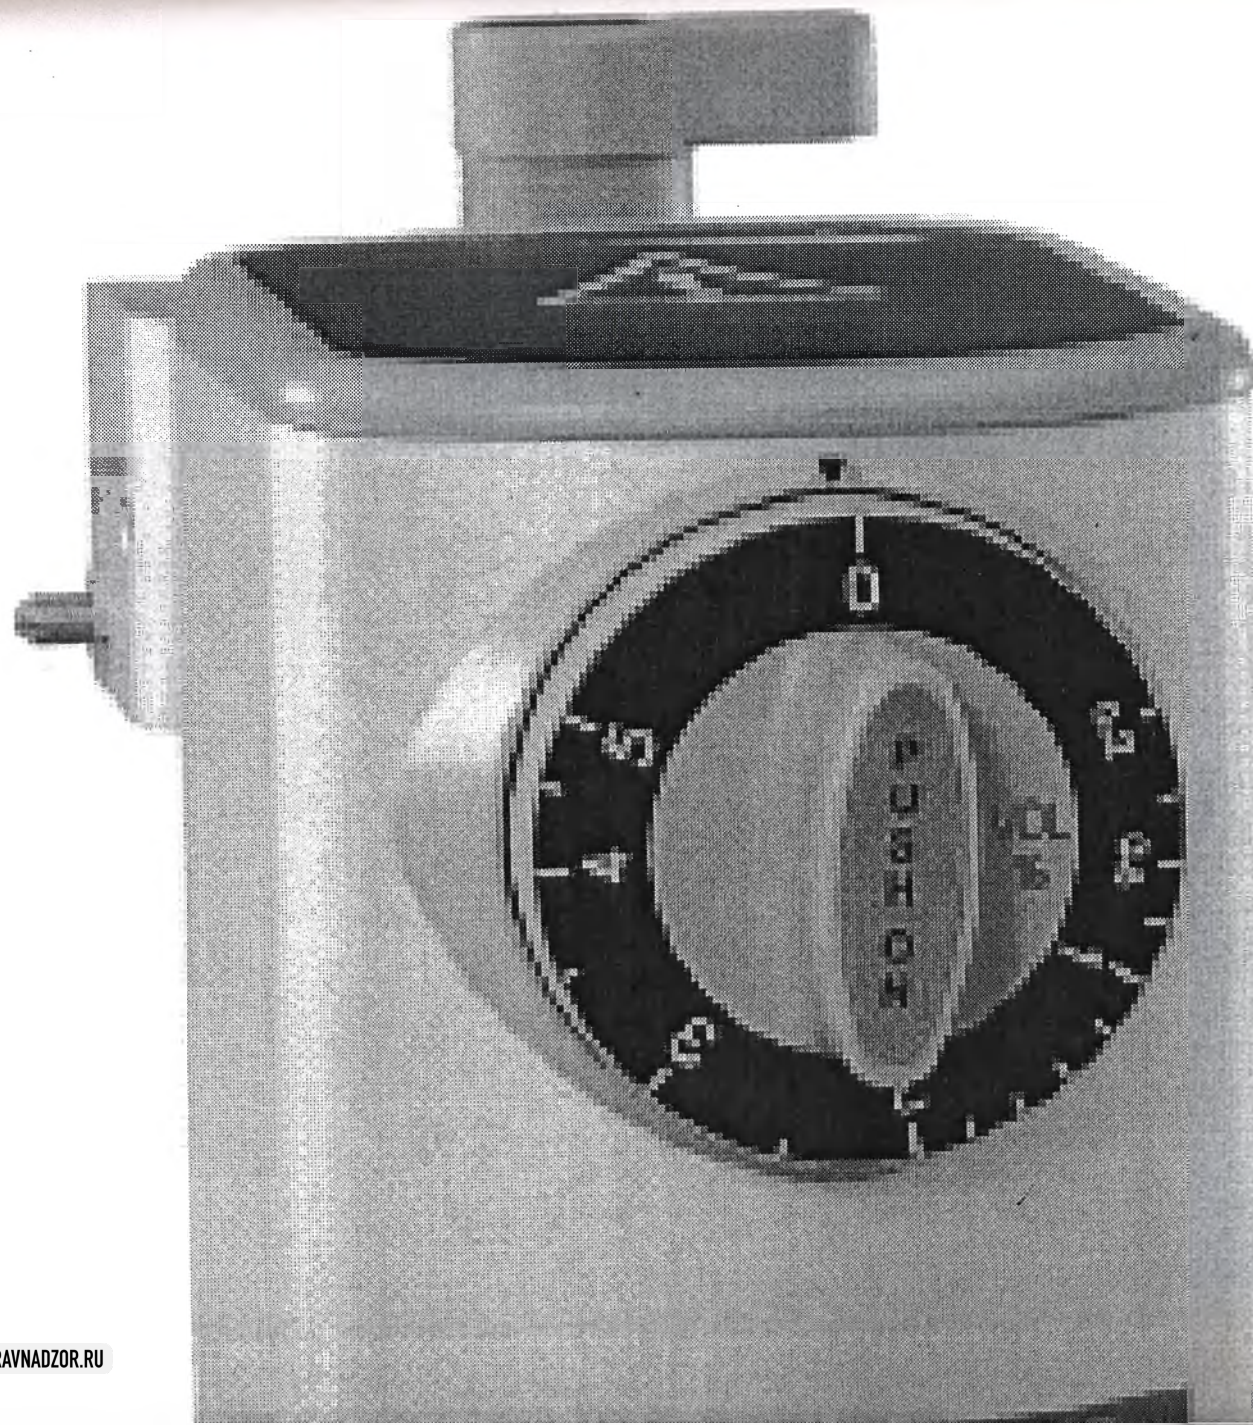


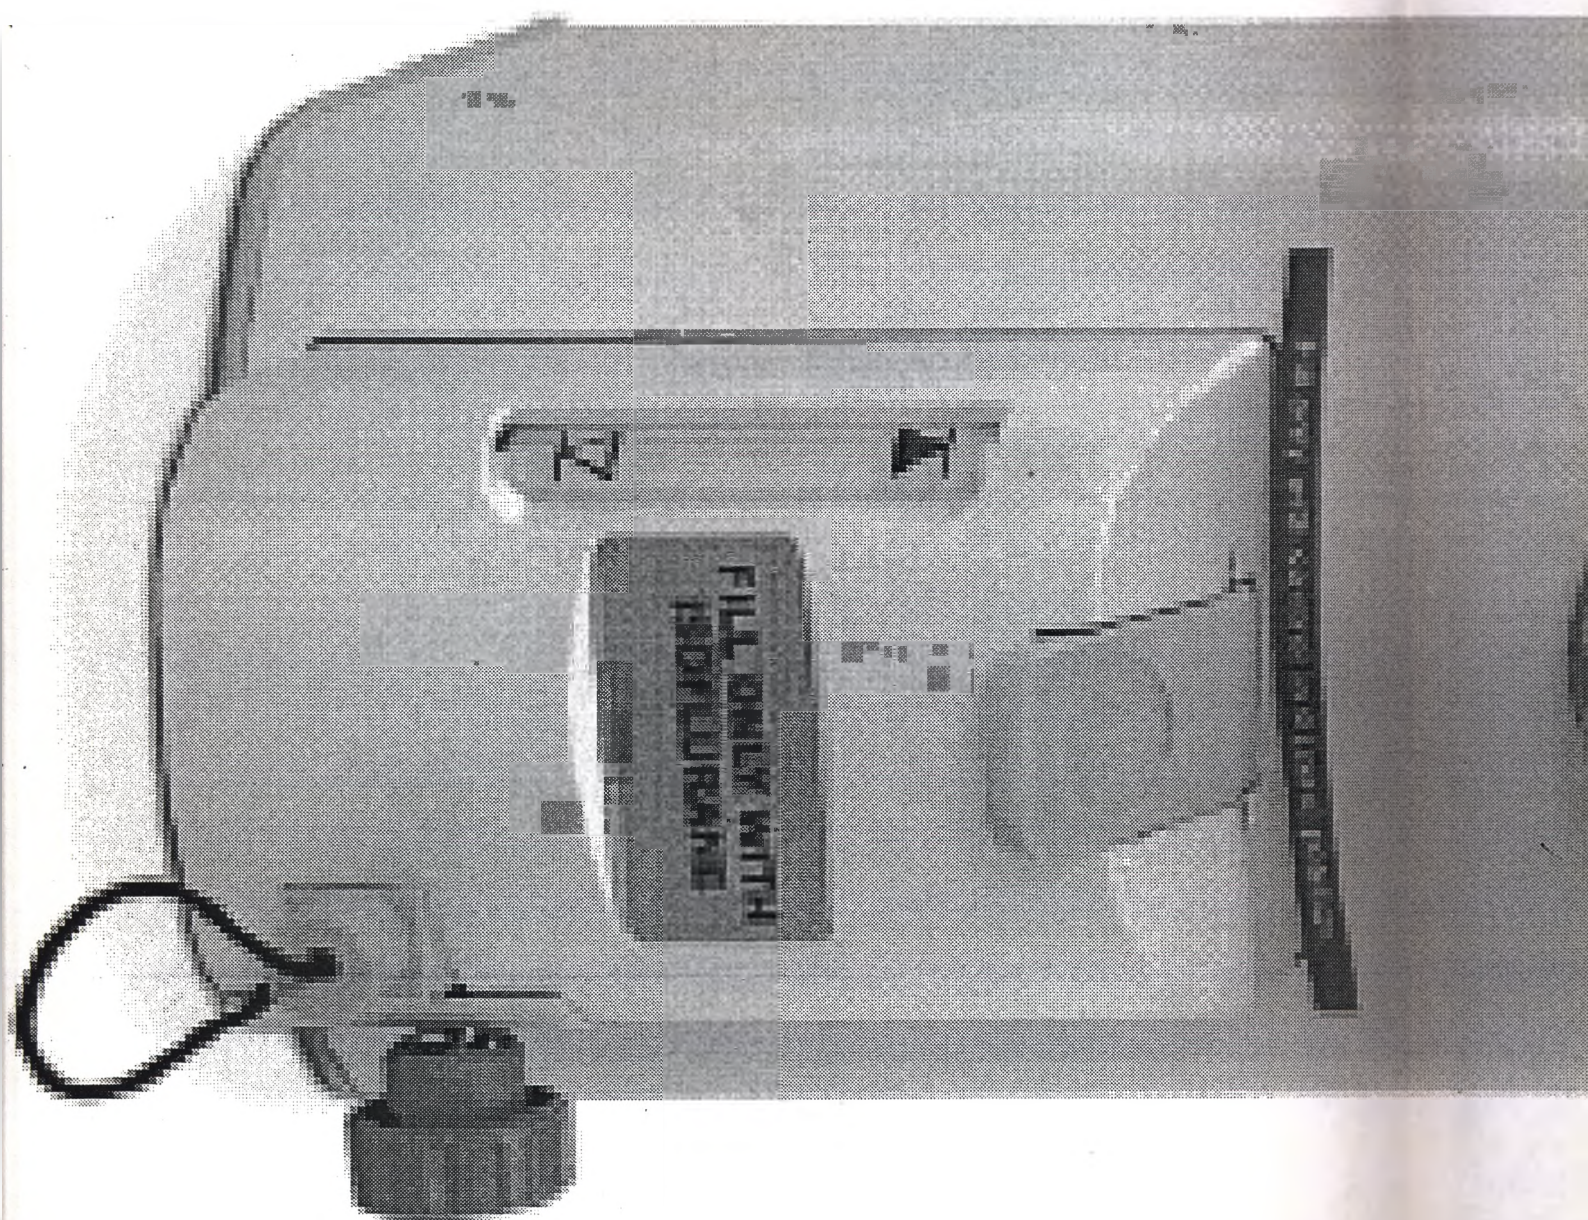



Испаритель Энфлюрана





Испаритель Севофлюрана

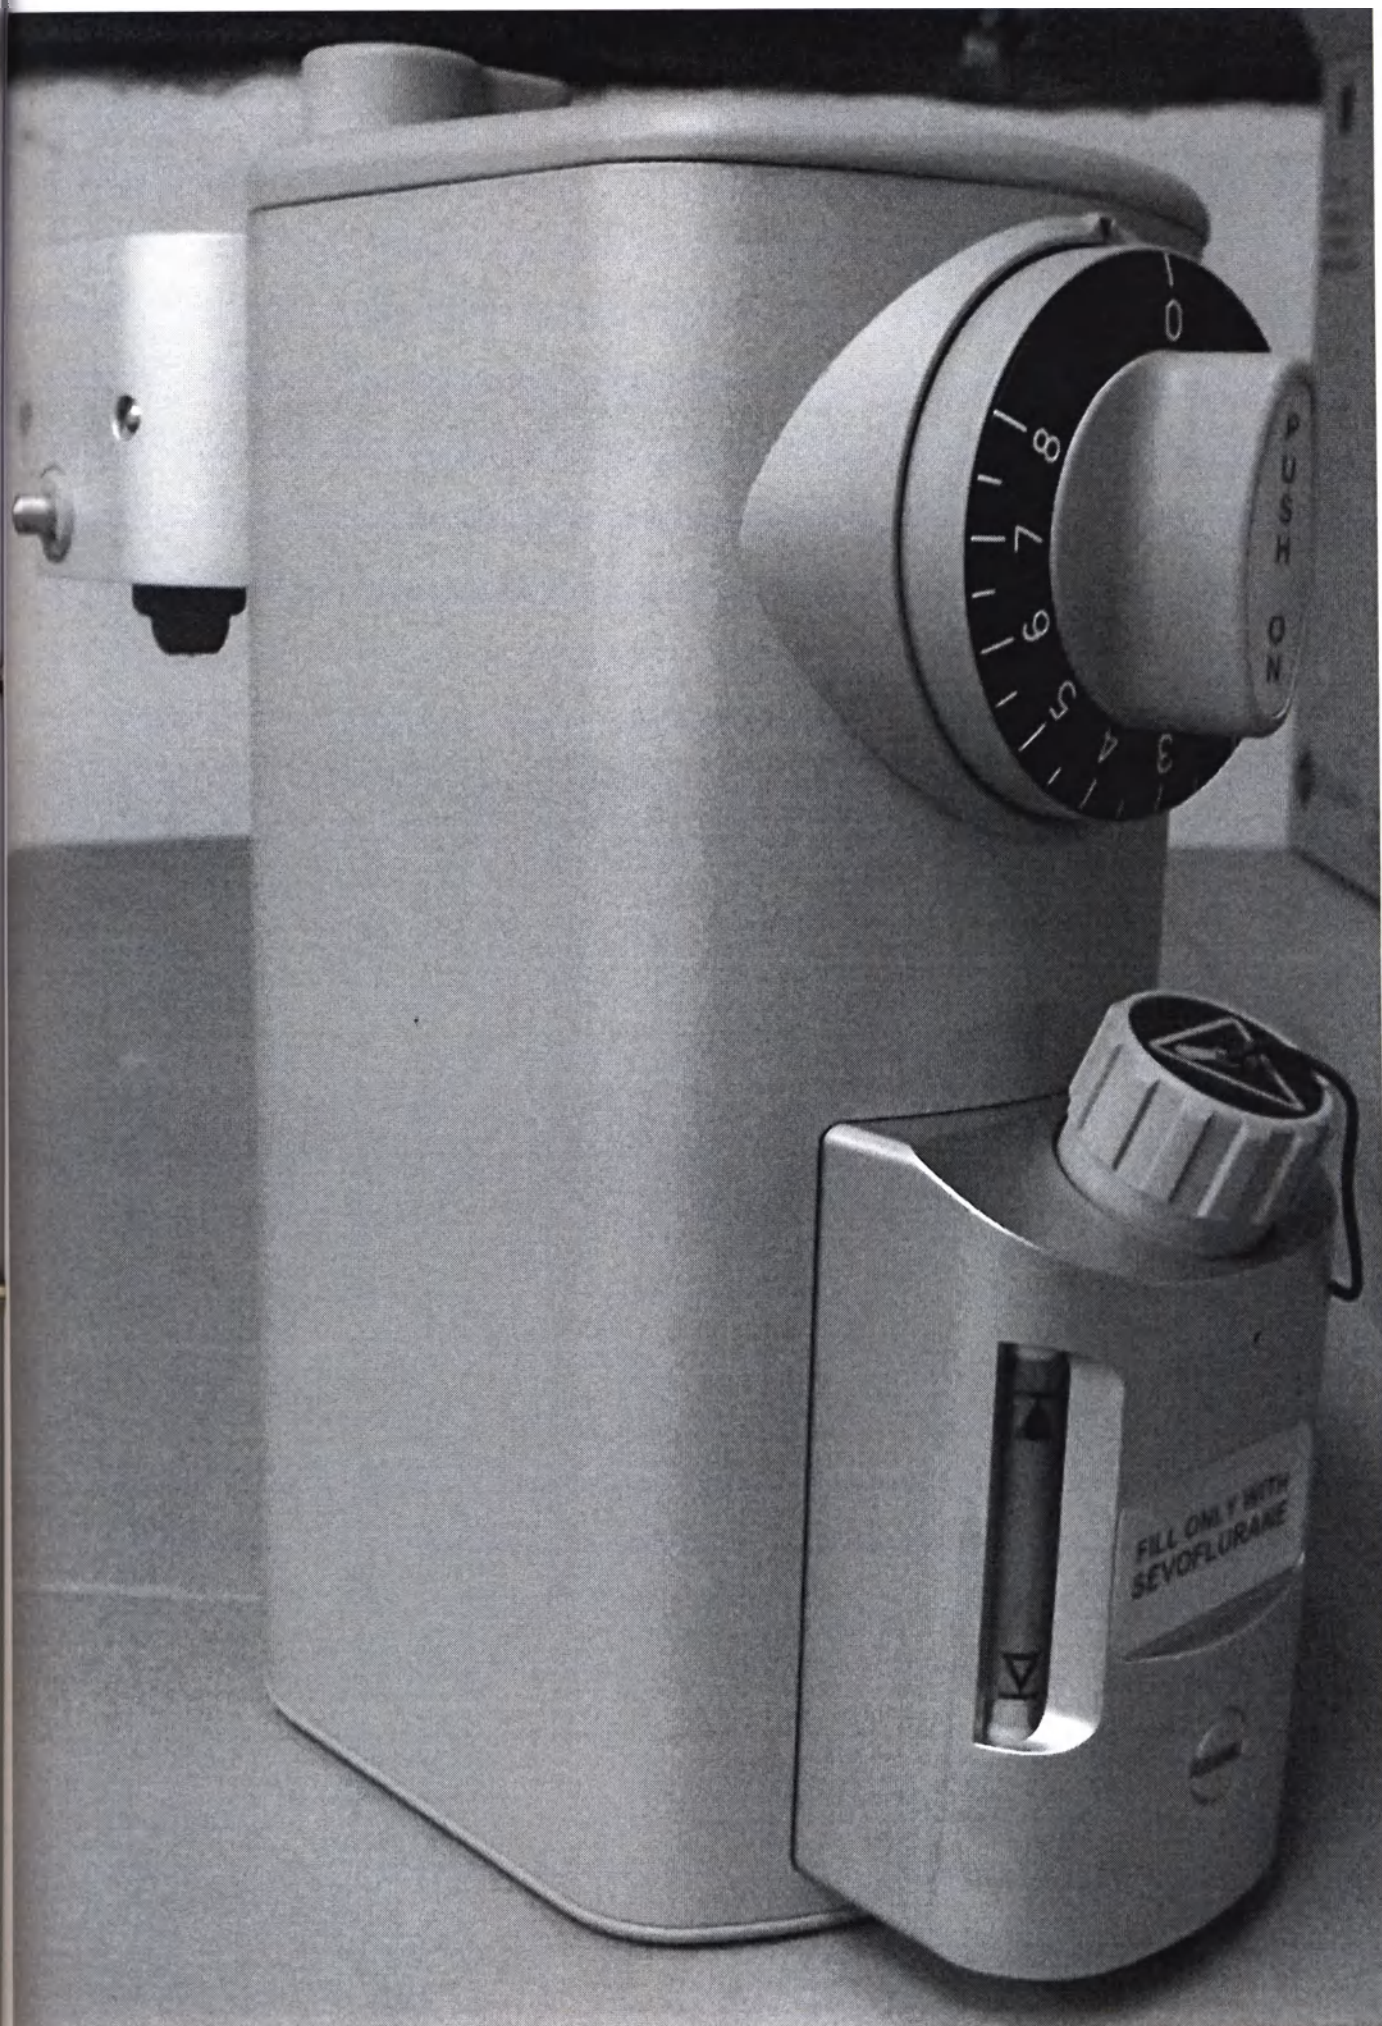

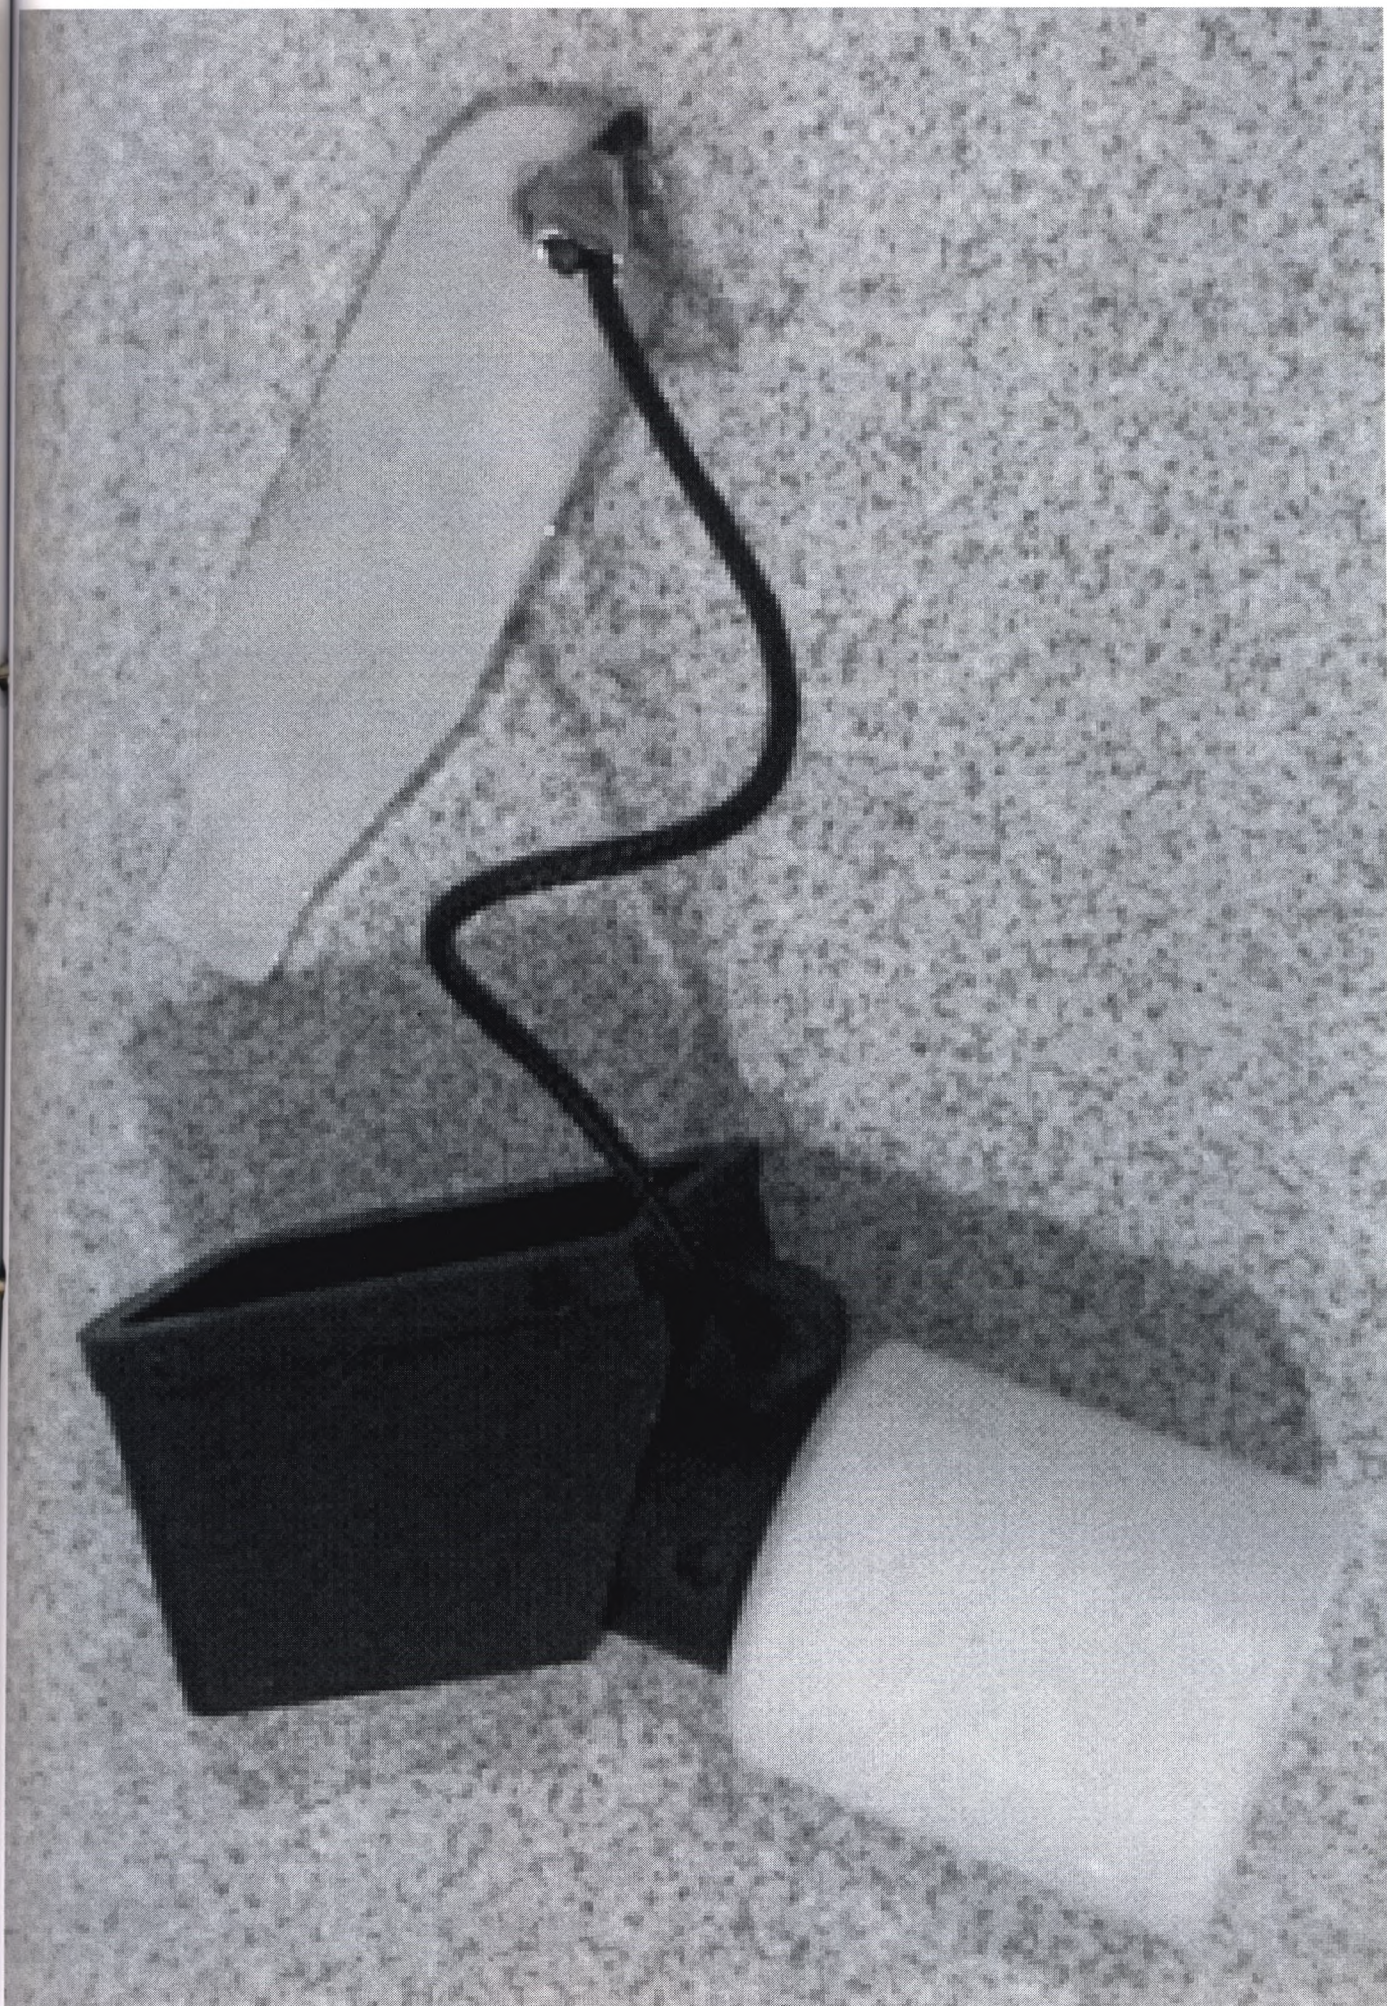

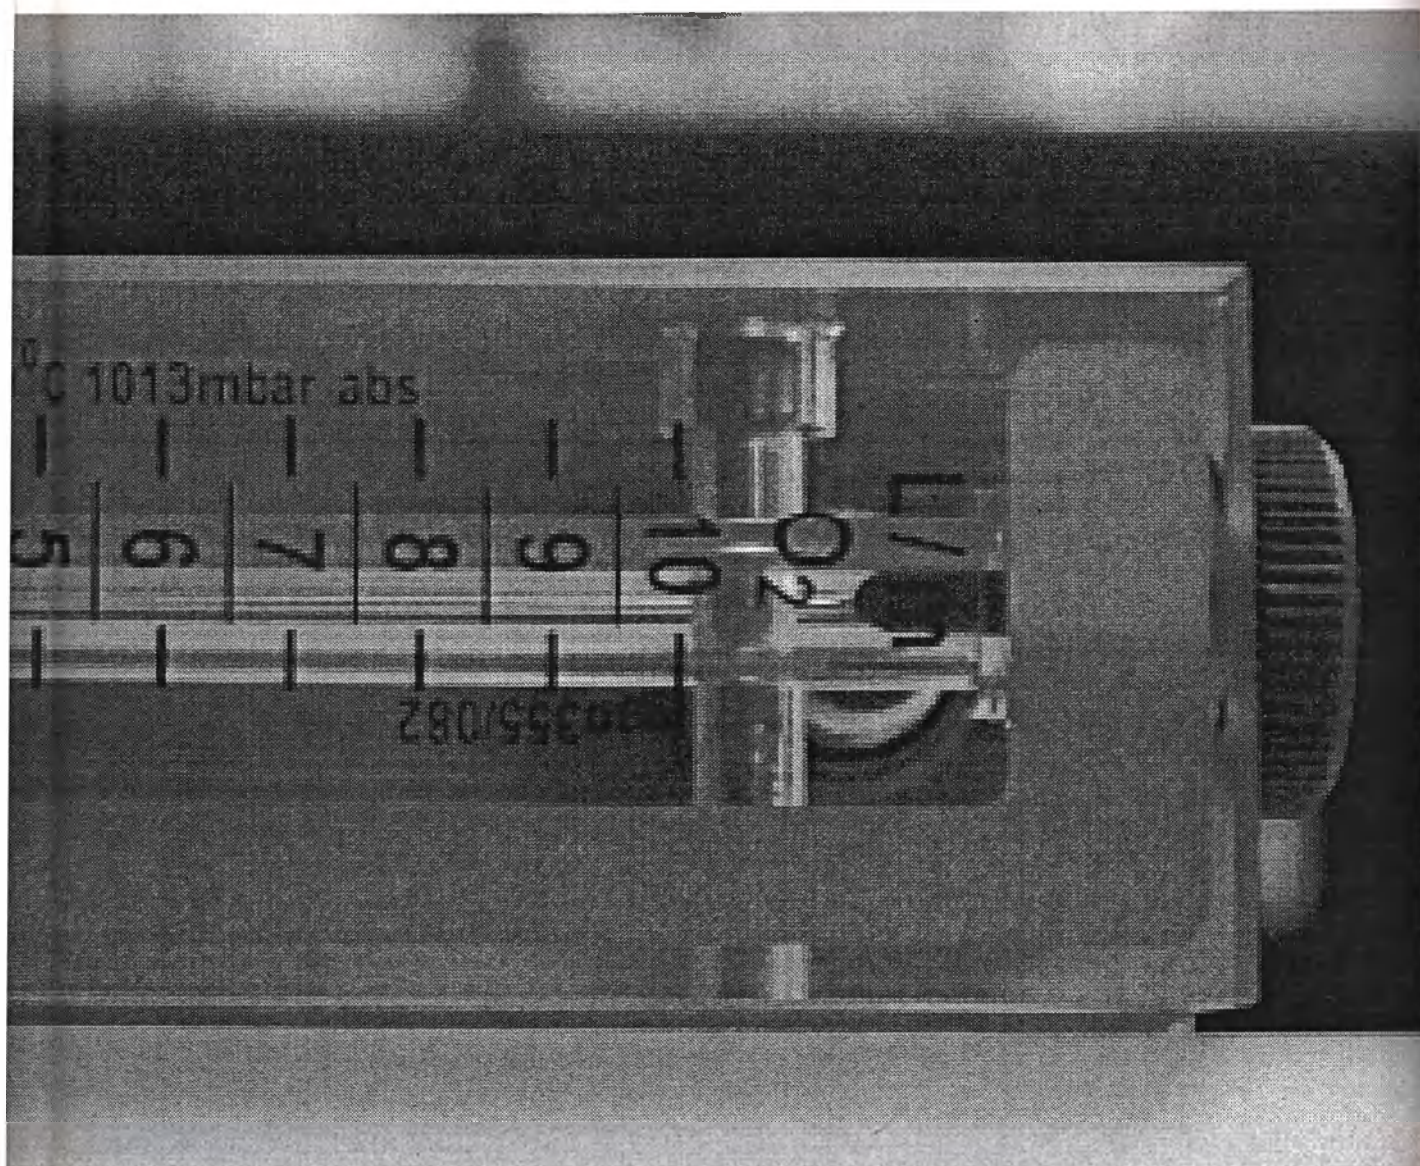

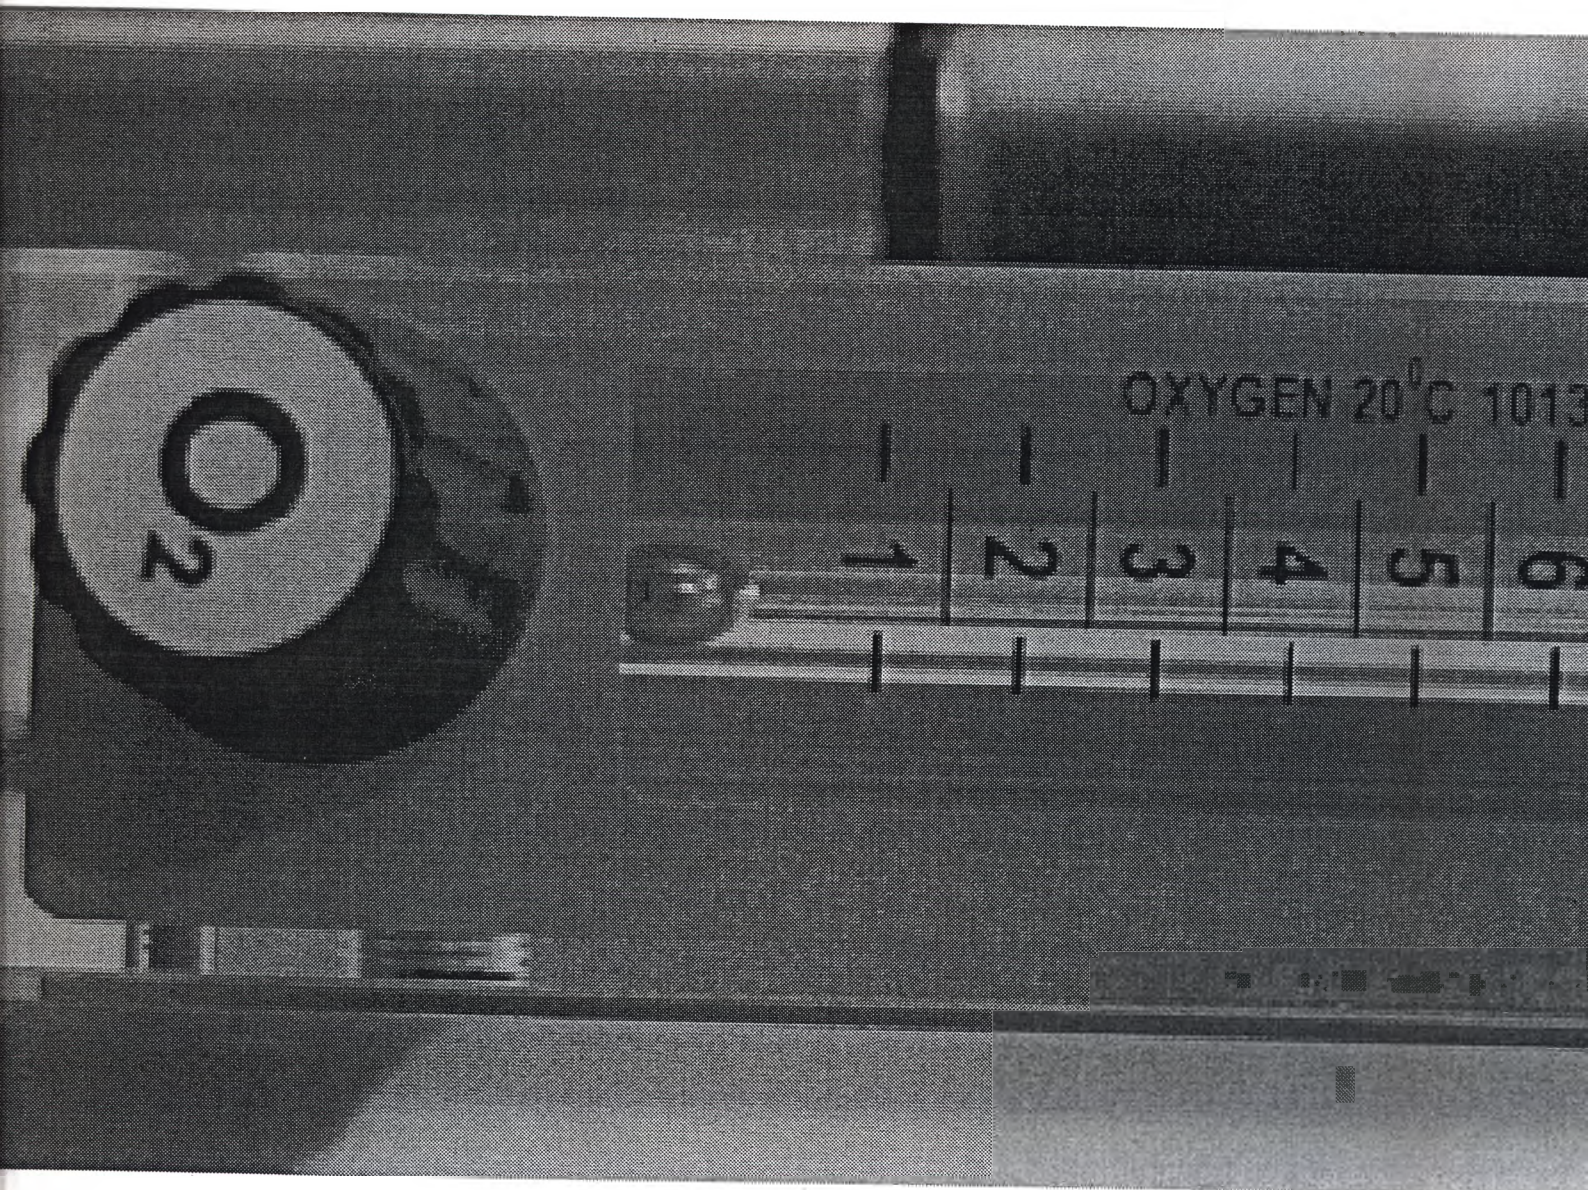

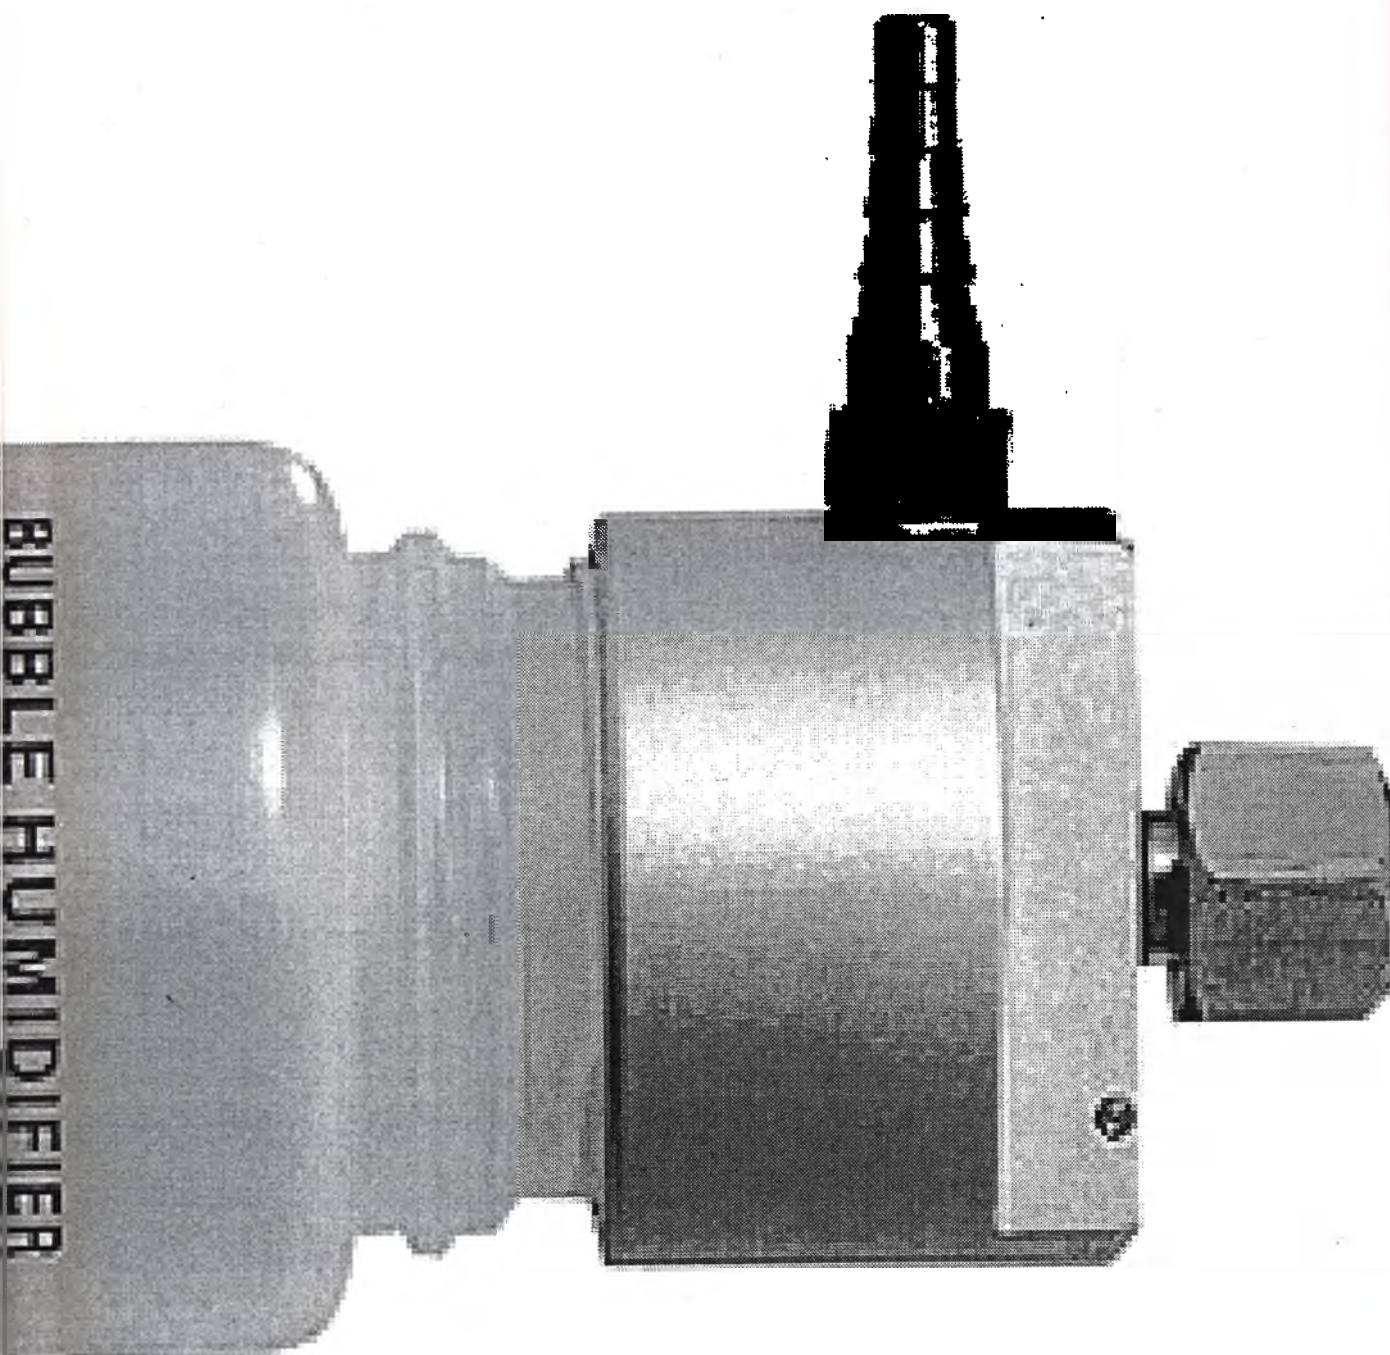

Увлажнитель газовой смеси

BUBBLE HUMIDIFIER

MAX

MAINTAIN WATER LEVEL

(USE DISTILLED WATER)

BETWEEN THESE LINES


MIN

Монитор вентилятора (AV-S)








Кабель кислородного датчика

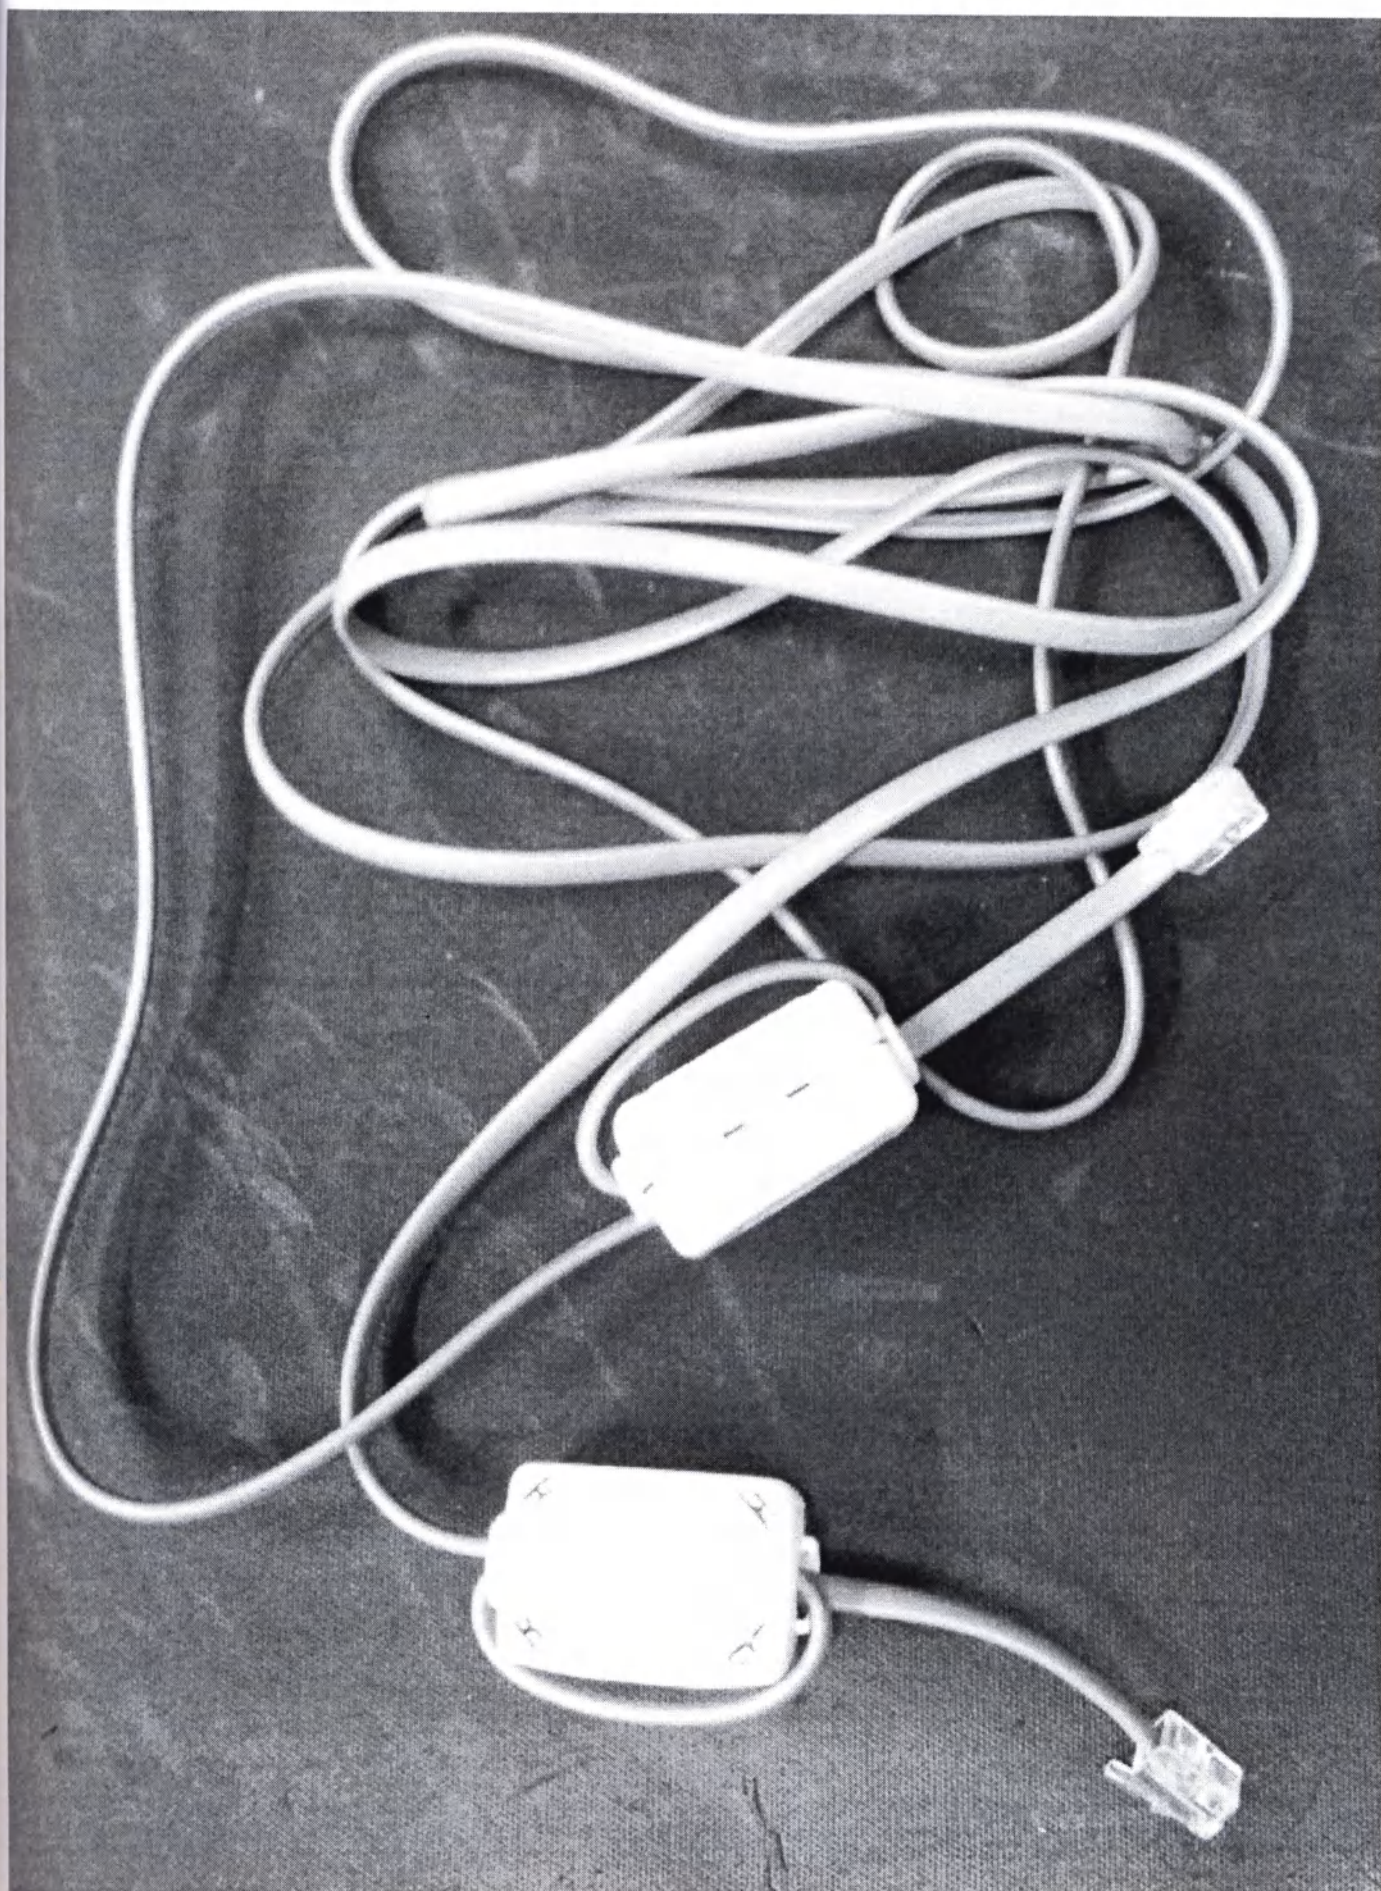

МРТ-совместимый вентилятор Nuffield

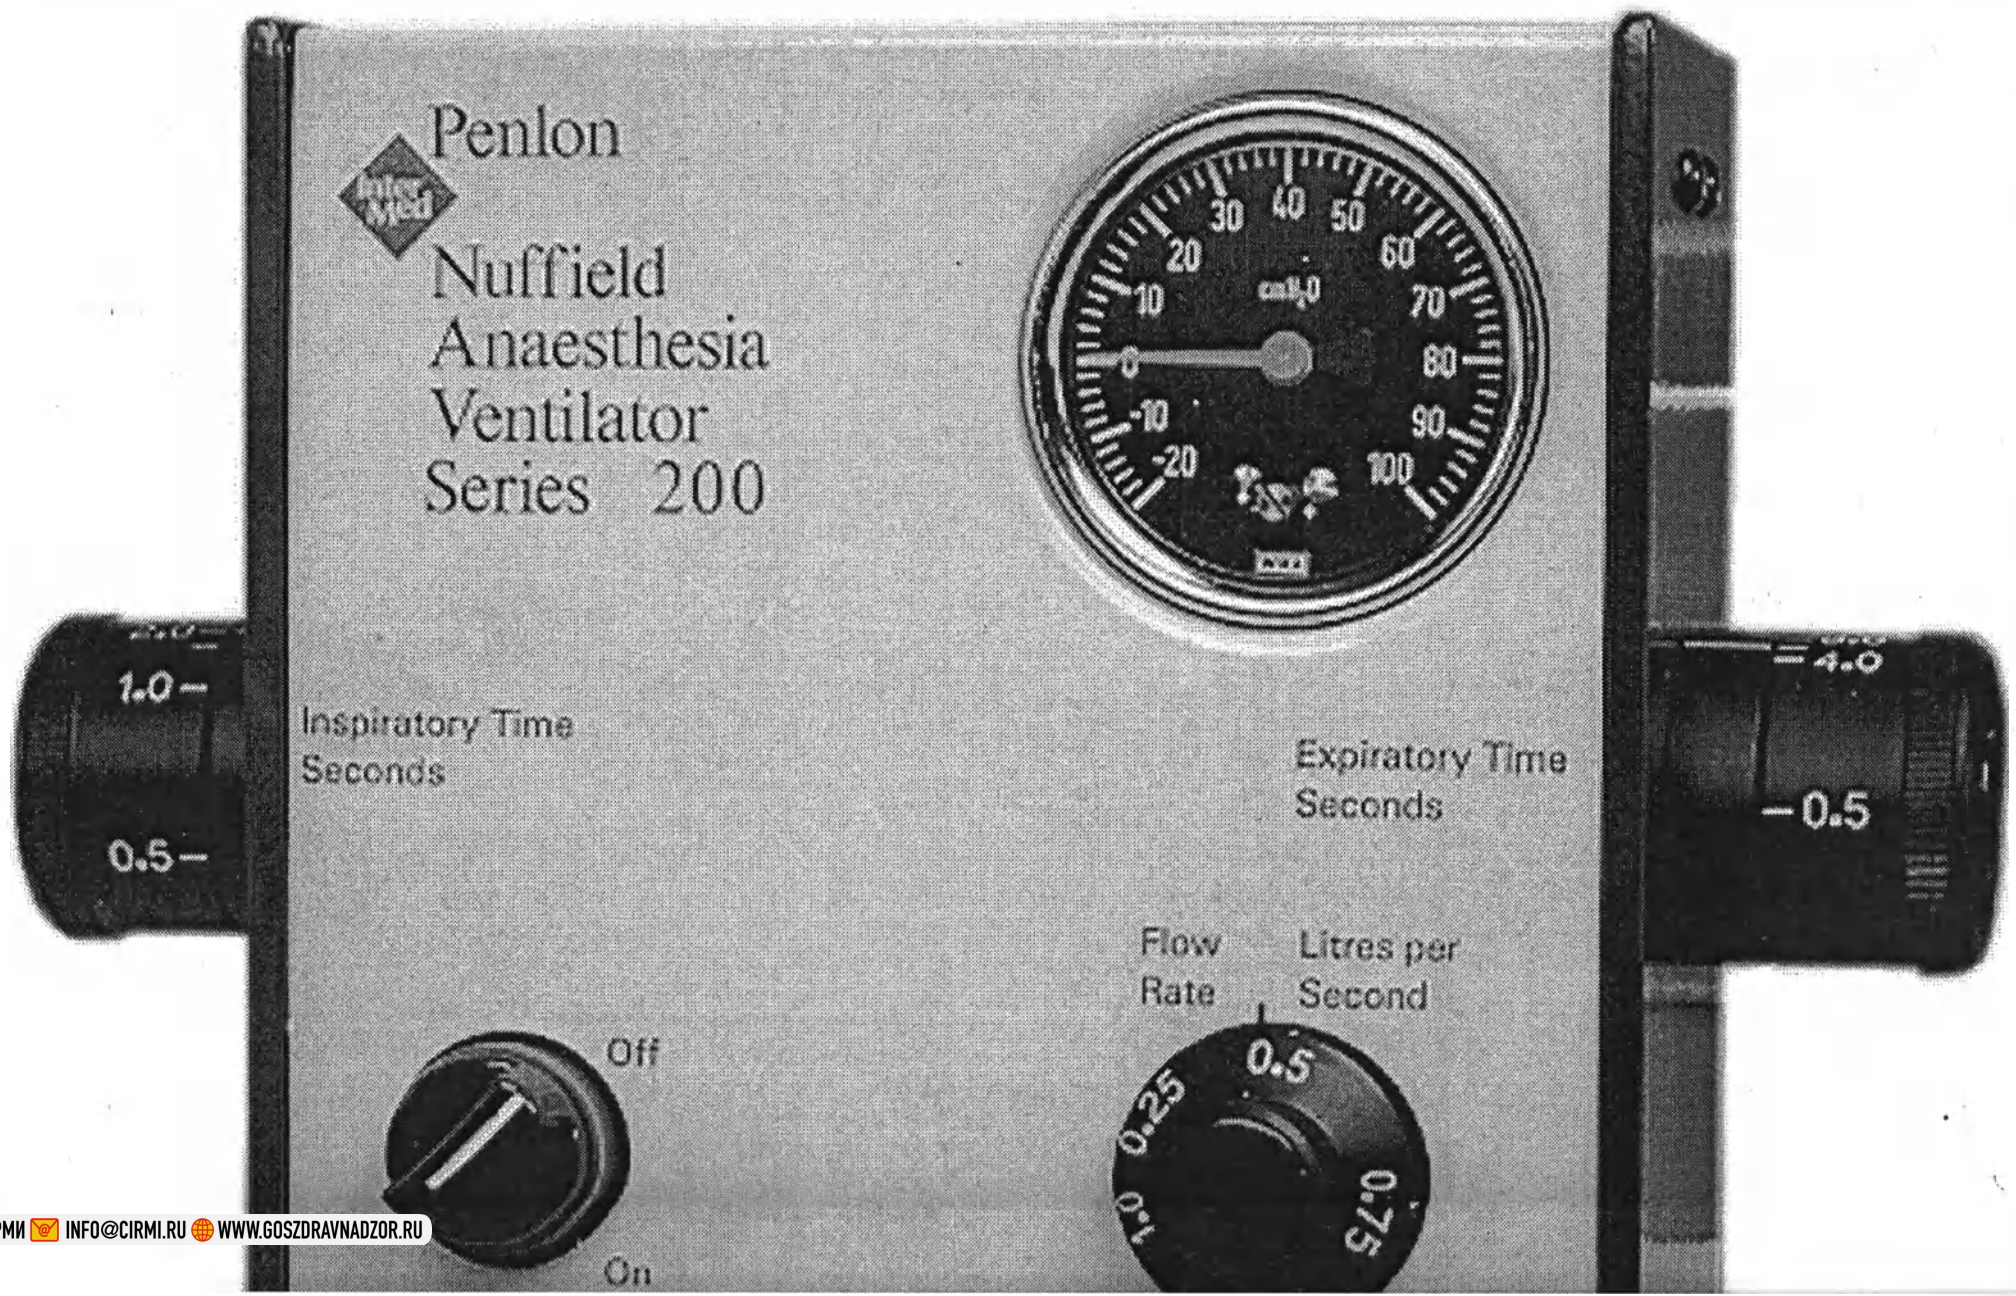

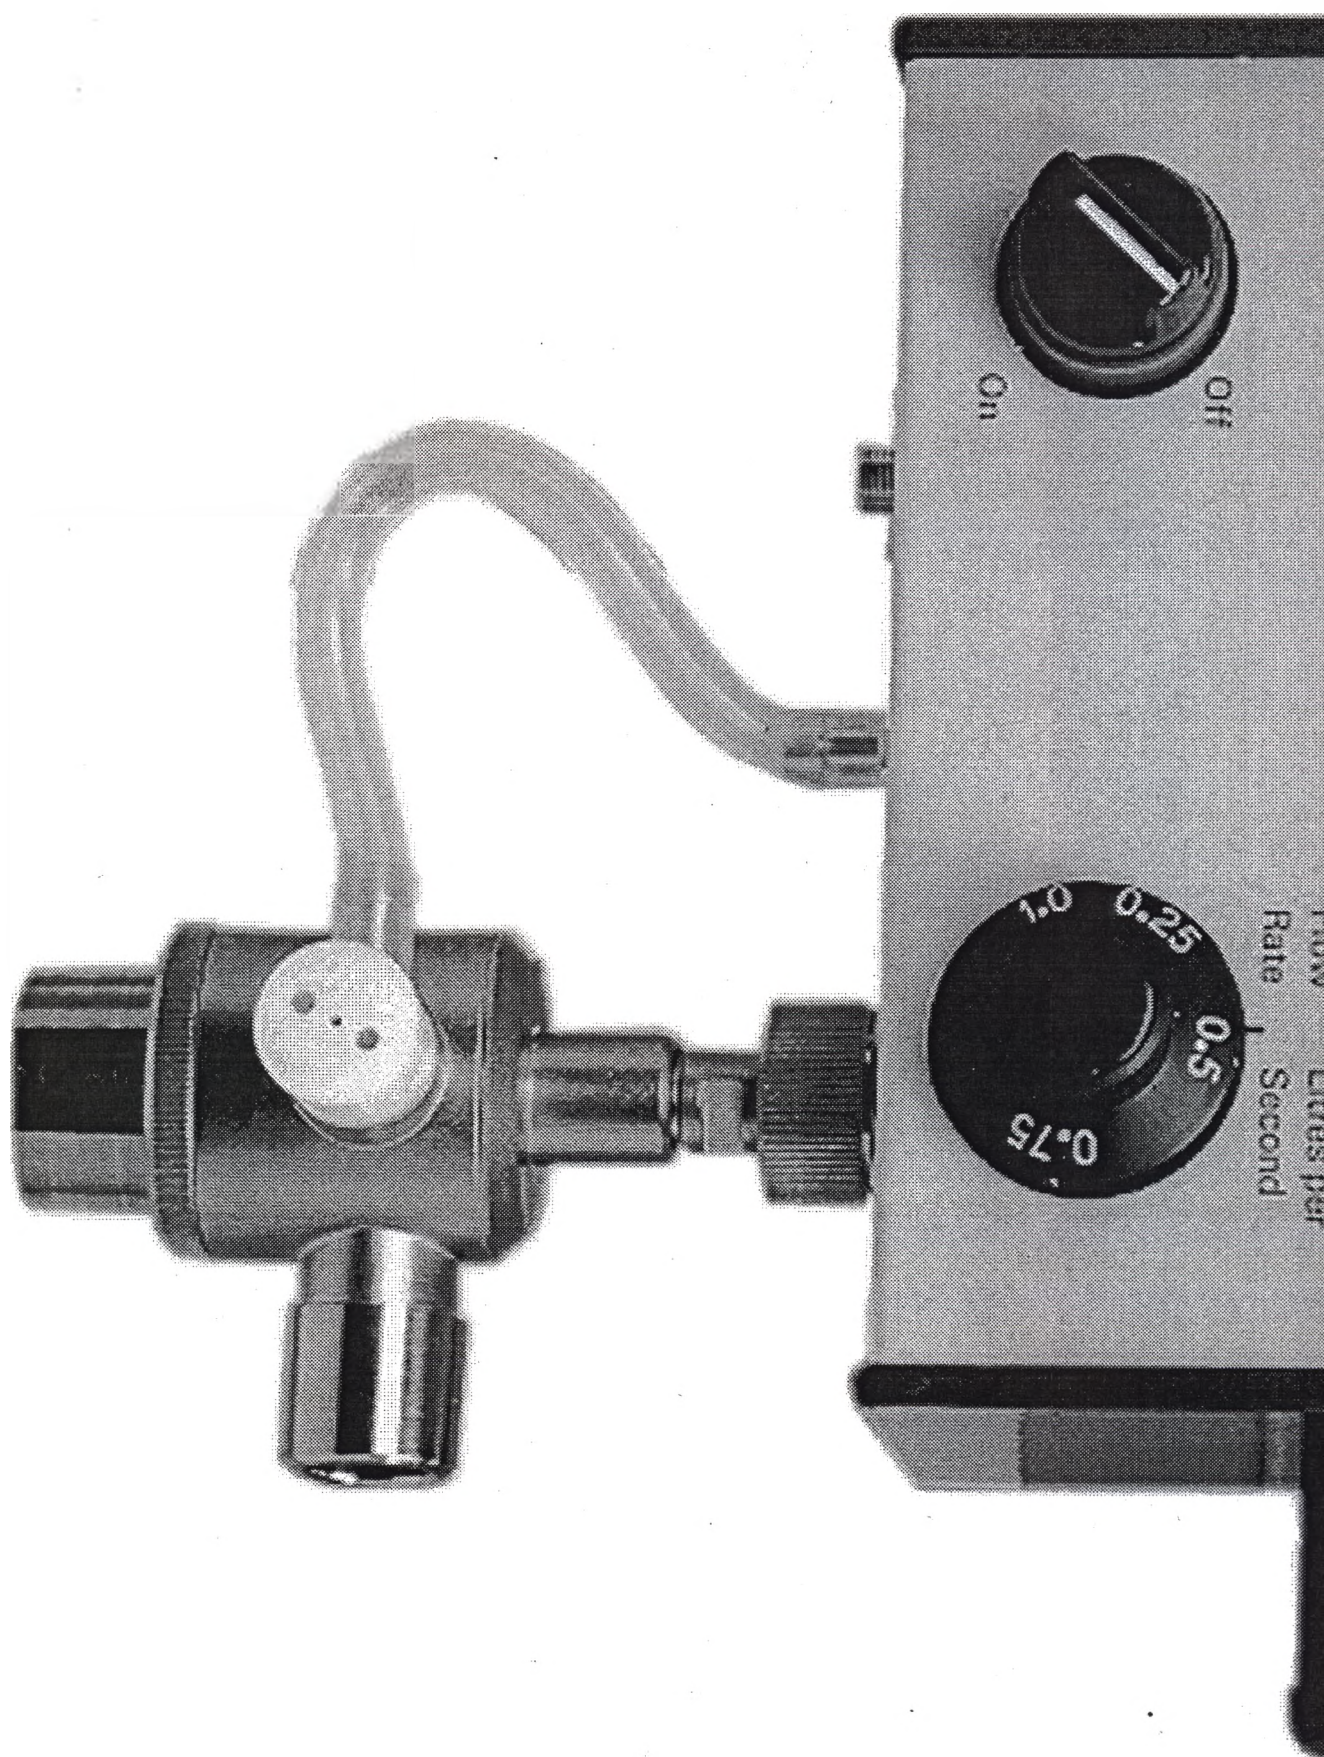

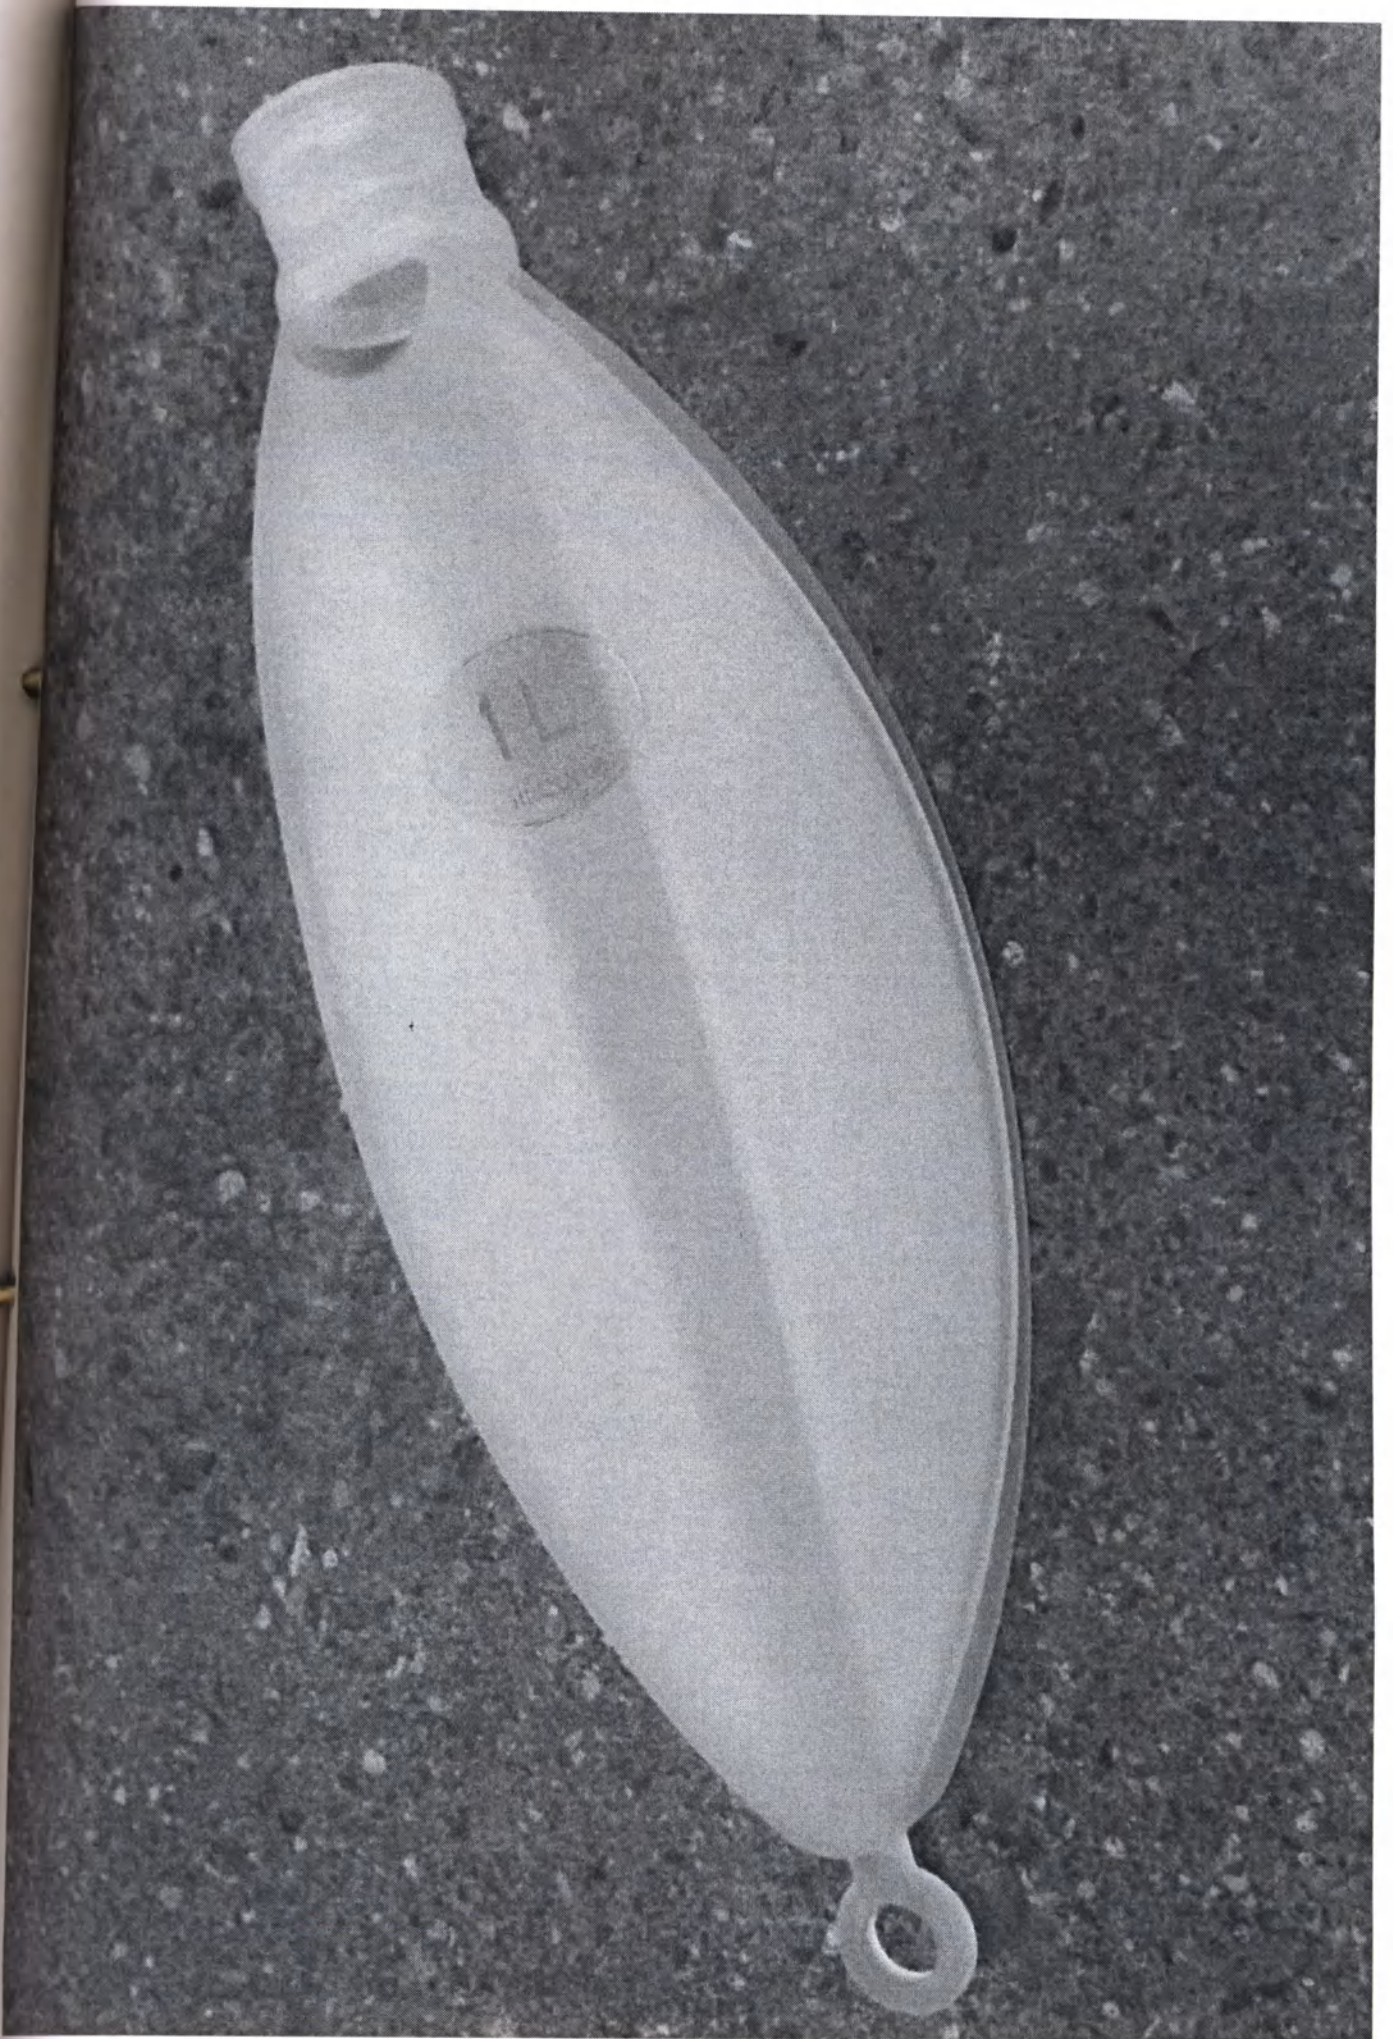





Крепление монитора вентилятора




Контур пациента одноразовый

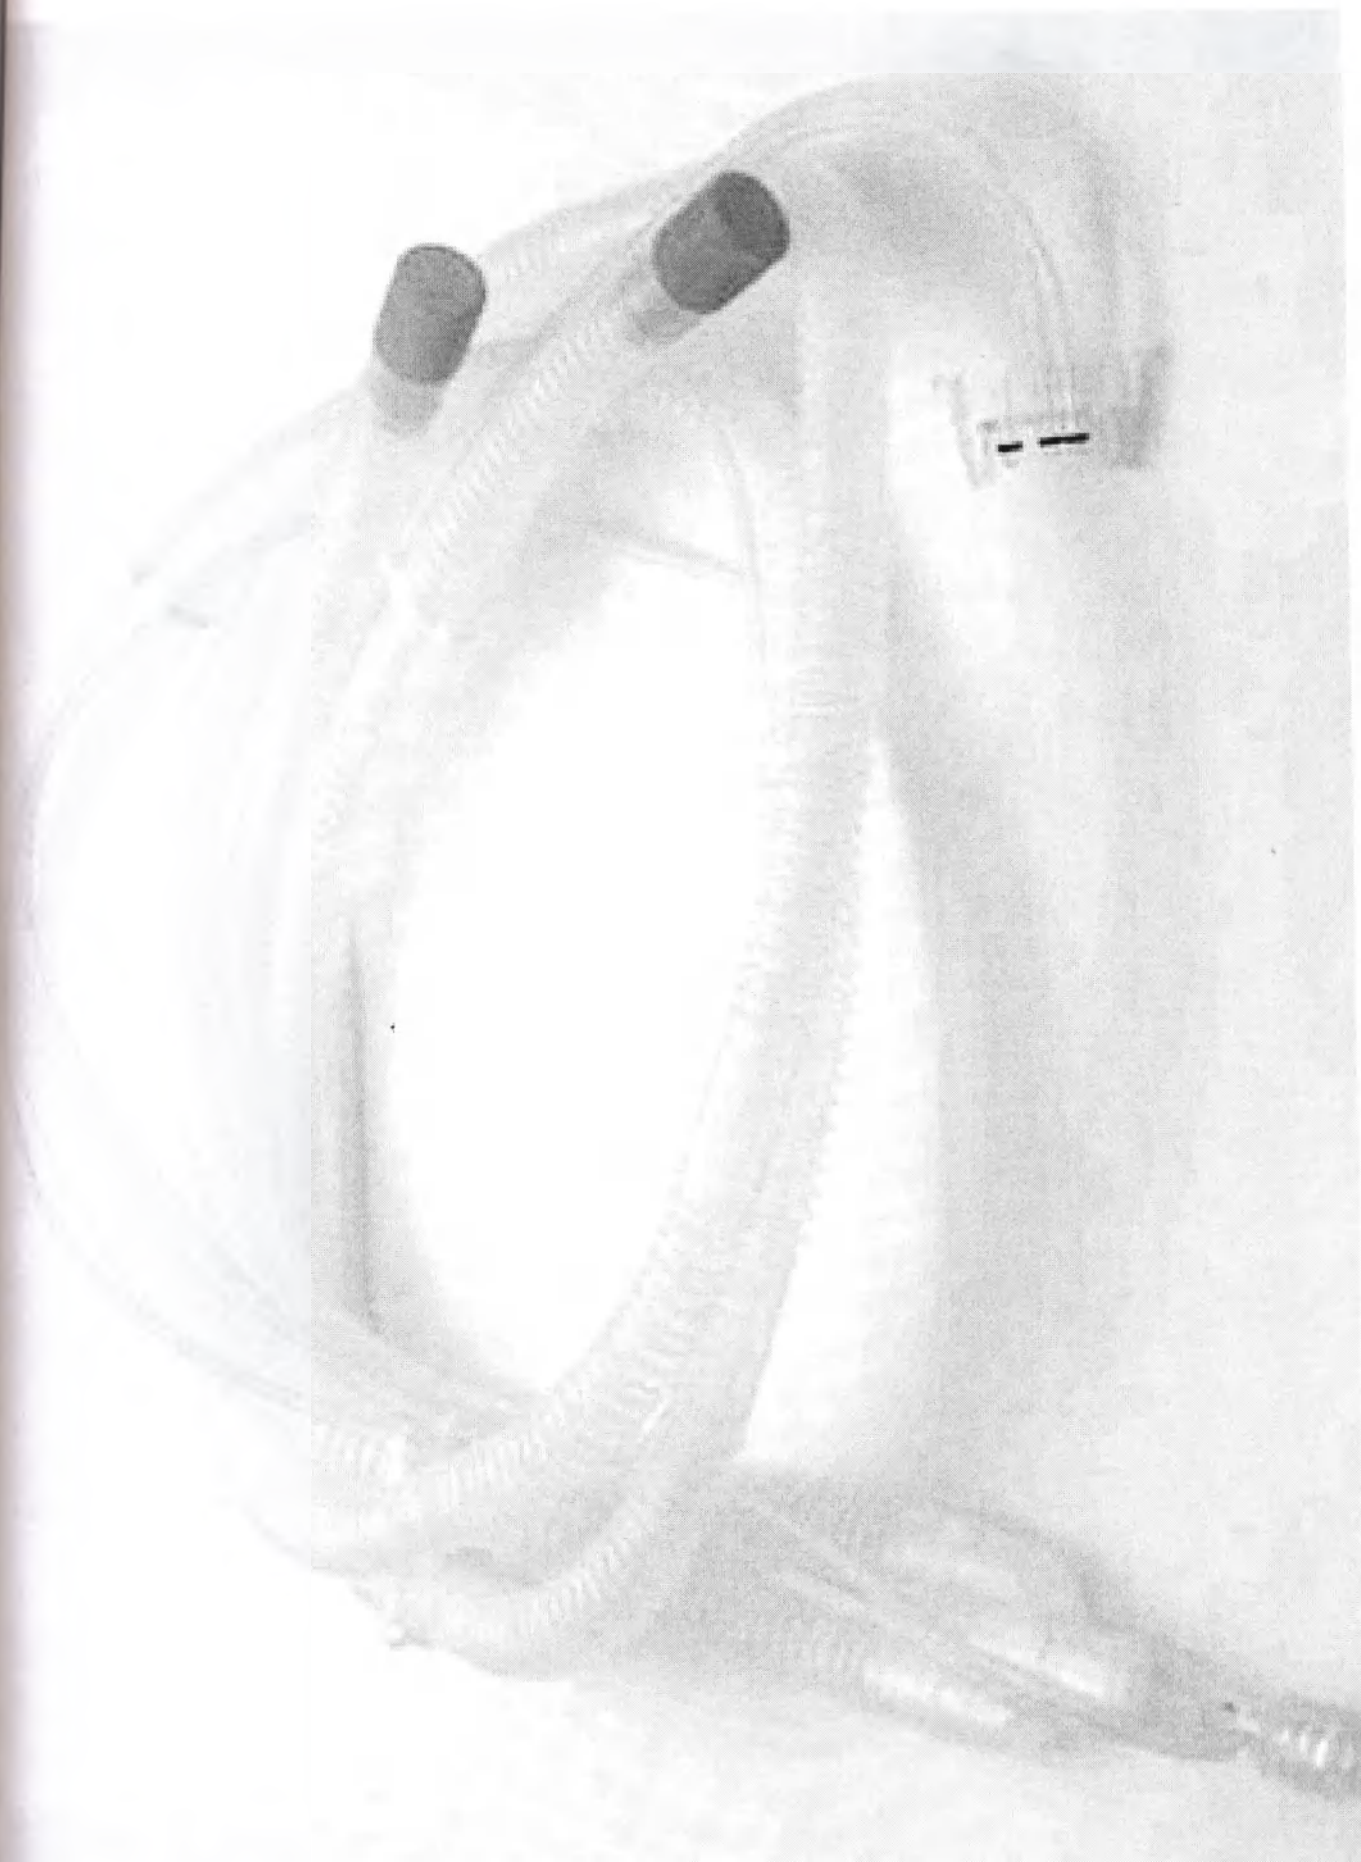


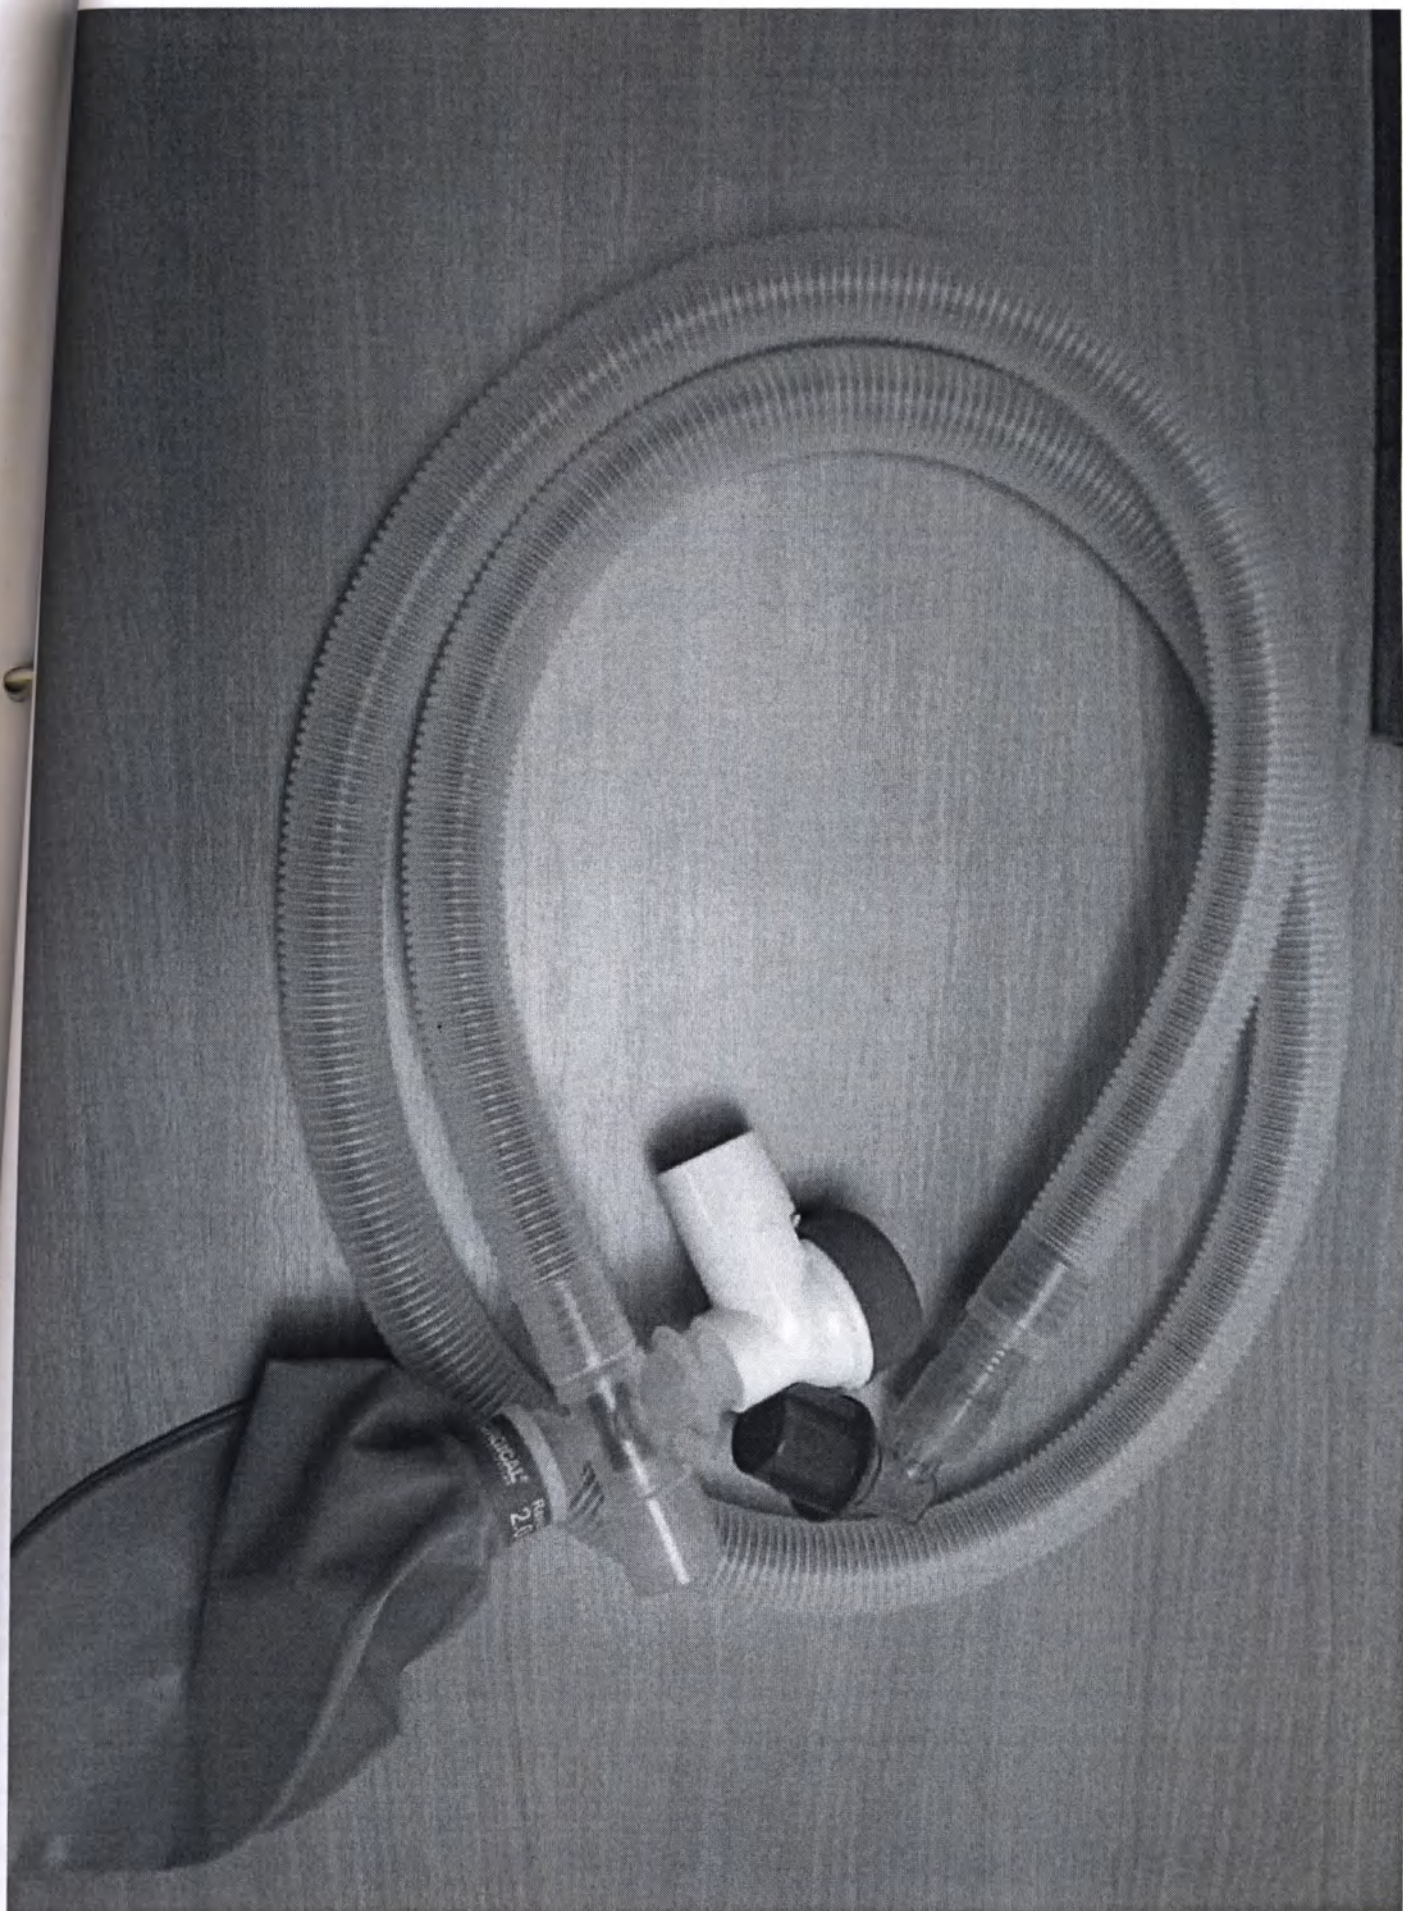



Контур пациента многоходовый силиконовый

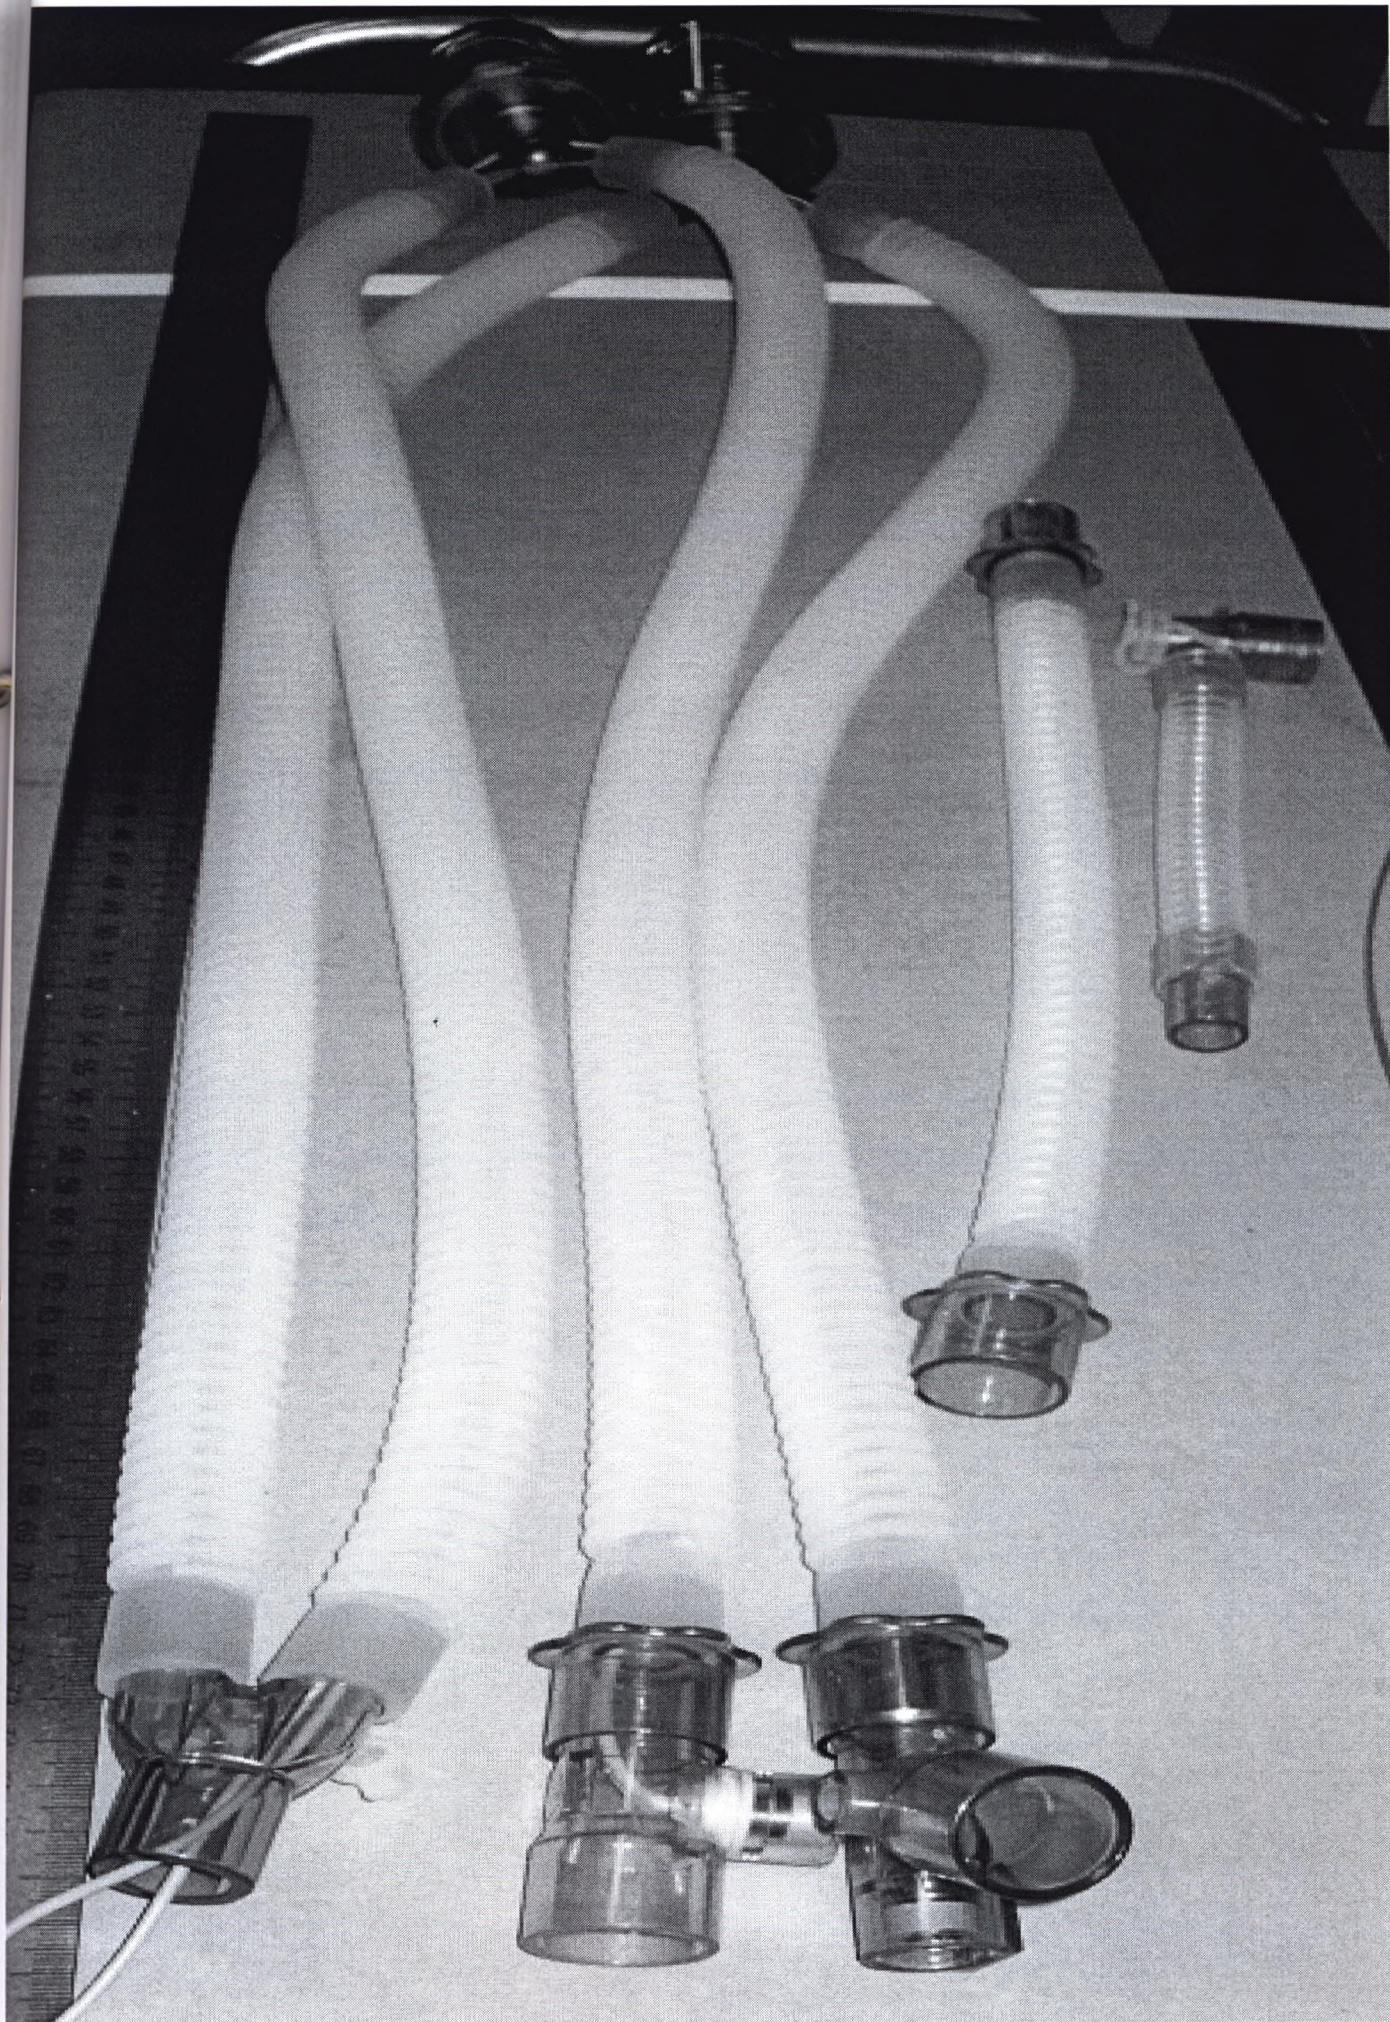


Шланги дыхательного контура

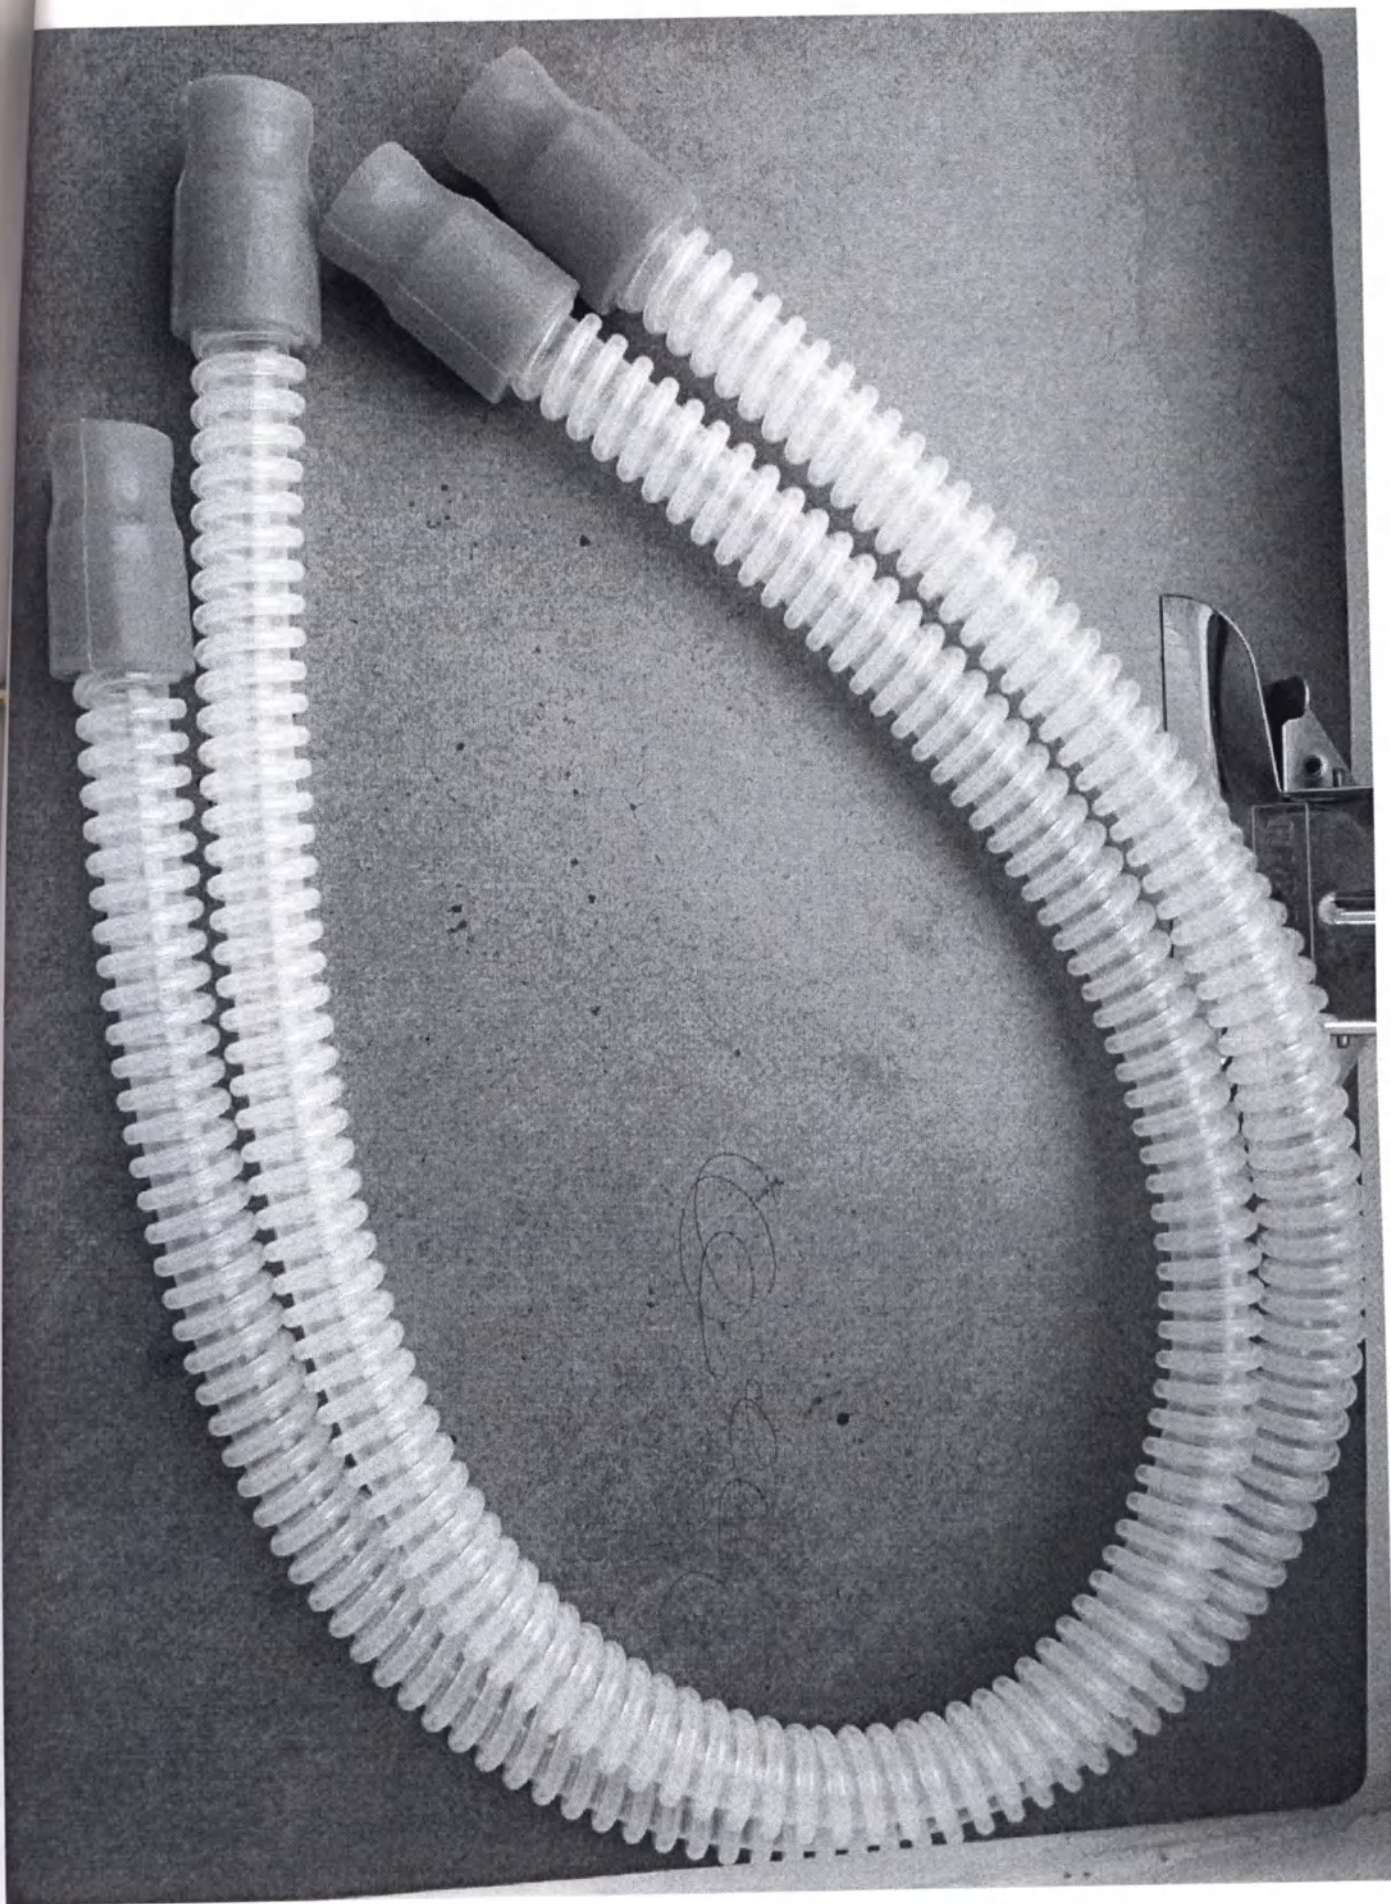

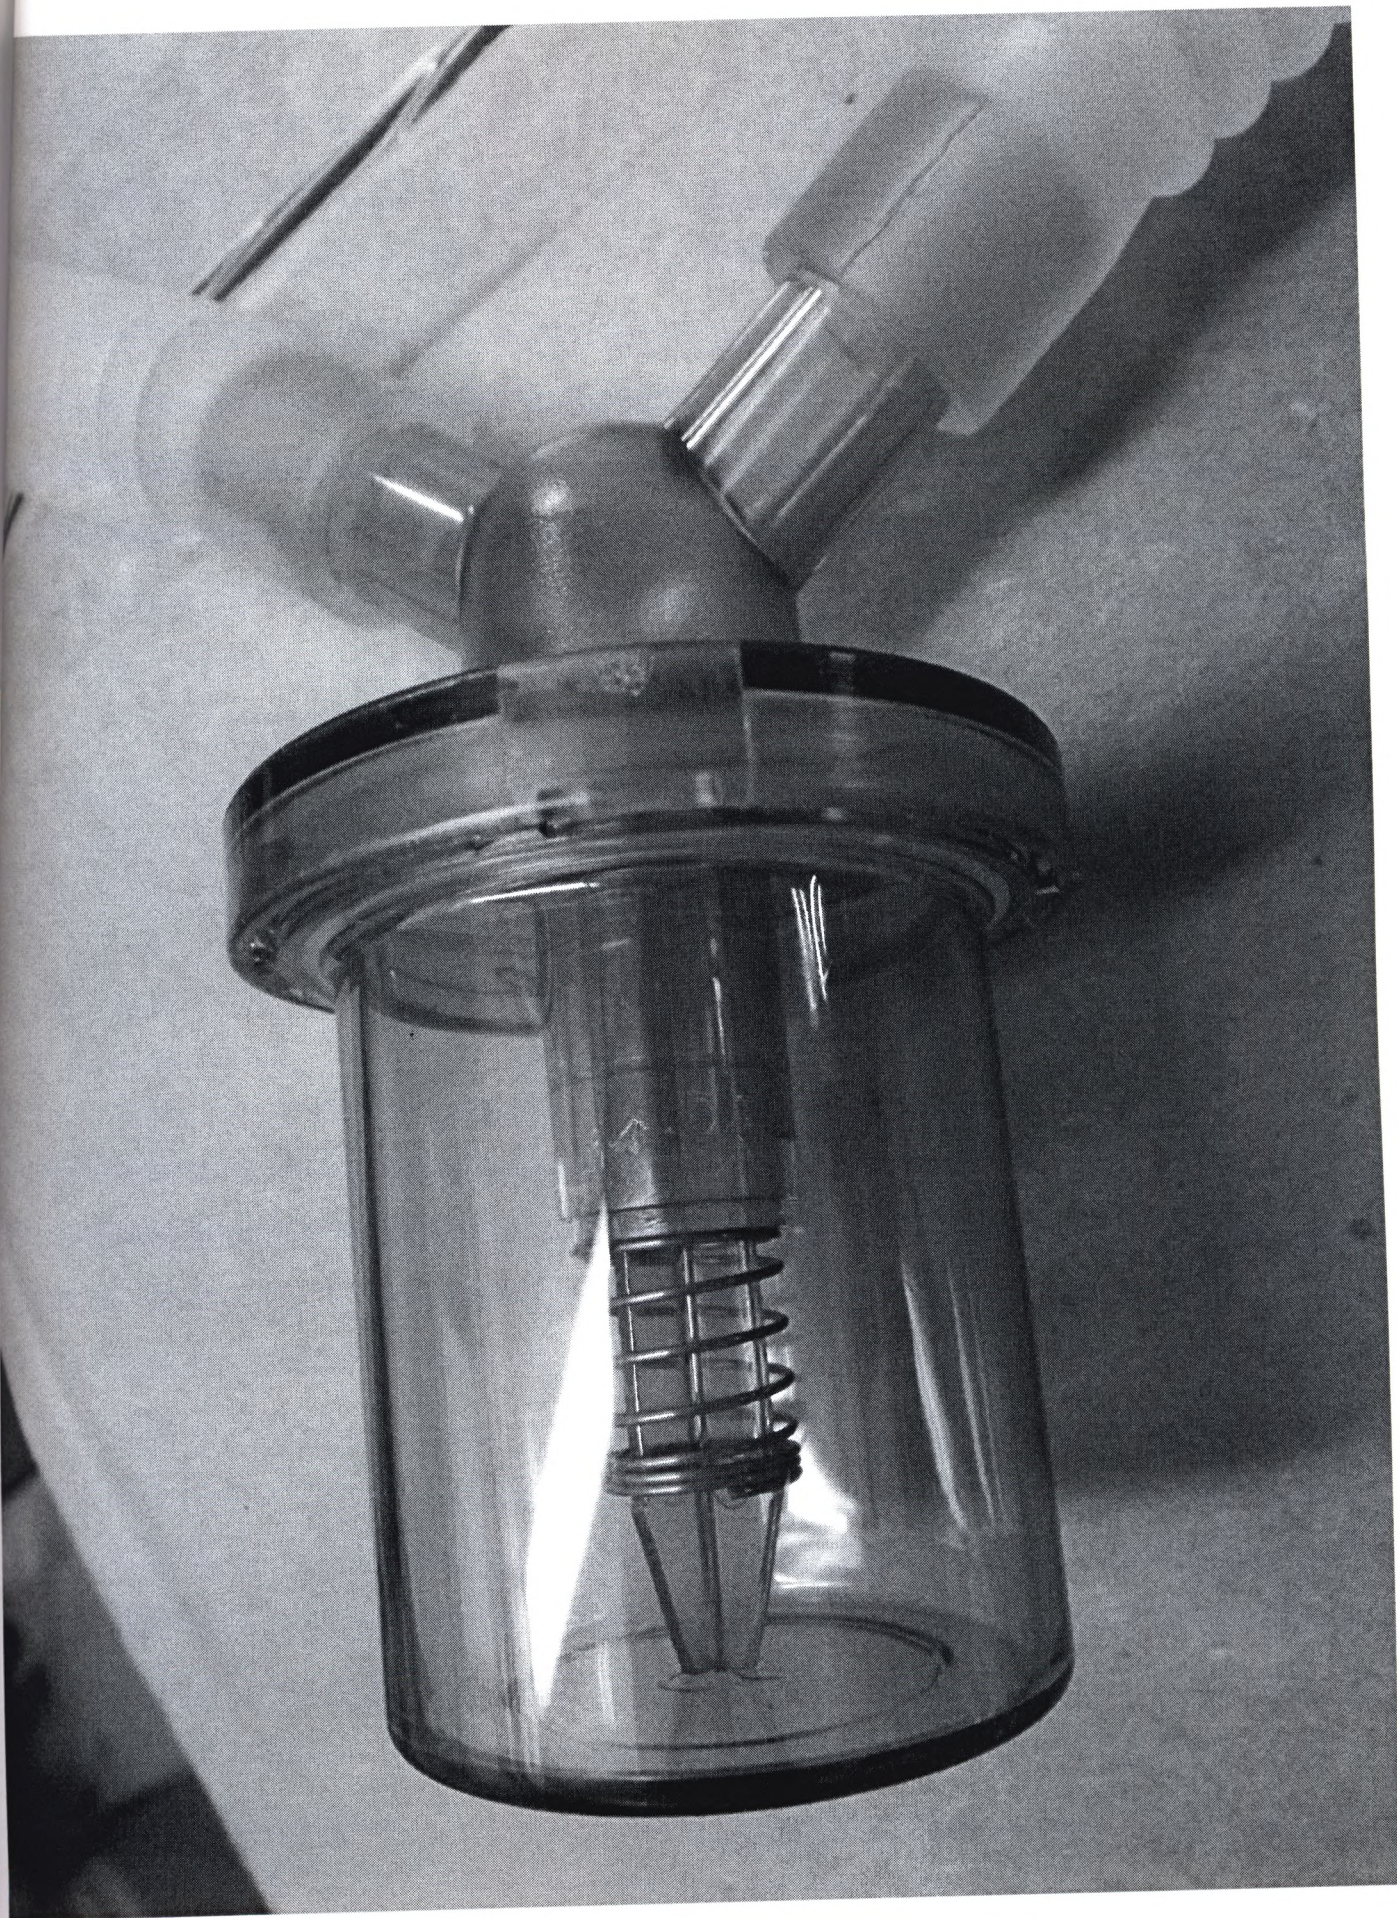

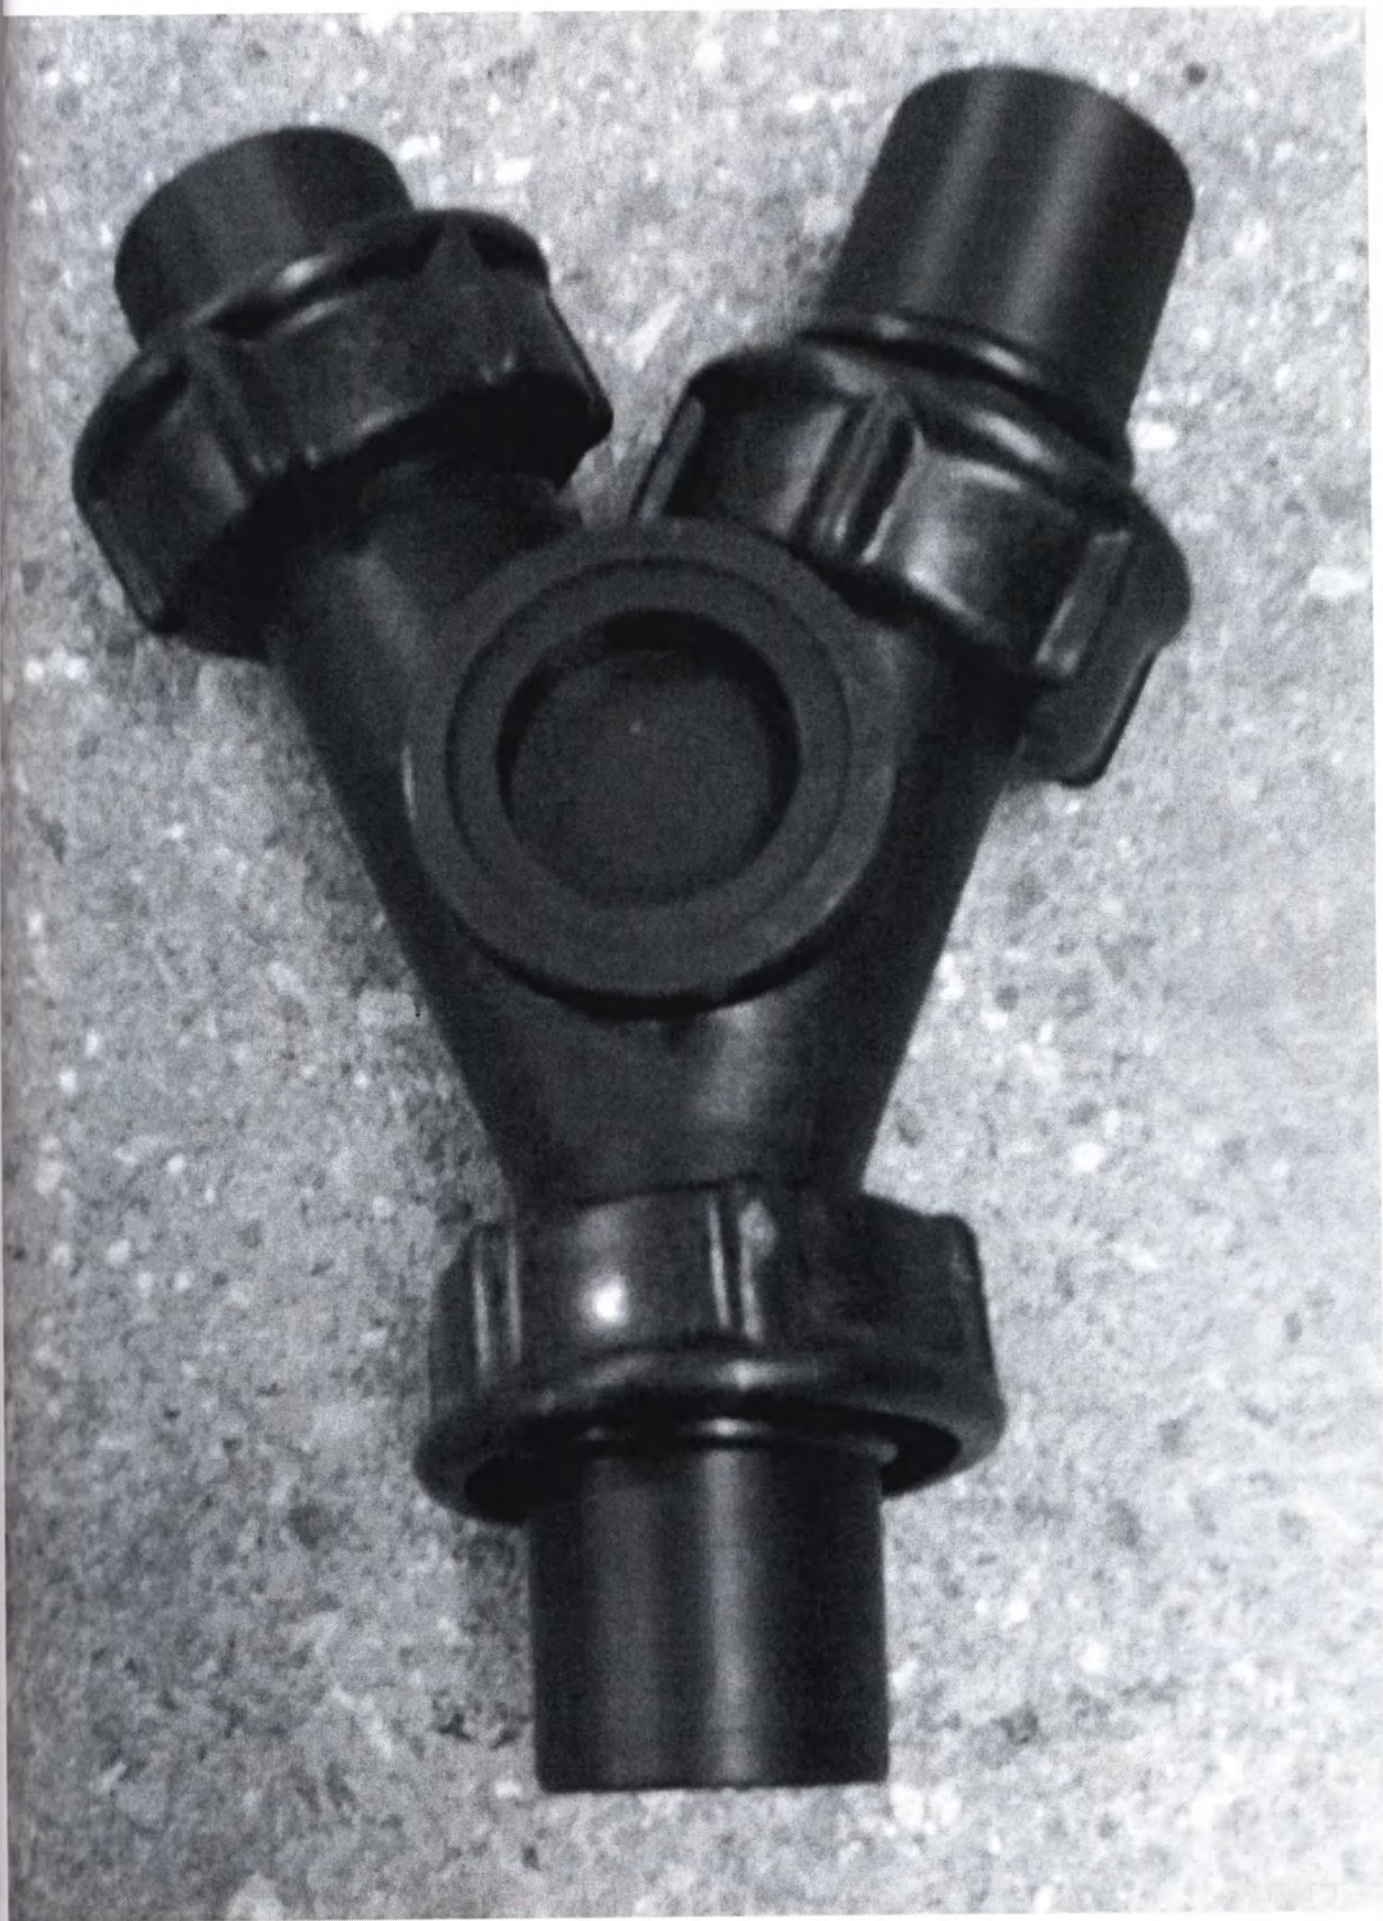


Держатель контура пациента

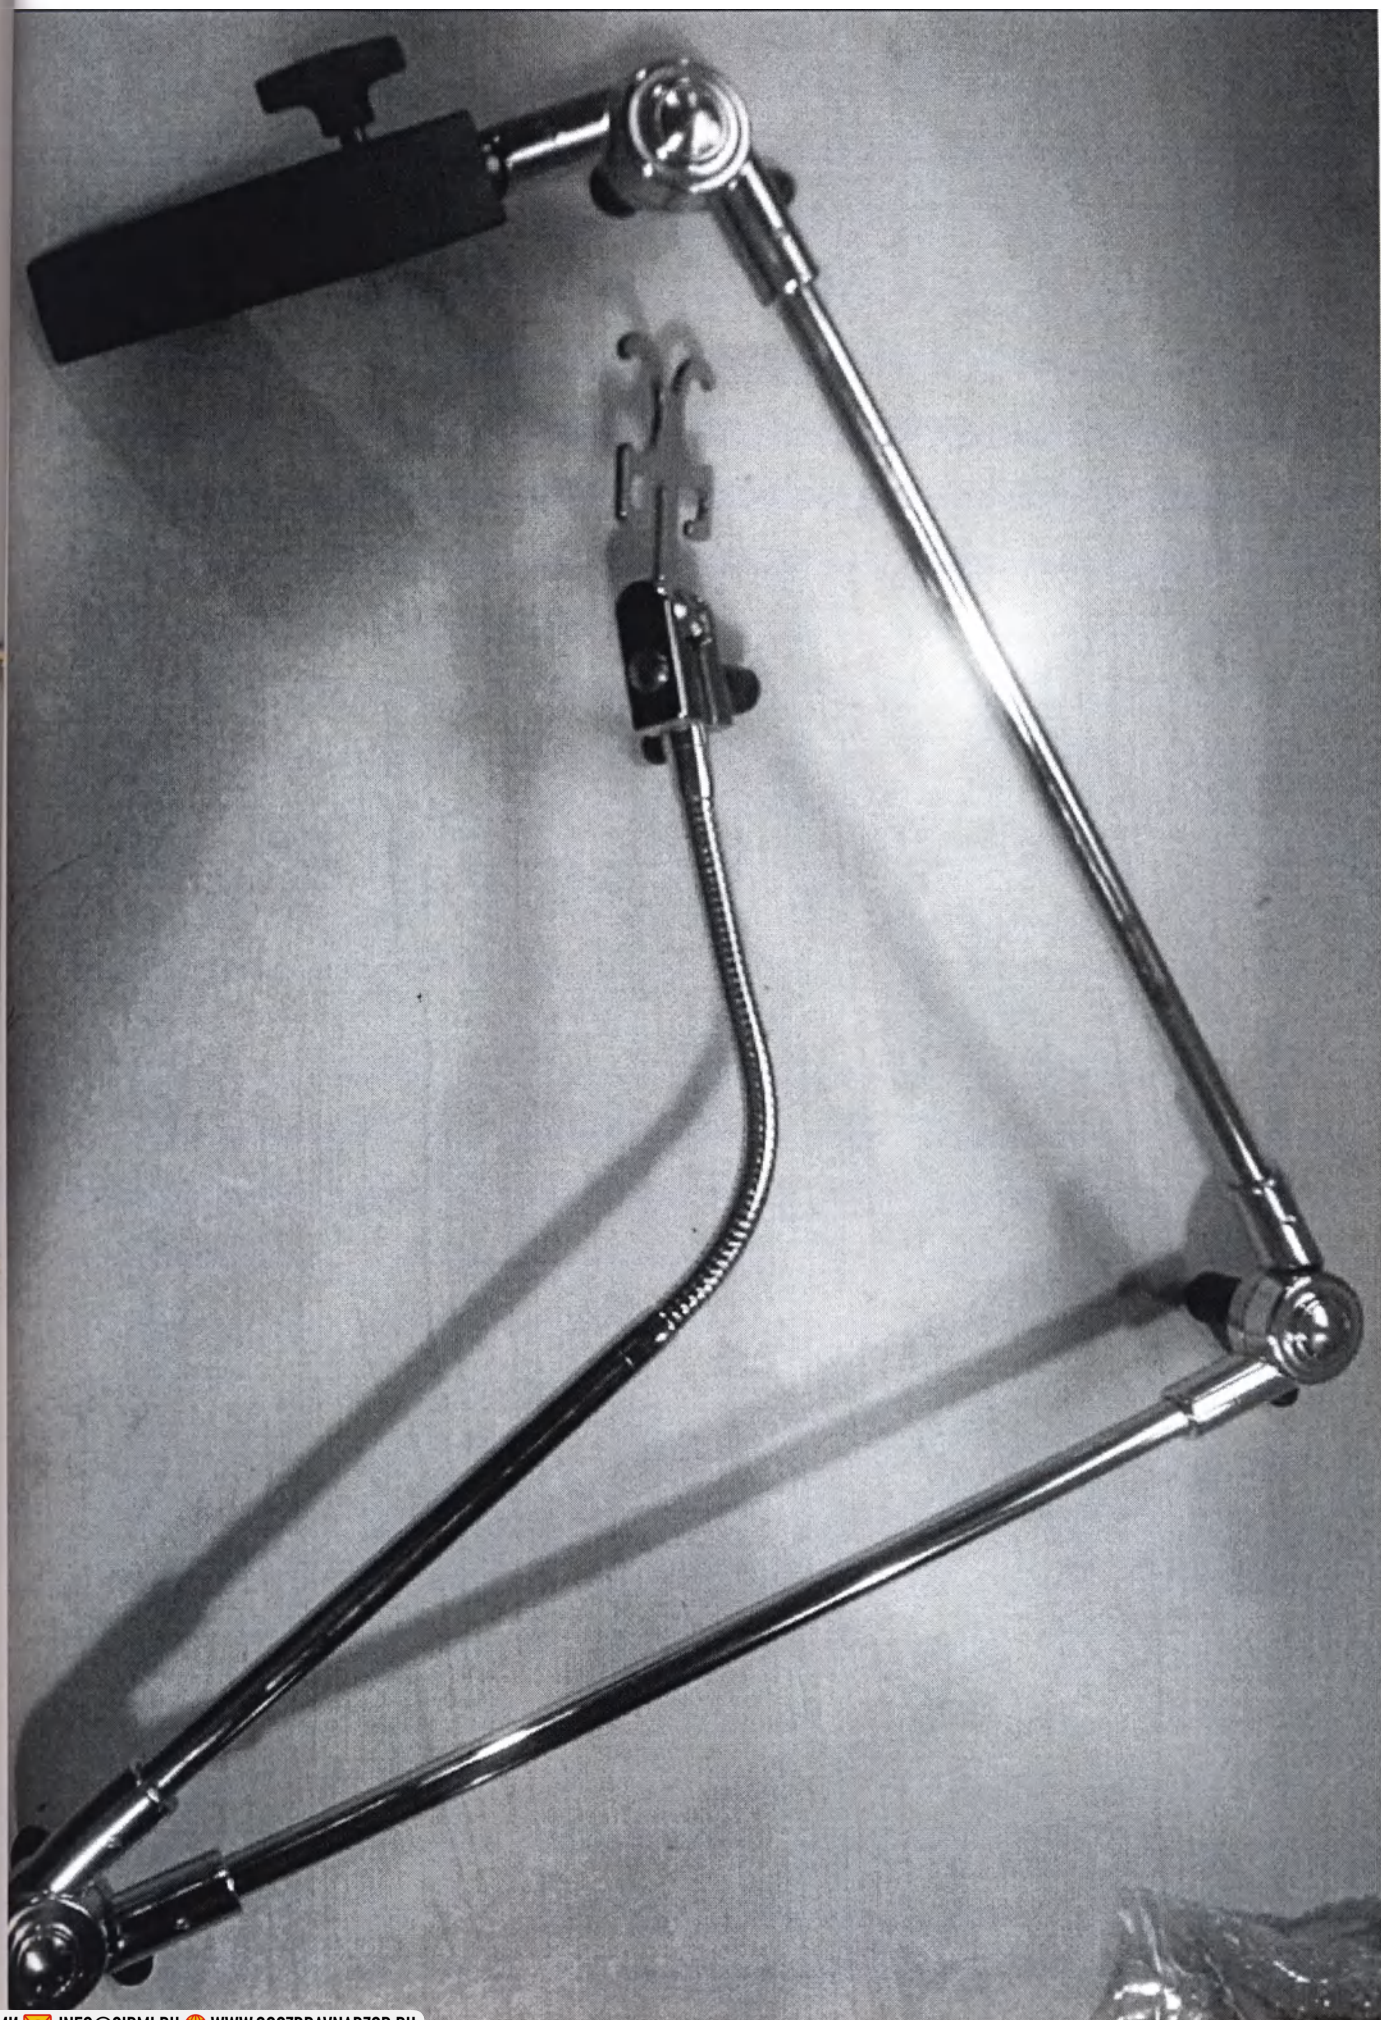




Мешок дыхательный

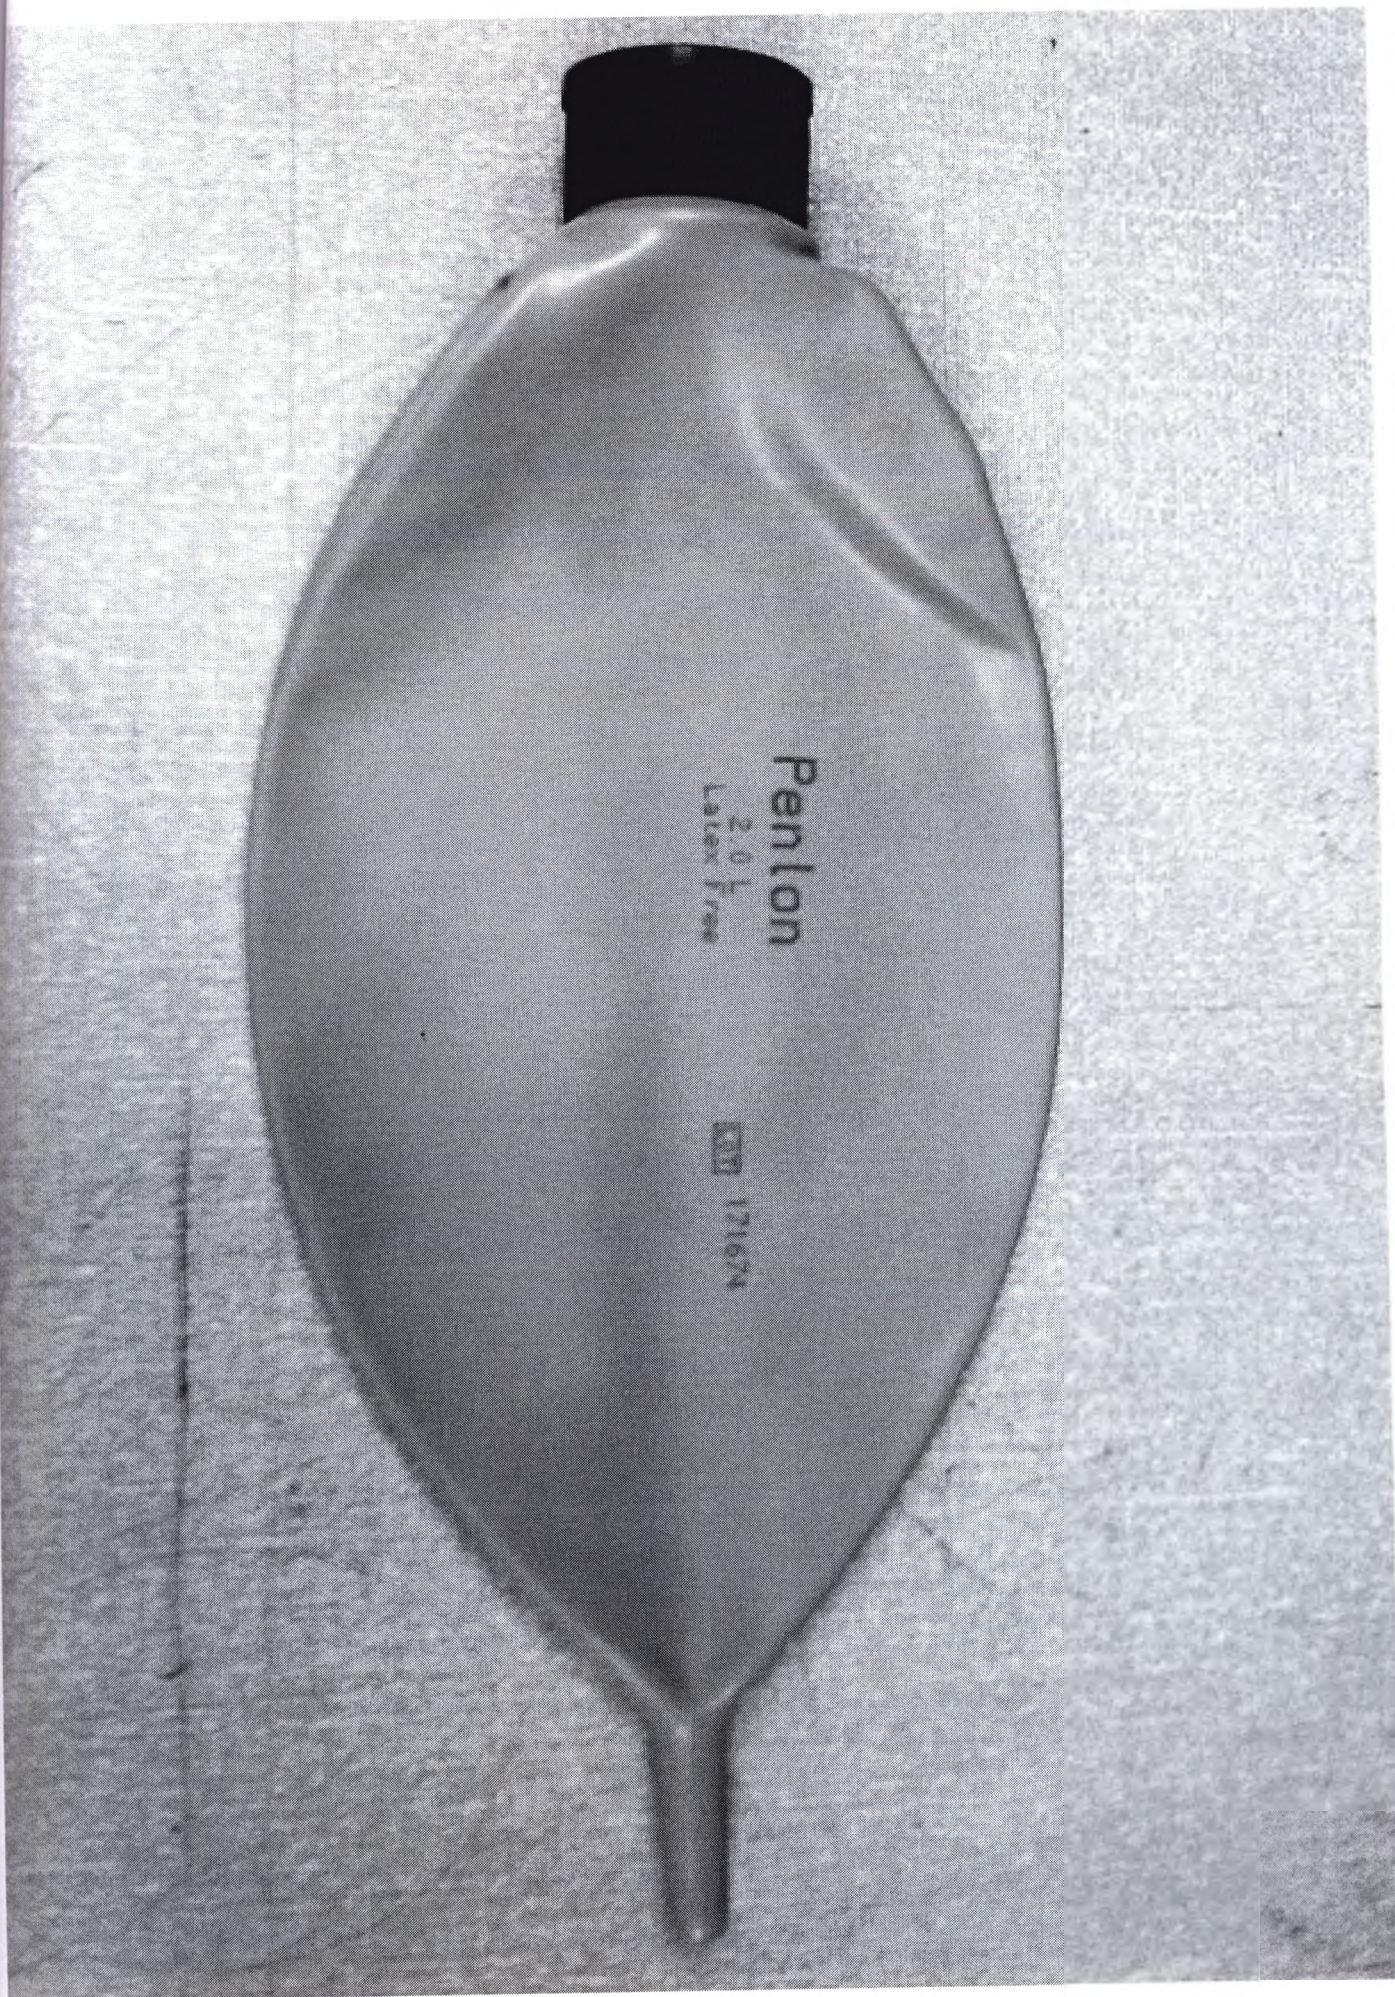





Дыхательный мех педиатрический (мех, емкость меха, переходник базы меха)
на фото - емкость меха

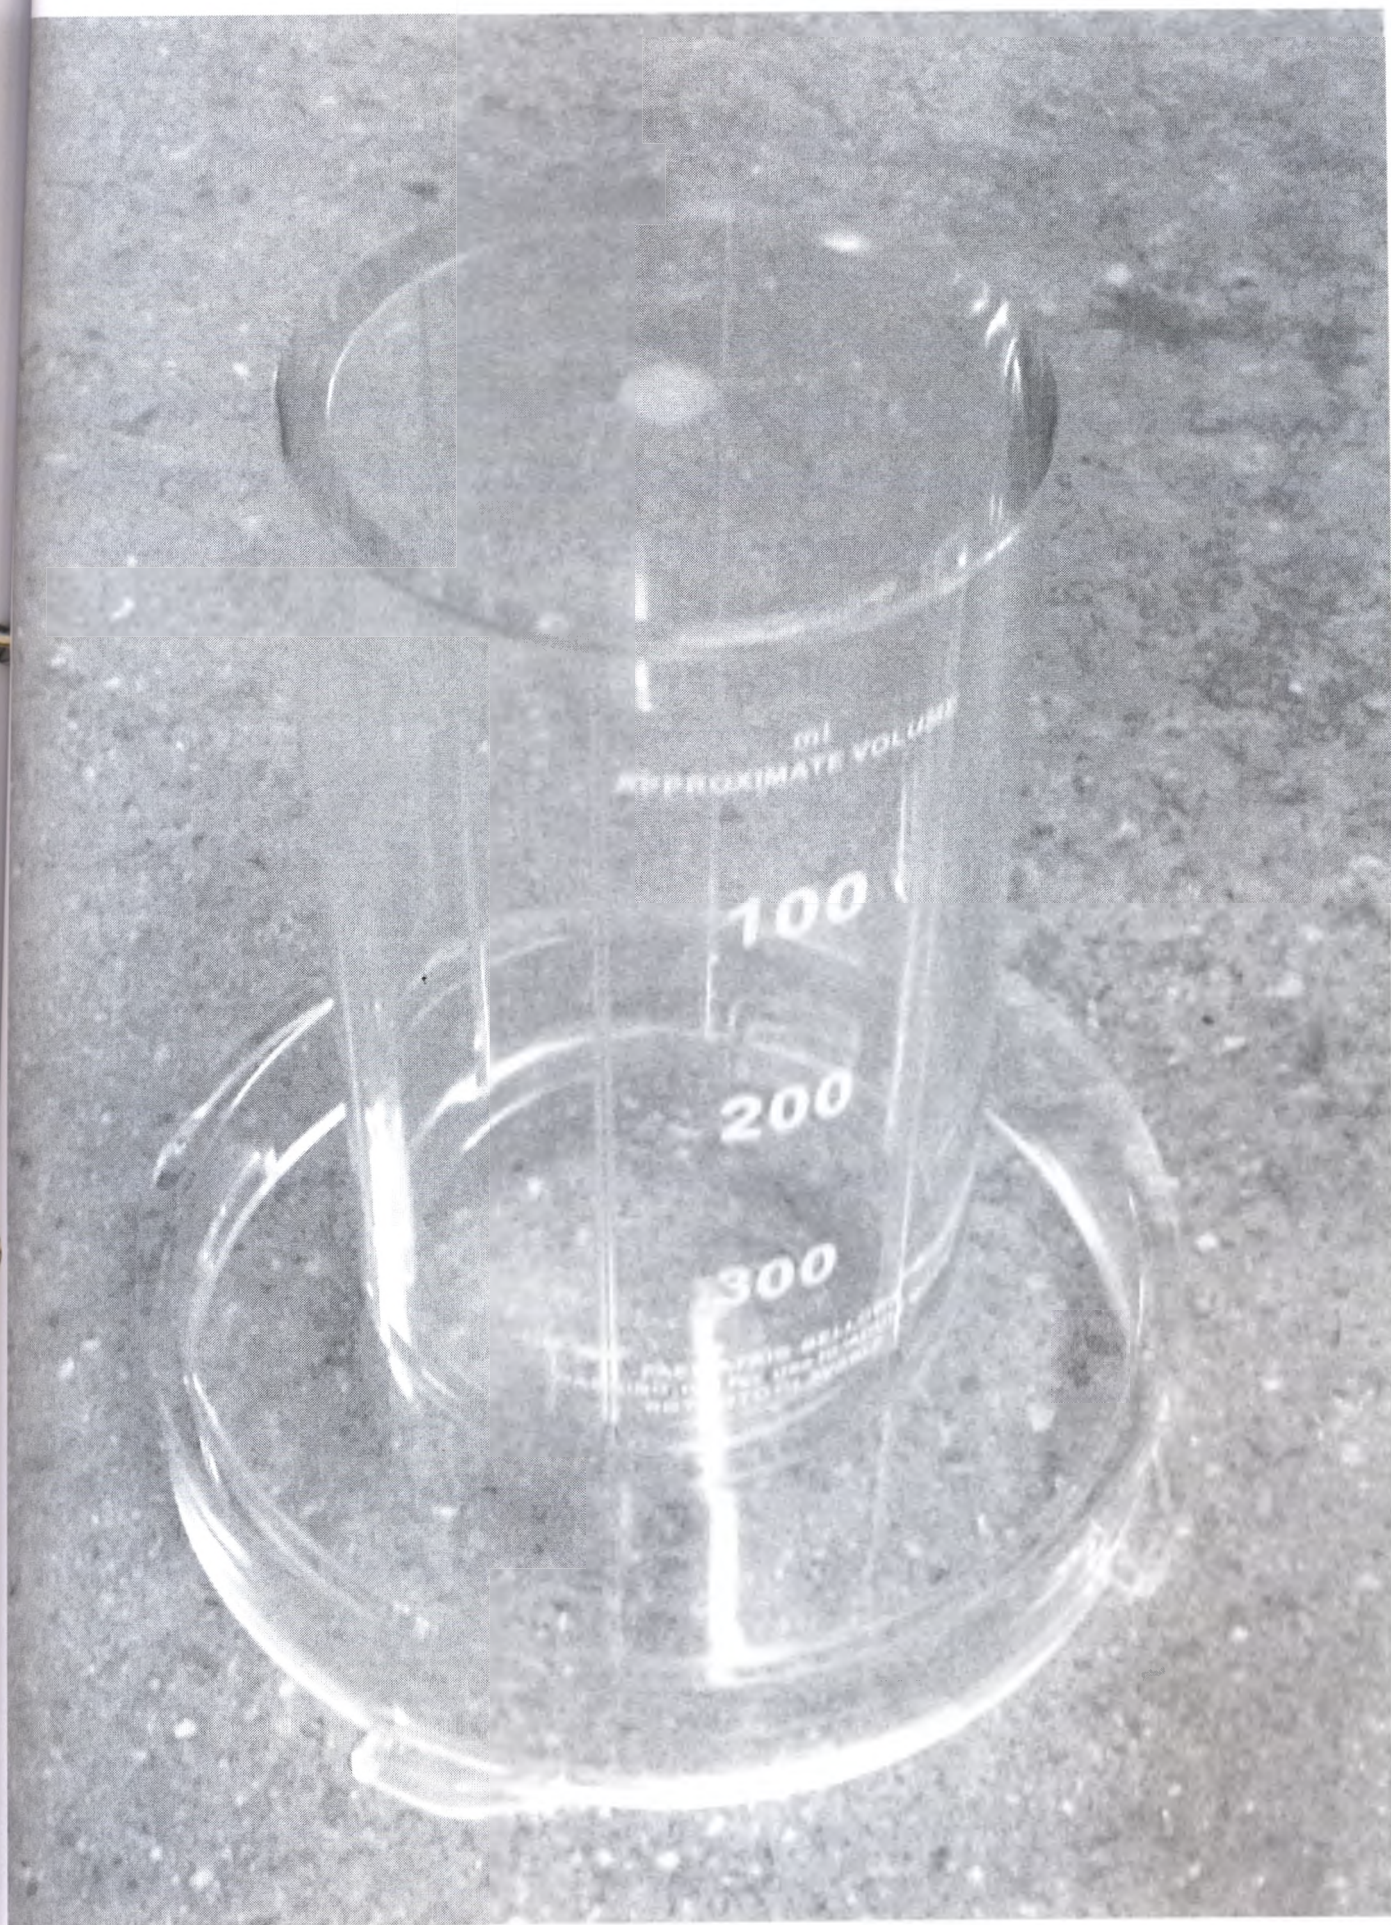

Дыхательный мех педиатрический (мех, емкость меха, переходник базы меха)
на фото - переходник базы меха

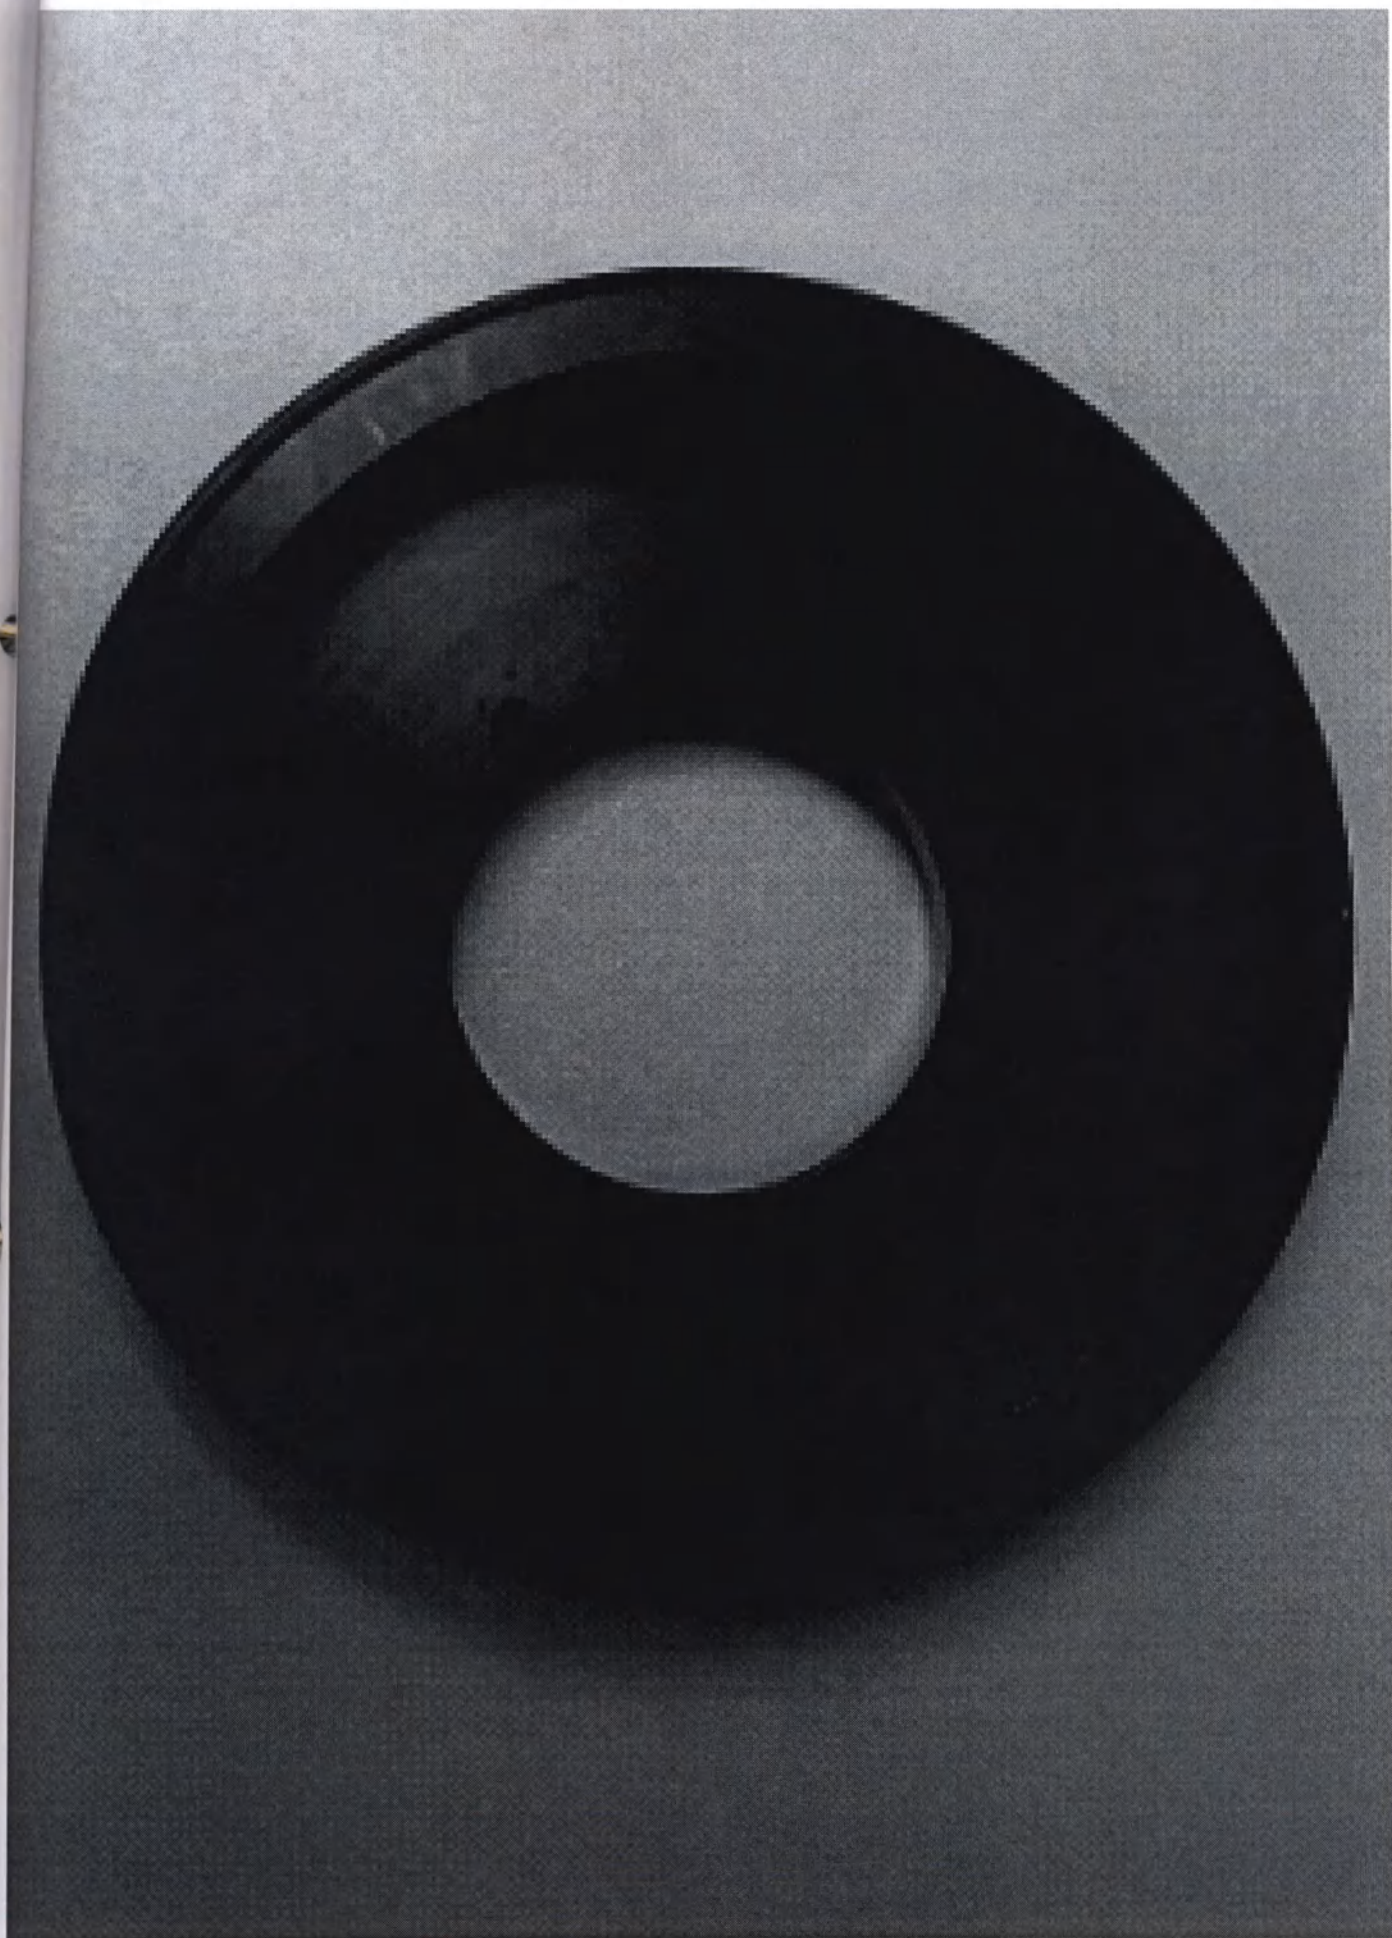




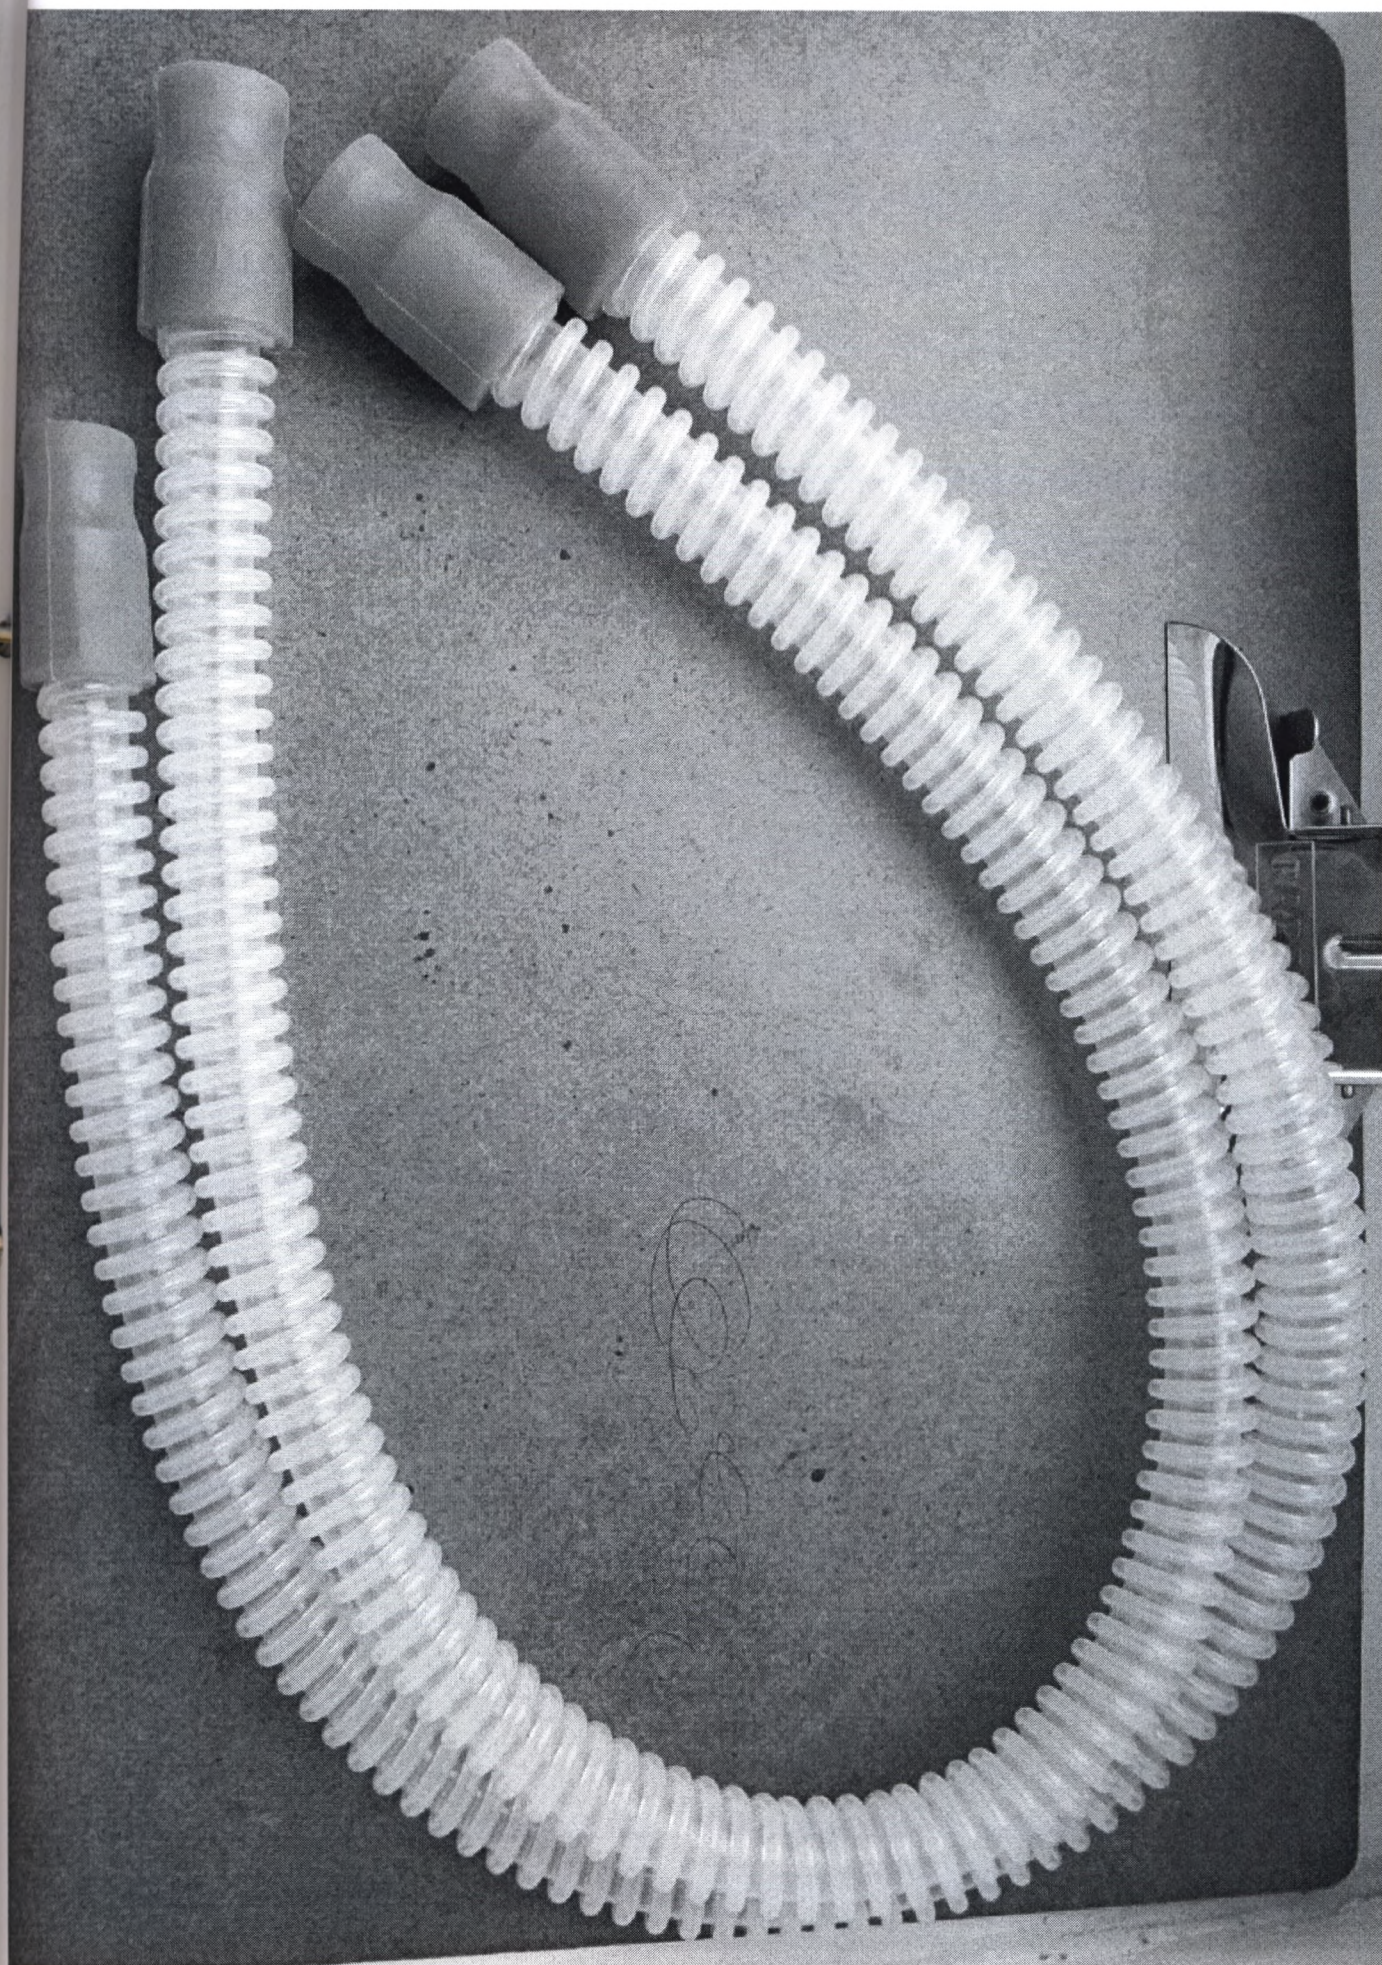






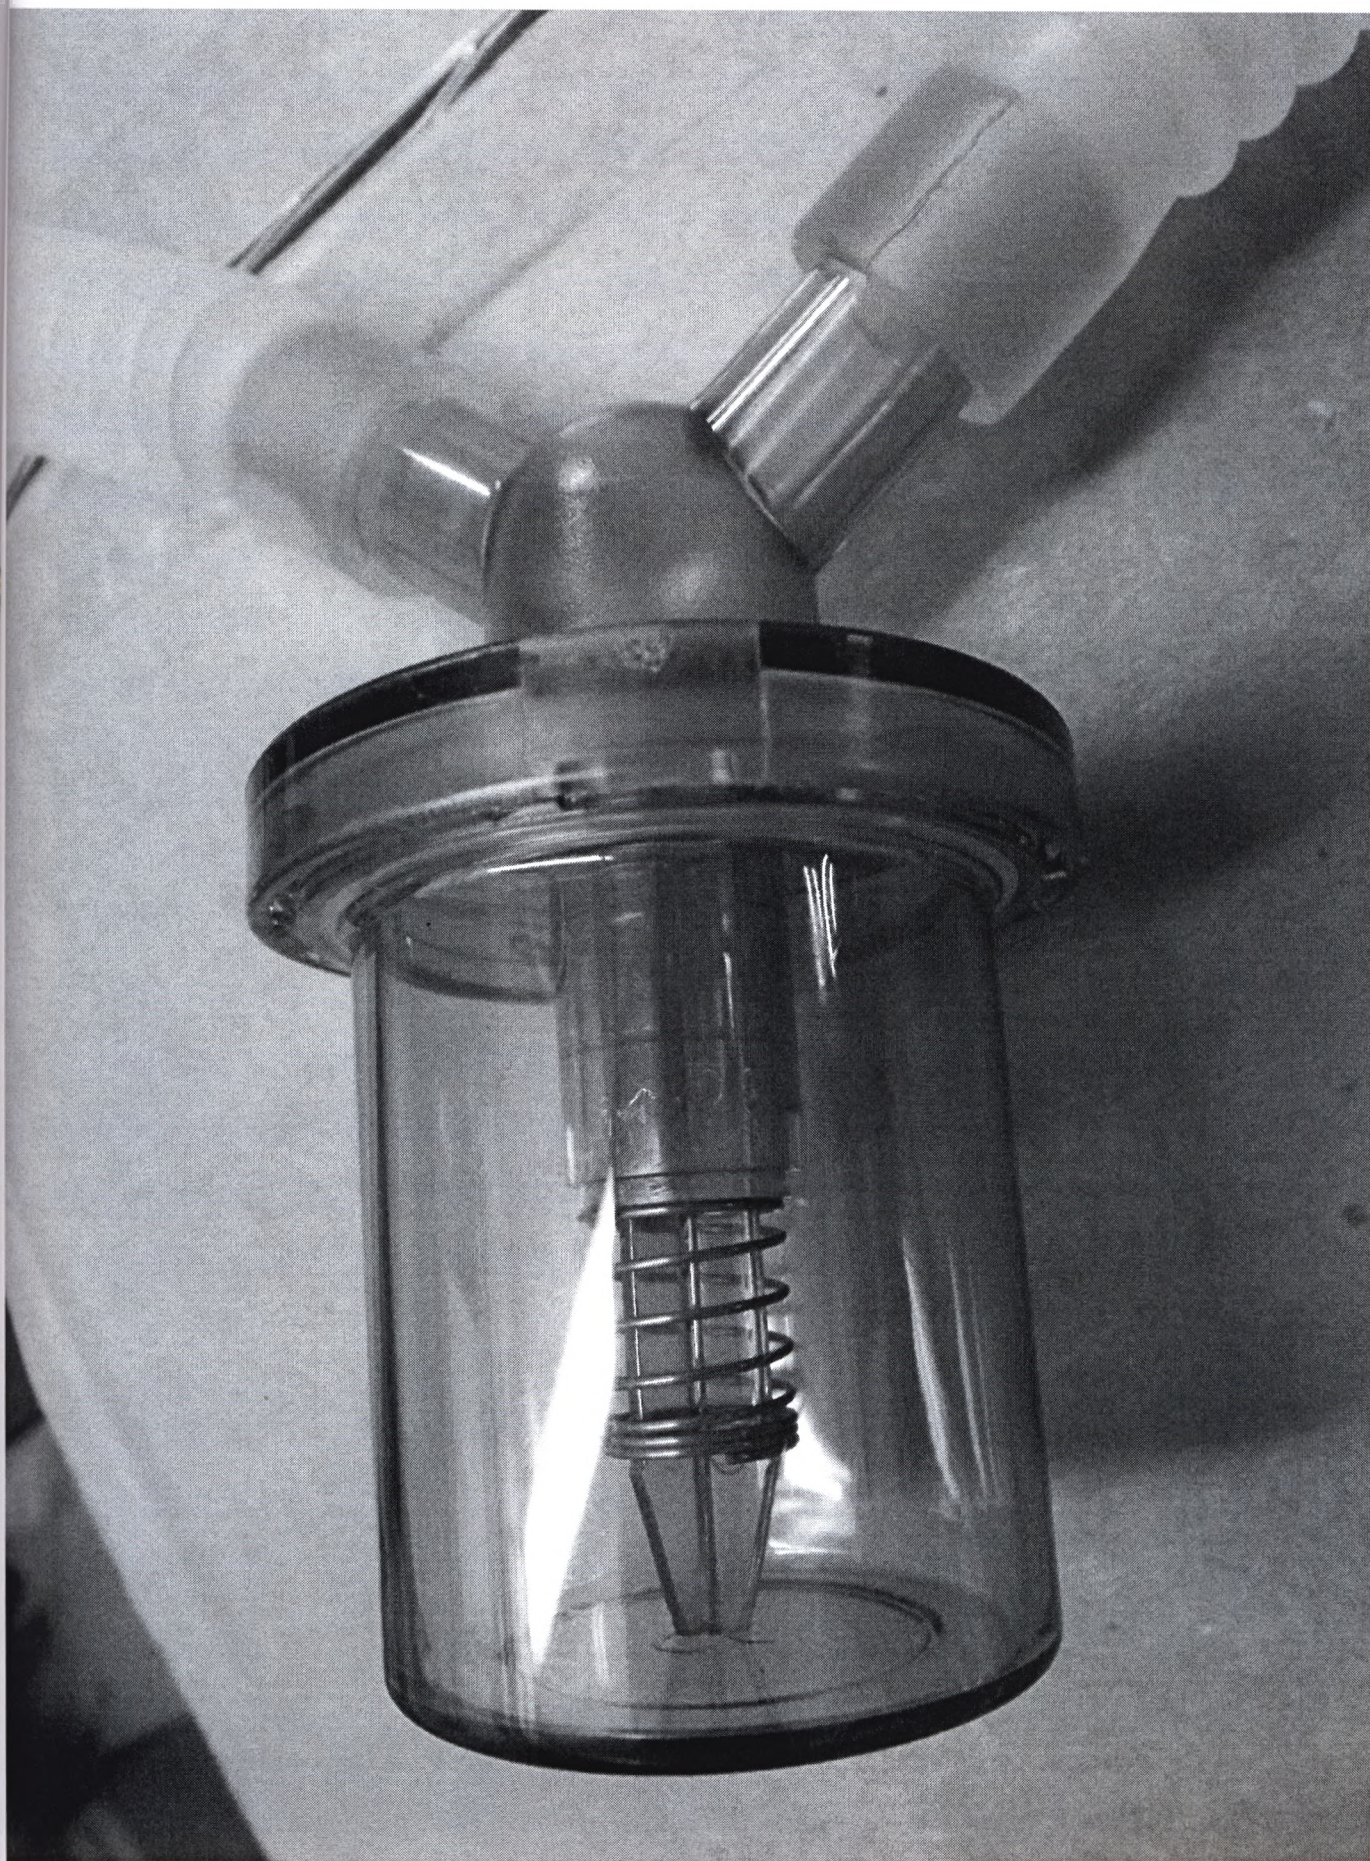



Крепление респираторного блока

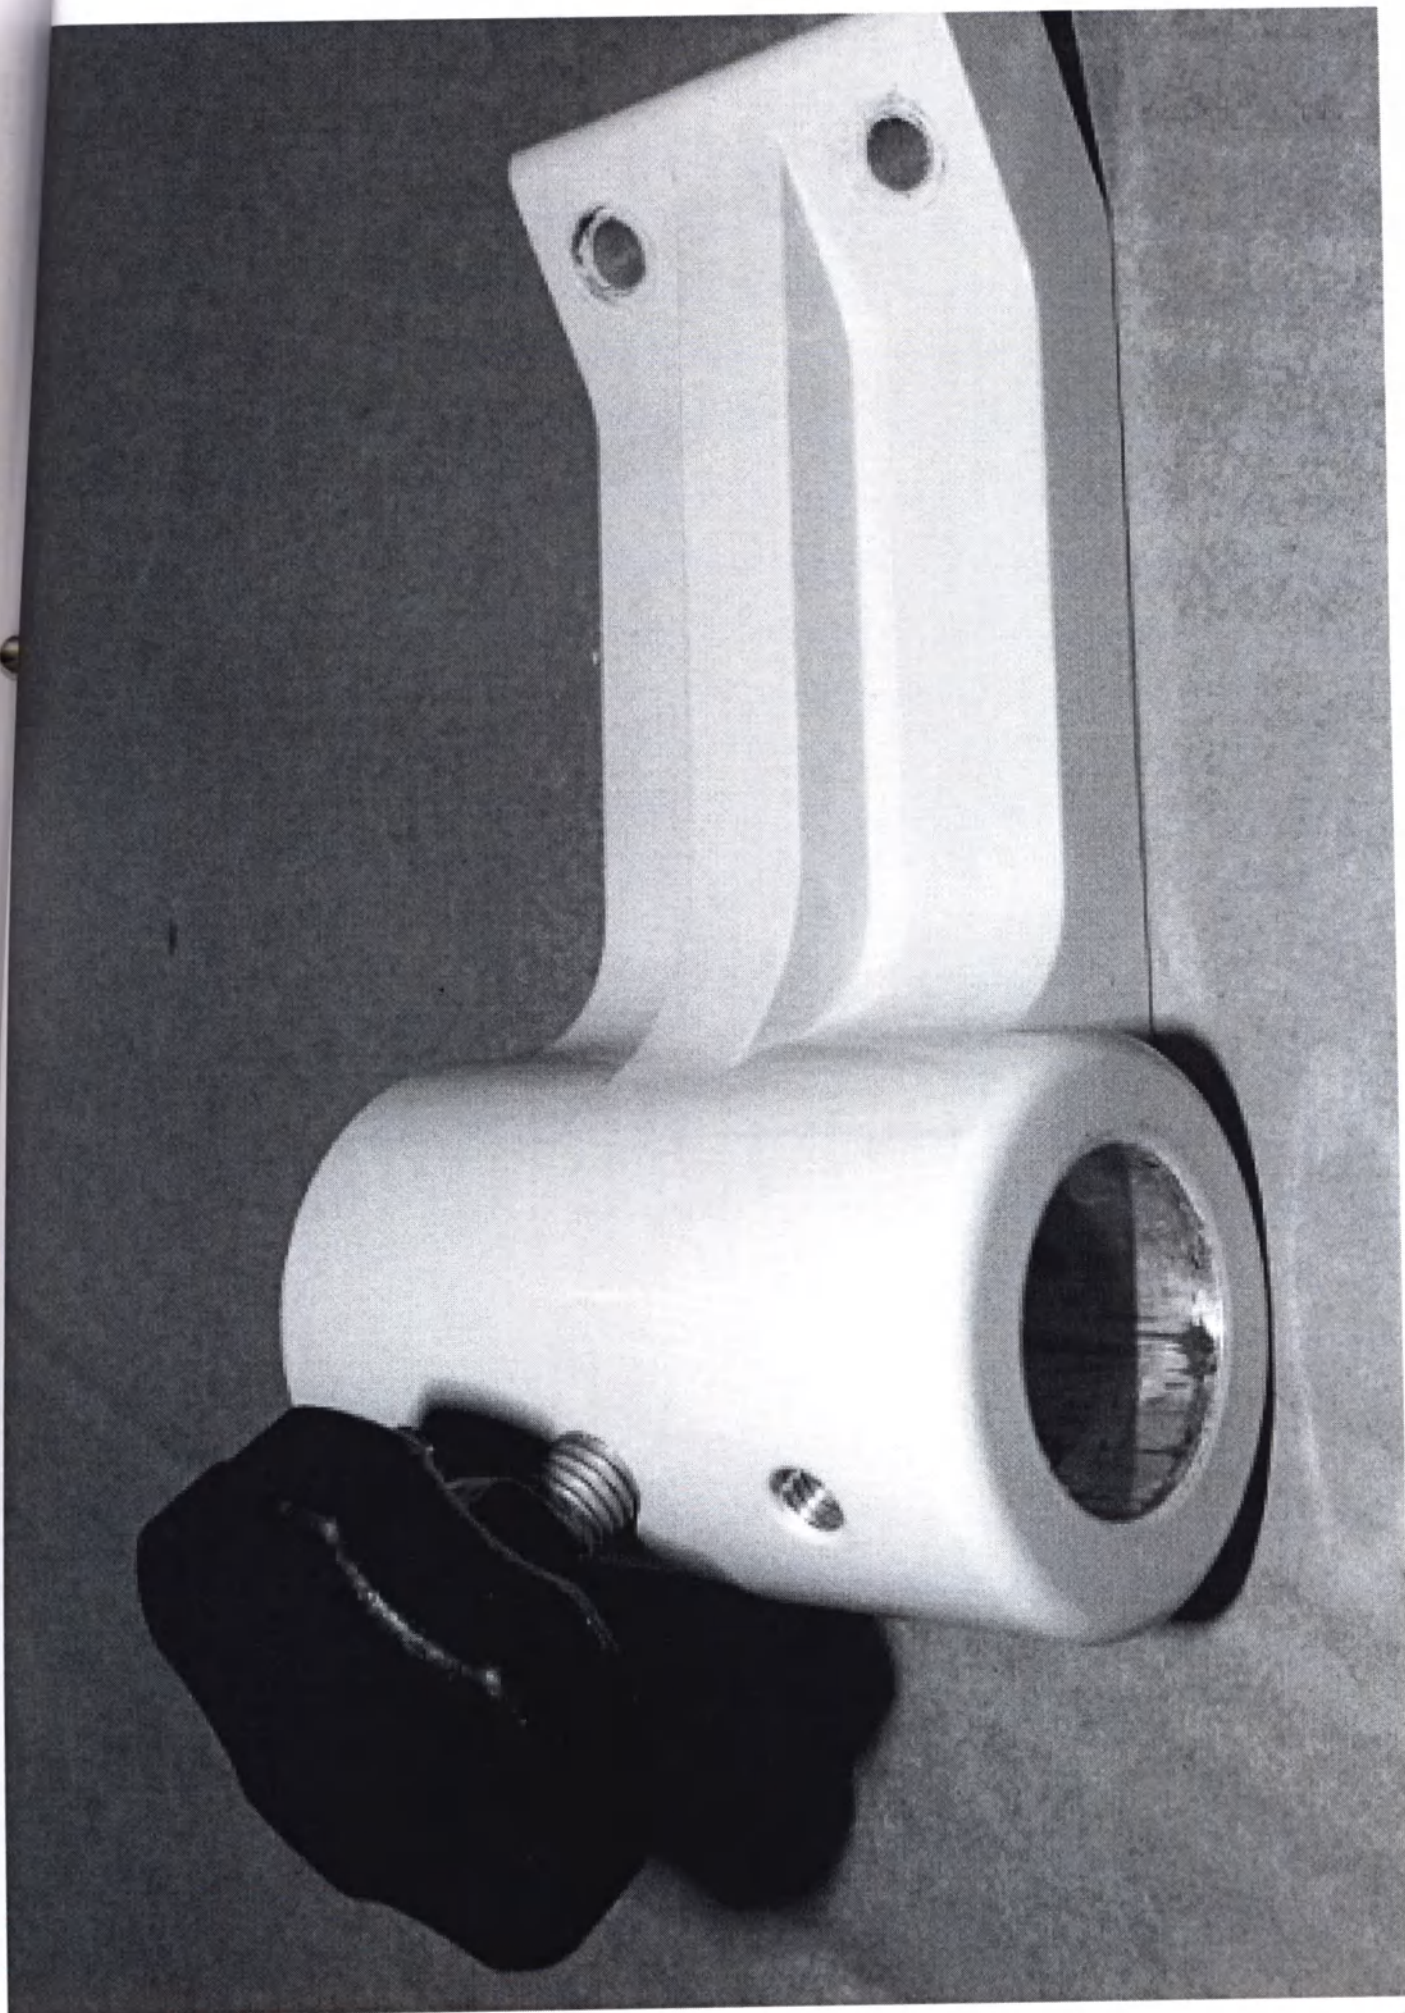





Крепление для дополнительного

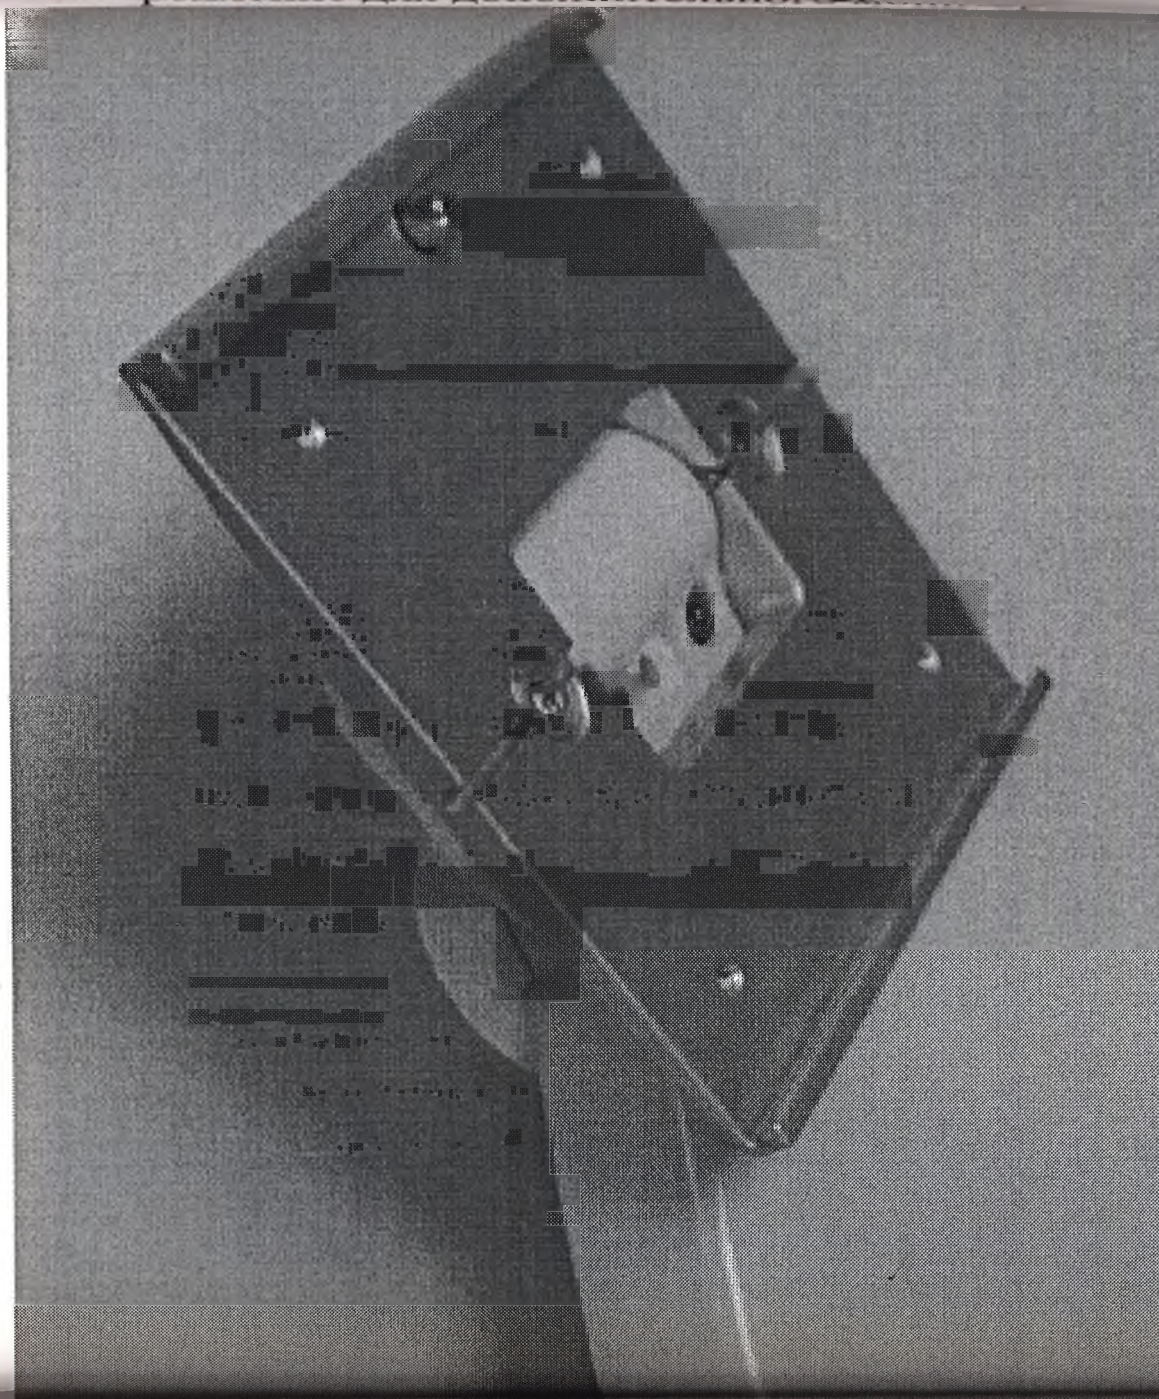


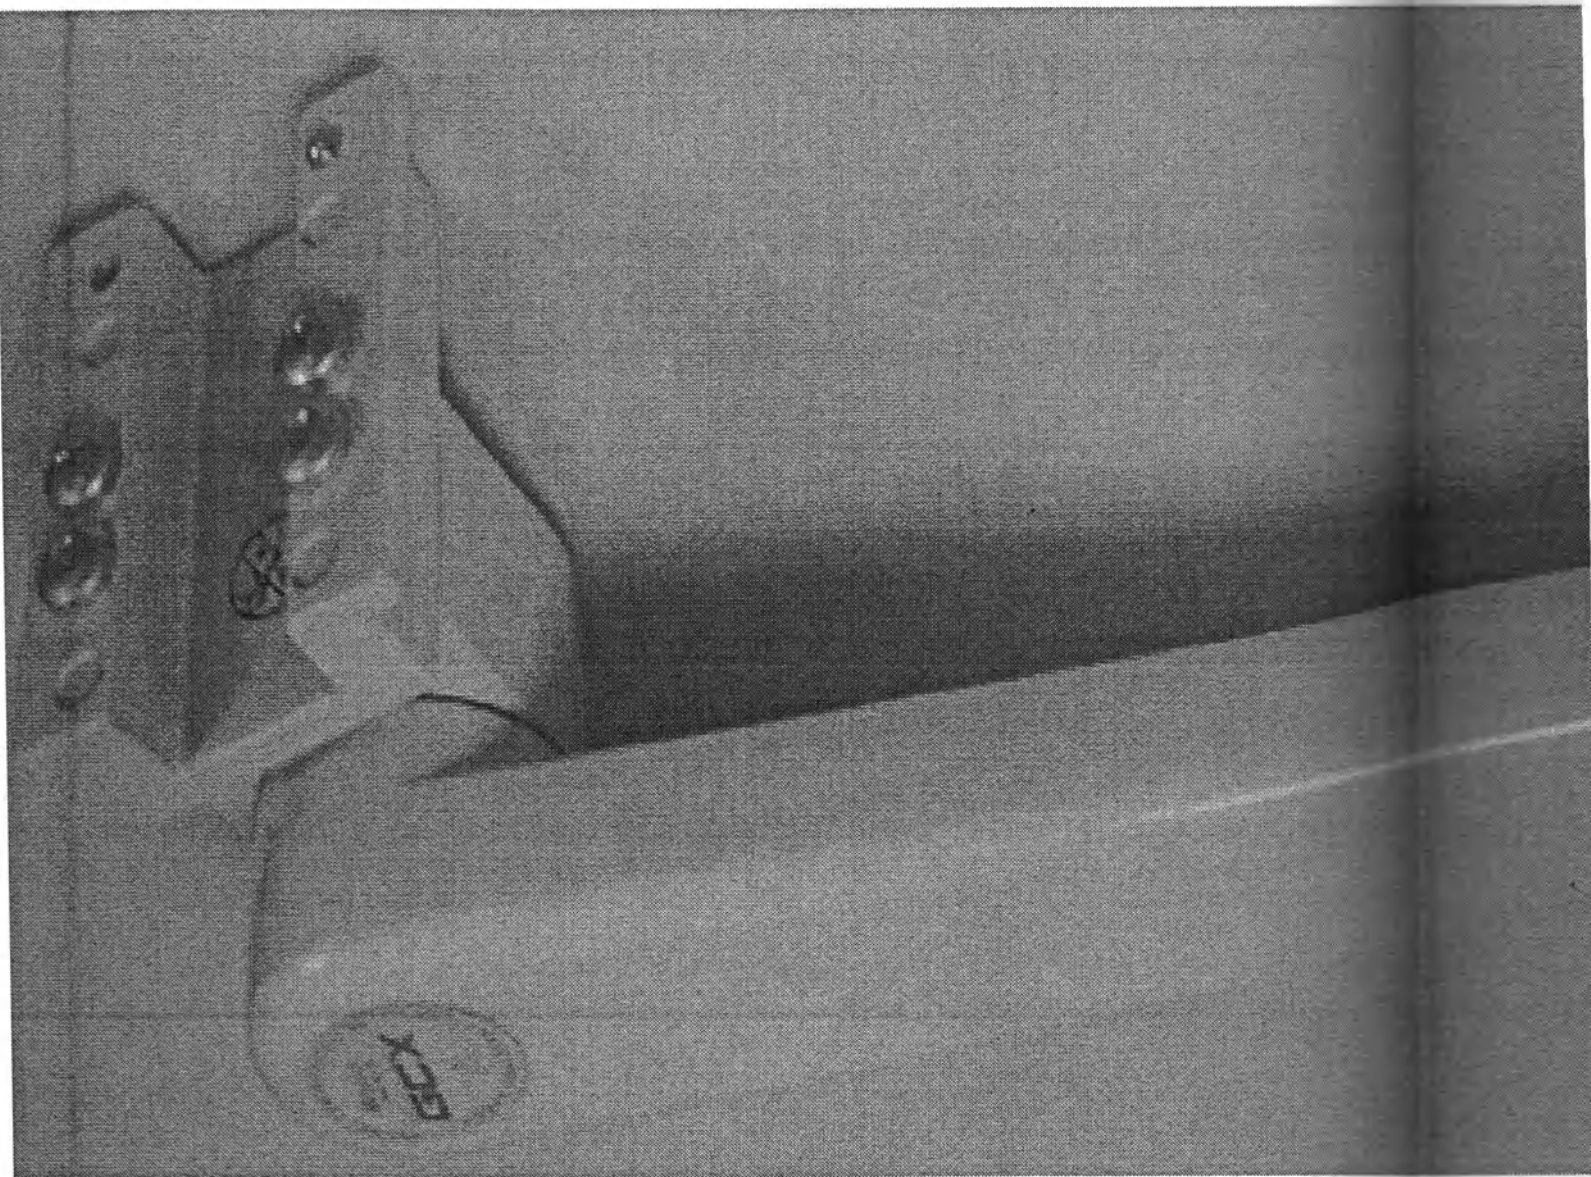

Боковой стержневой кронштейн

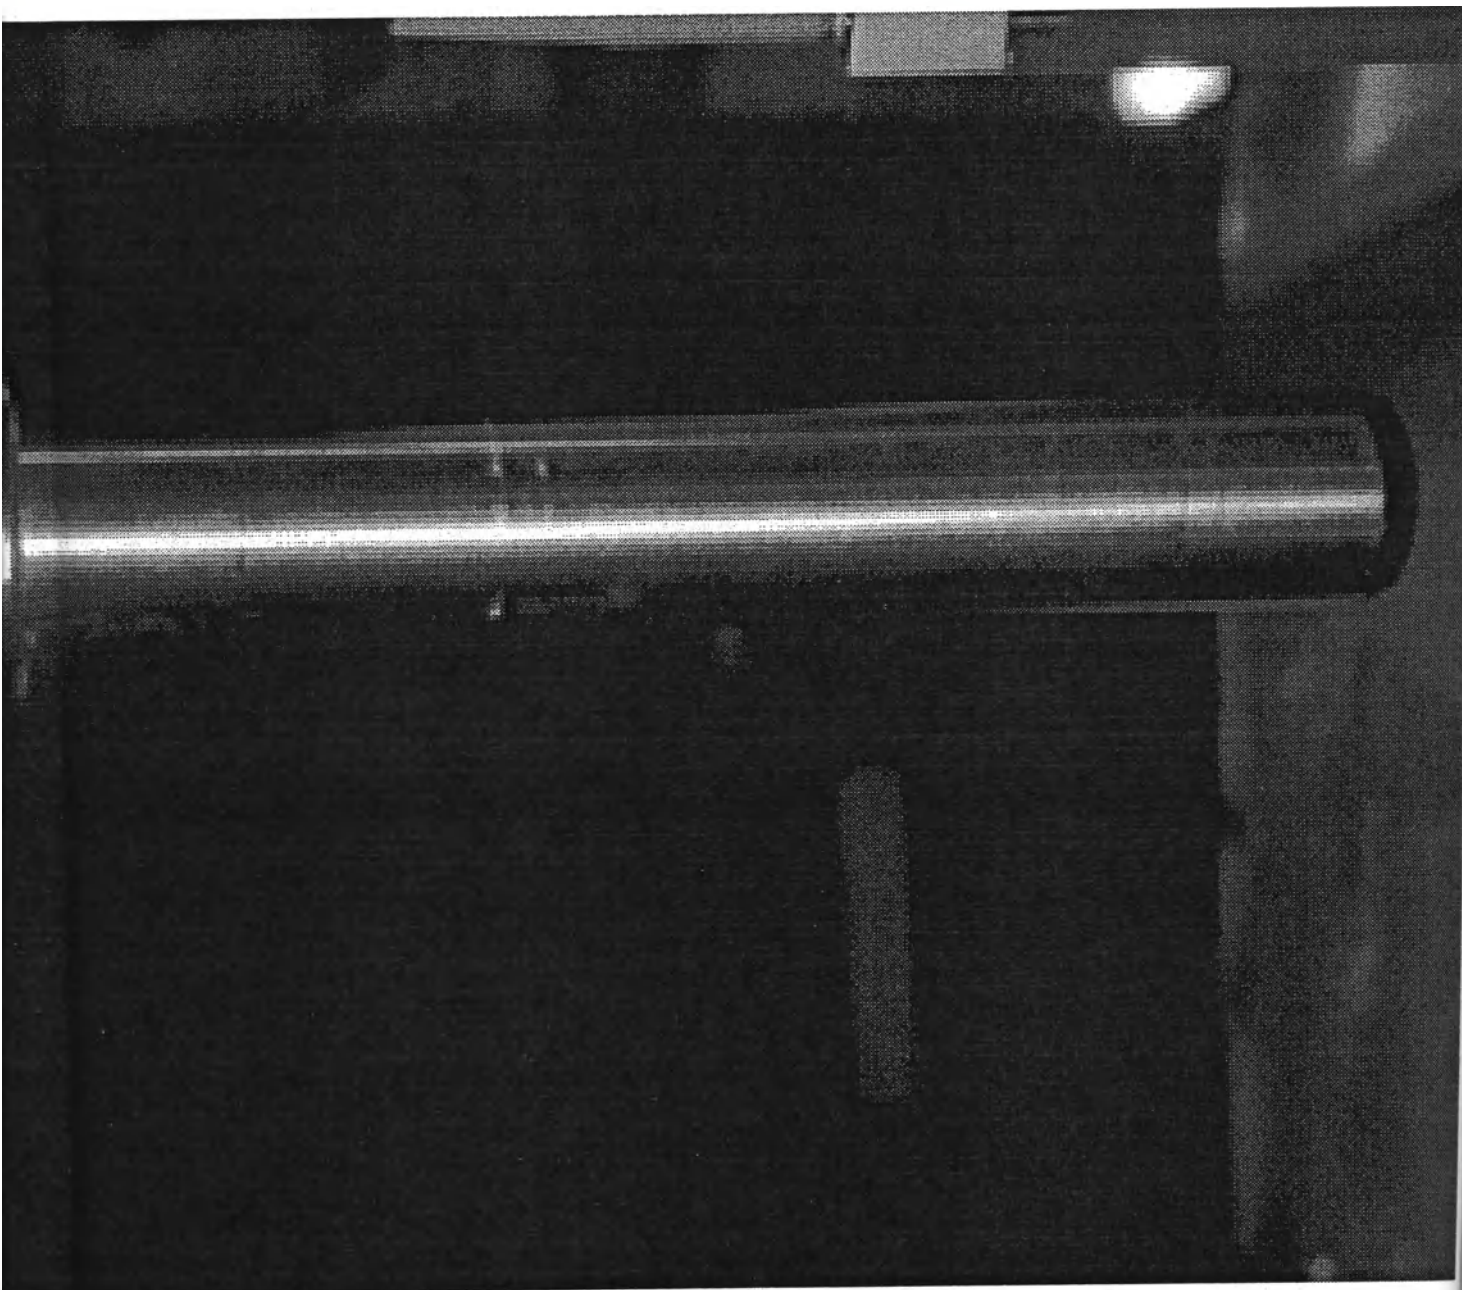

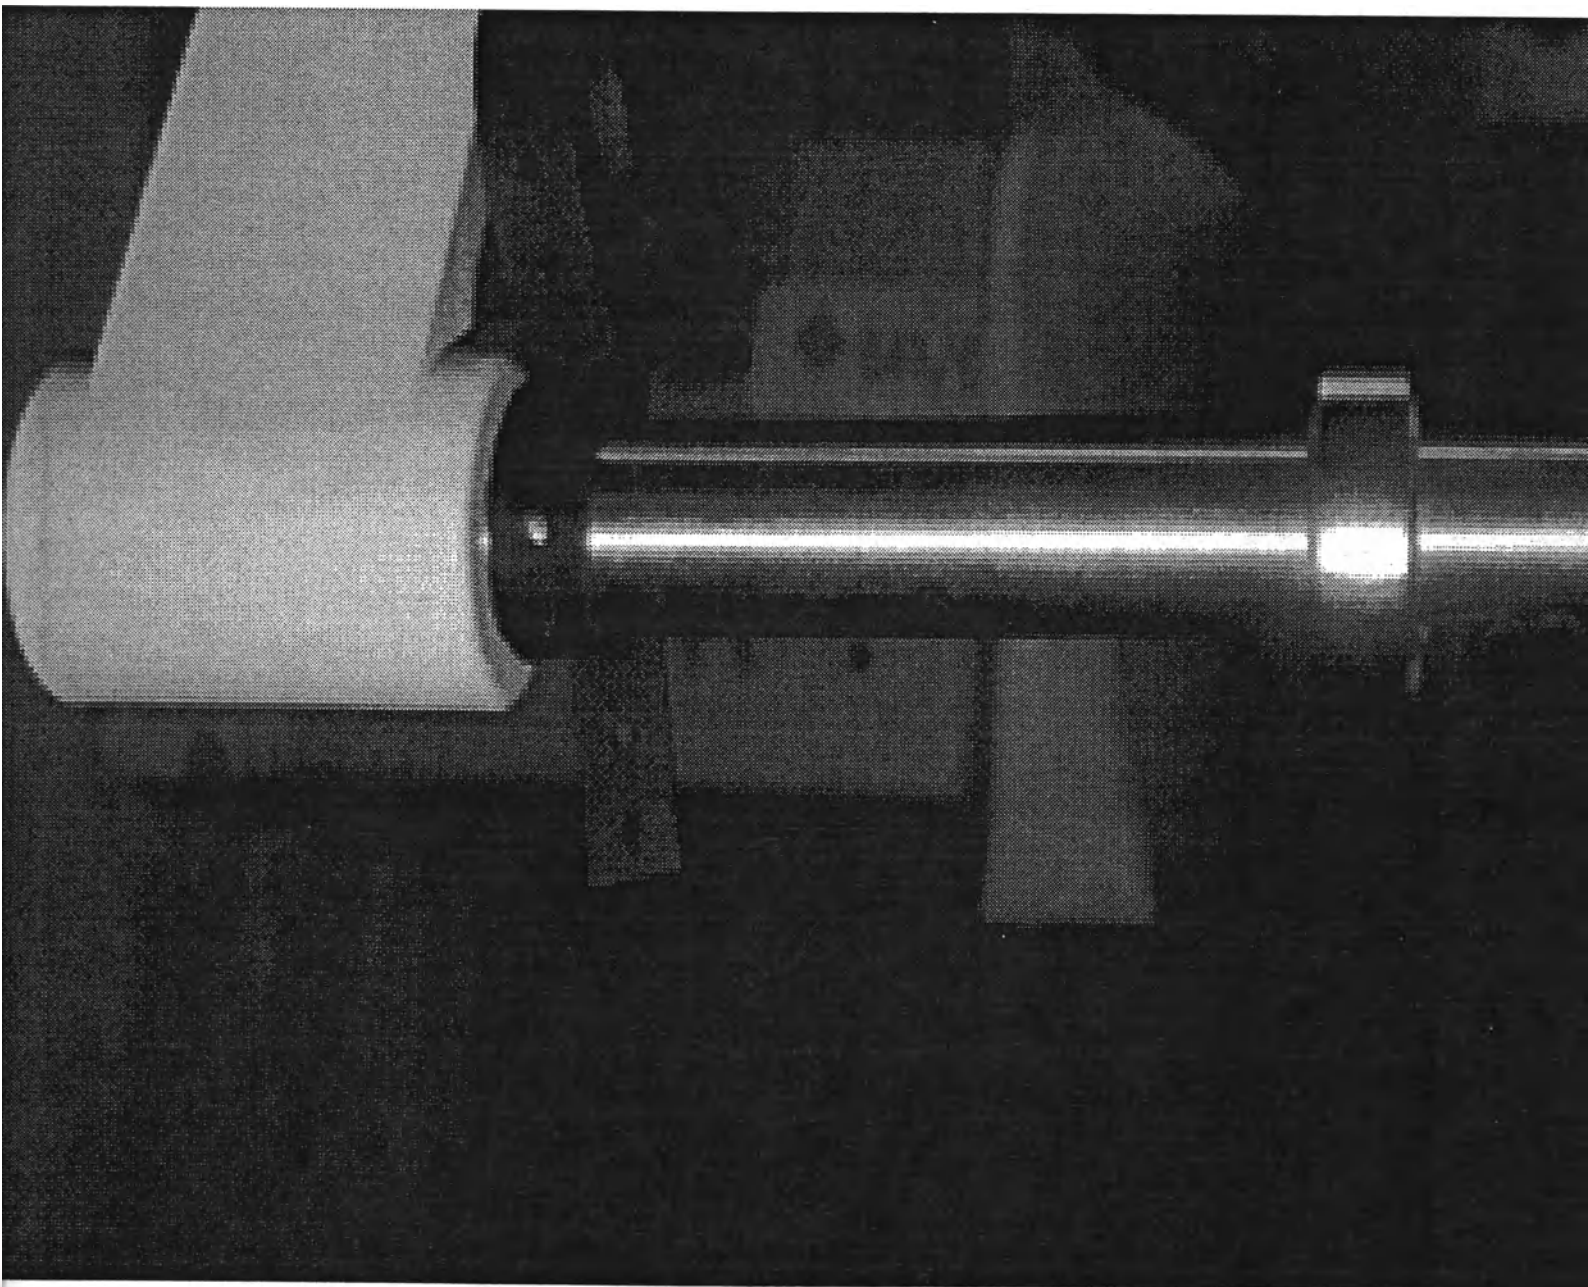


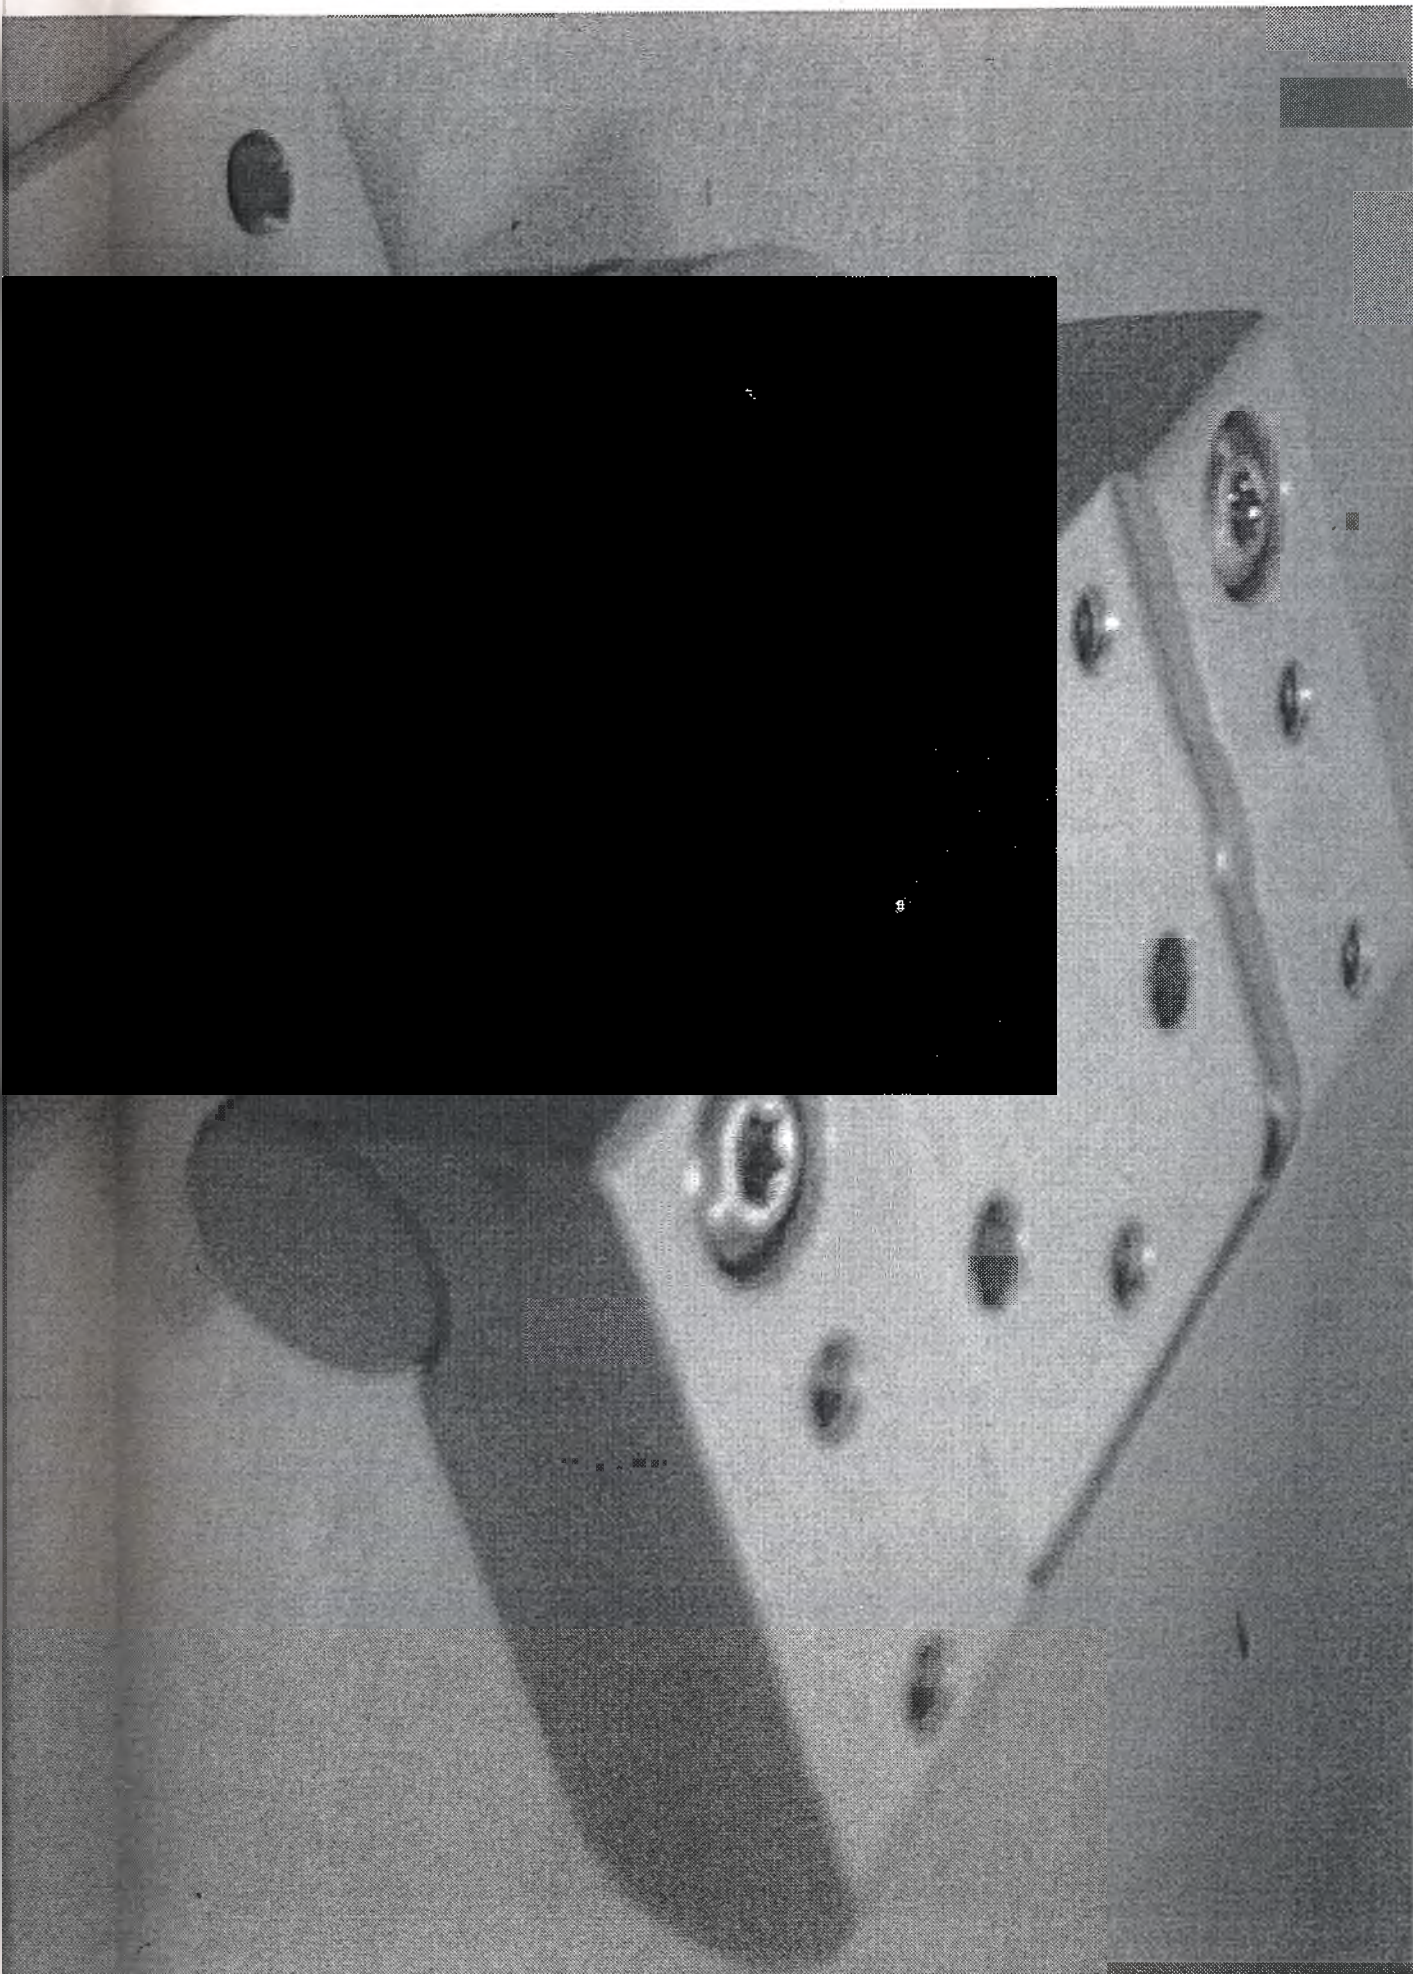

Крепление монтажного кронштейна




V-крепления для принадлежностей

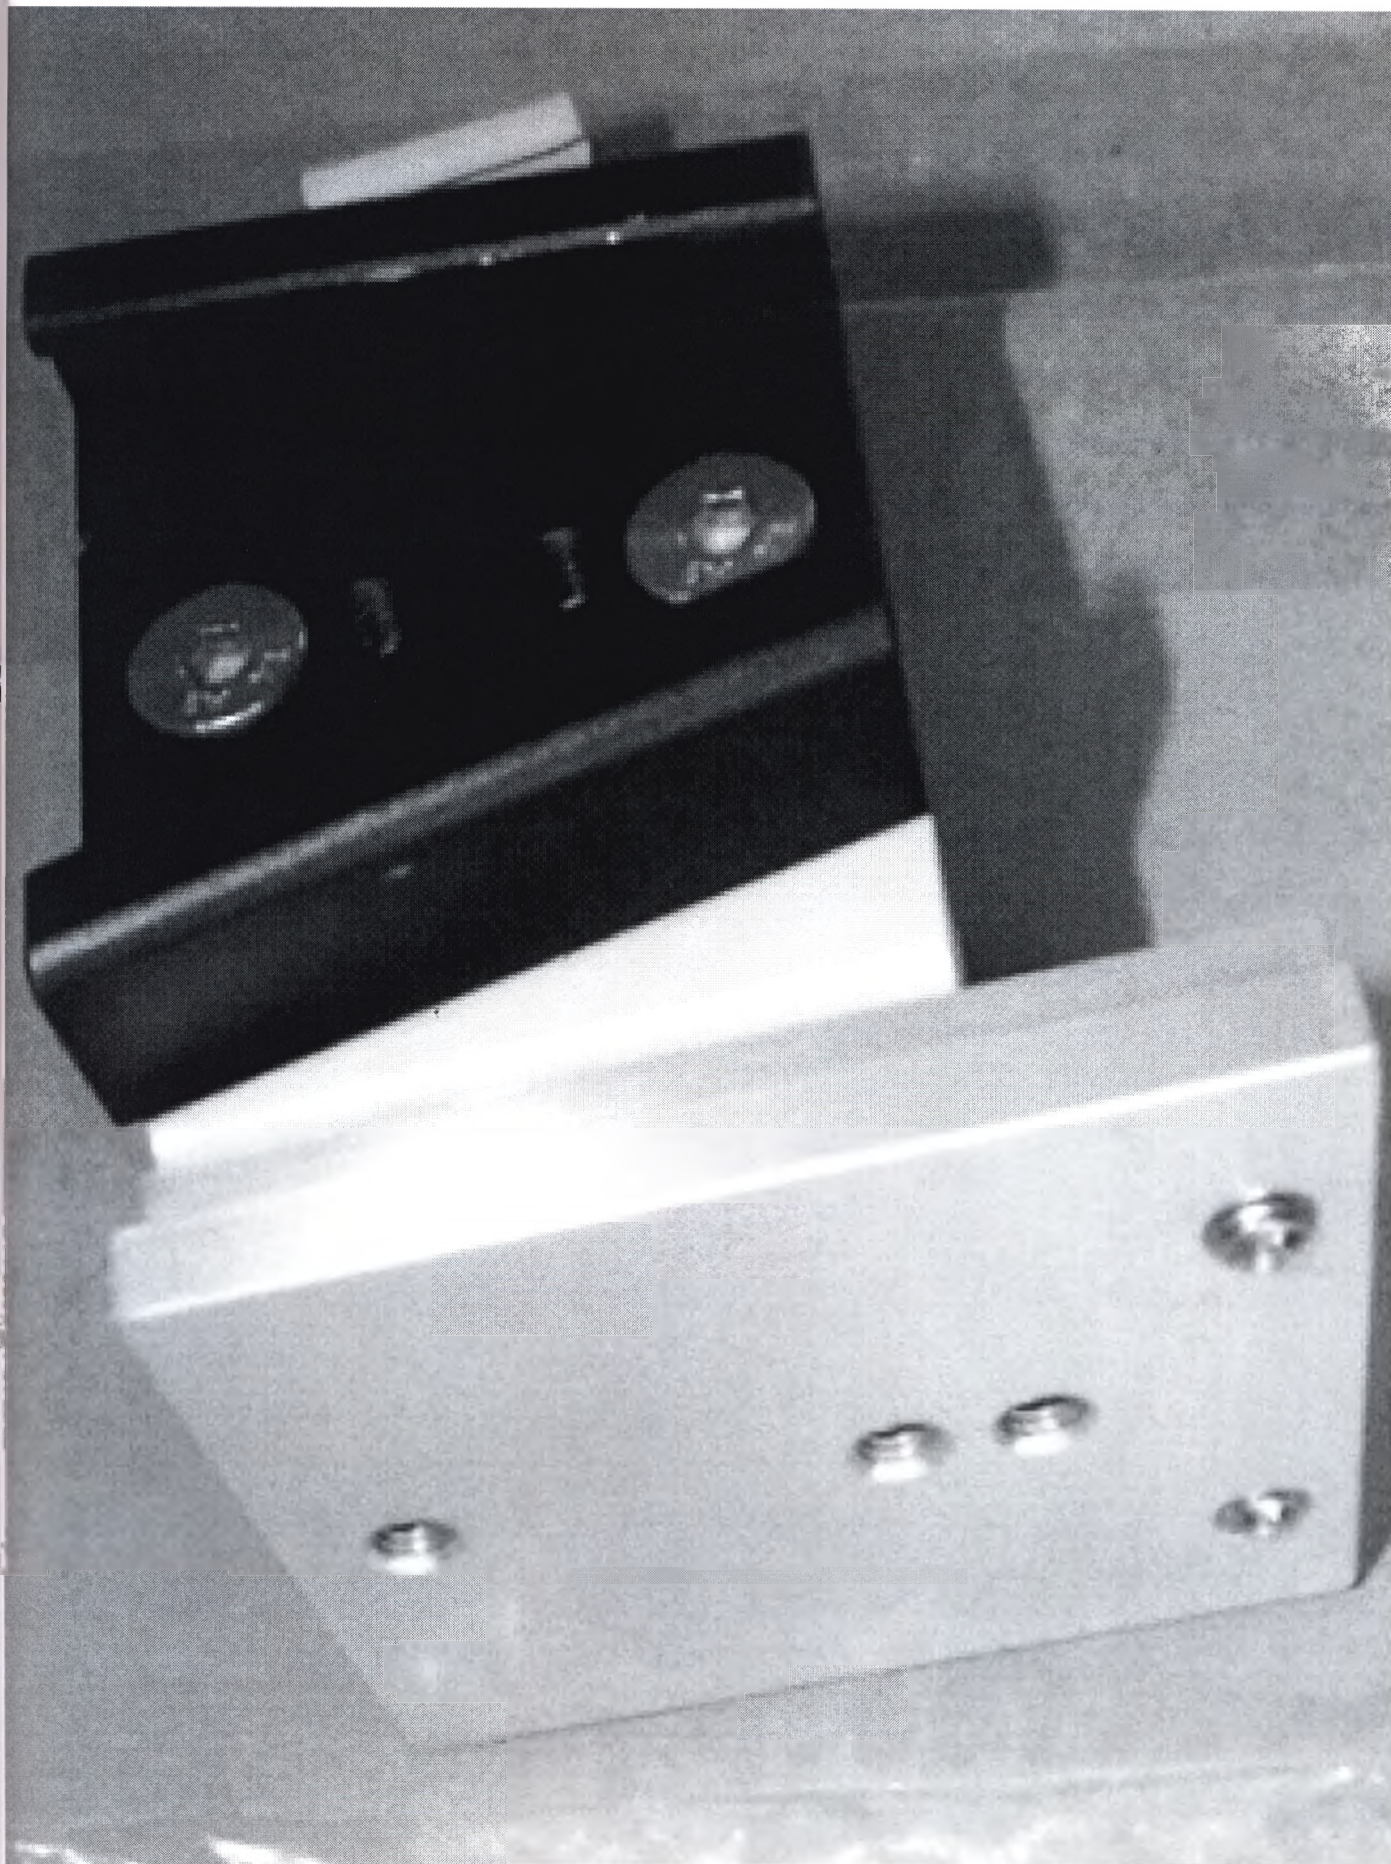


Аспиратор (с емкостью, крышкой емкости, трубками)


на фото – аспиратор с трубками

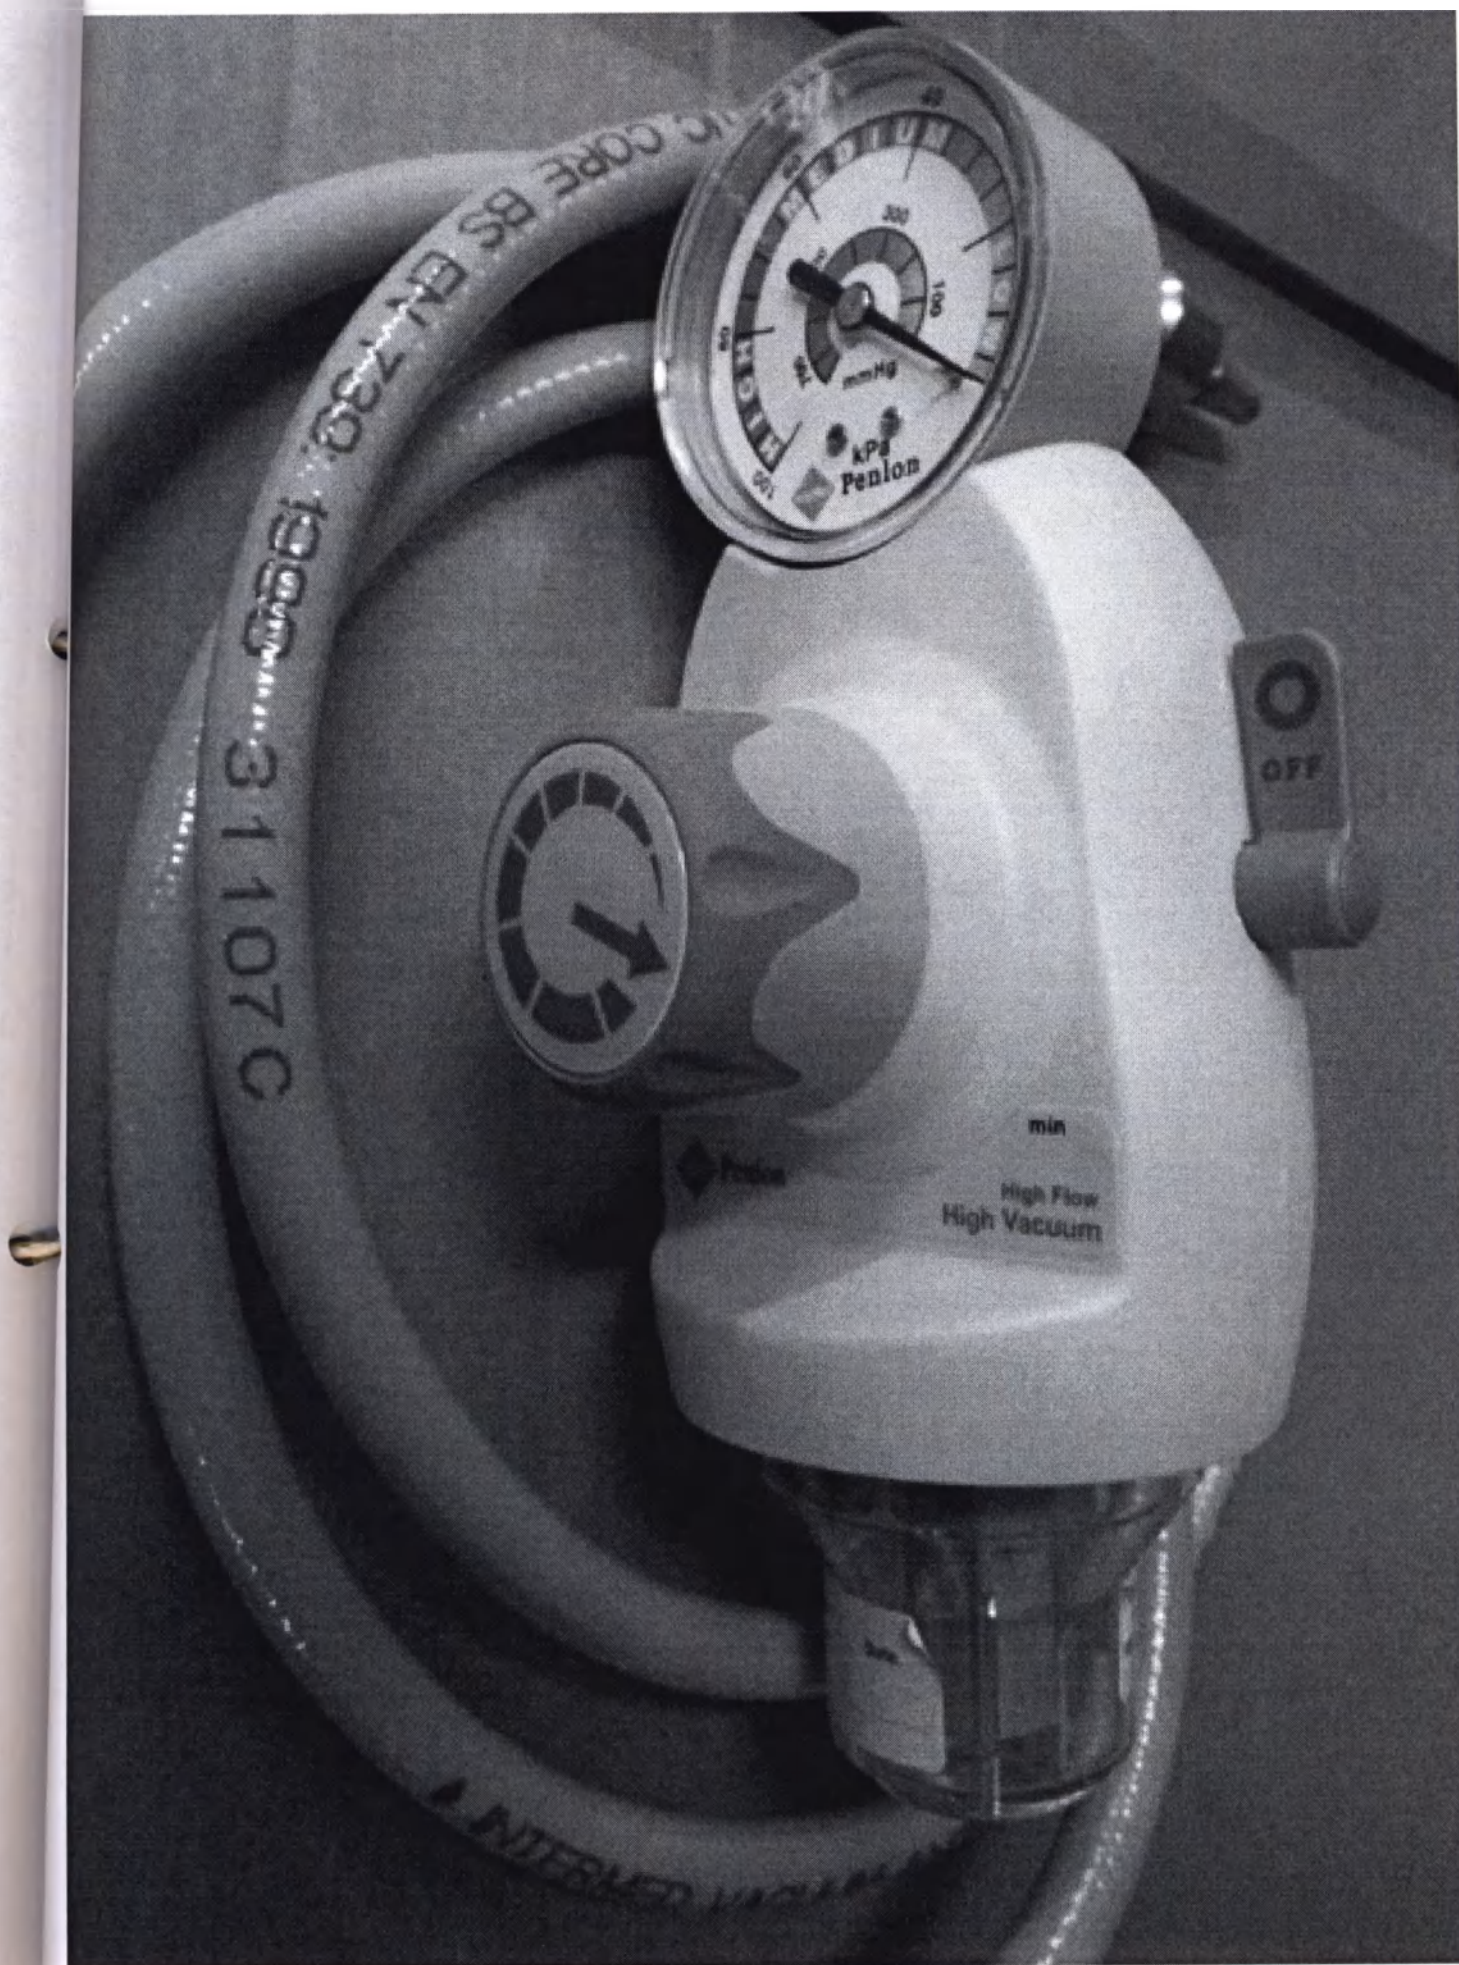

Аспиратор (с емкостью, крышкой емкости, трубками)


на фото – емкость с крышкой

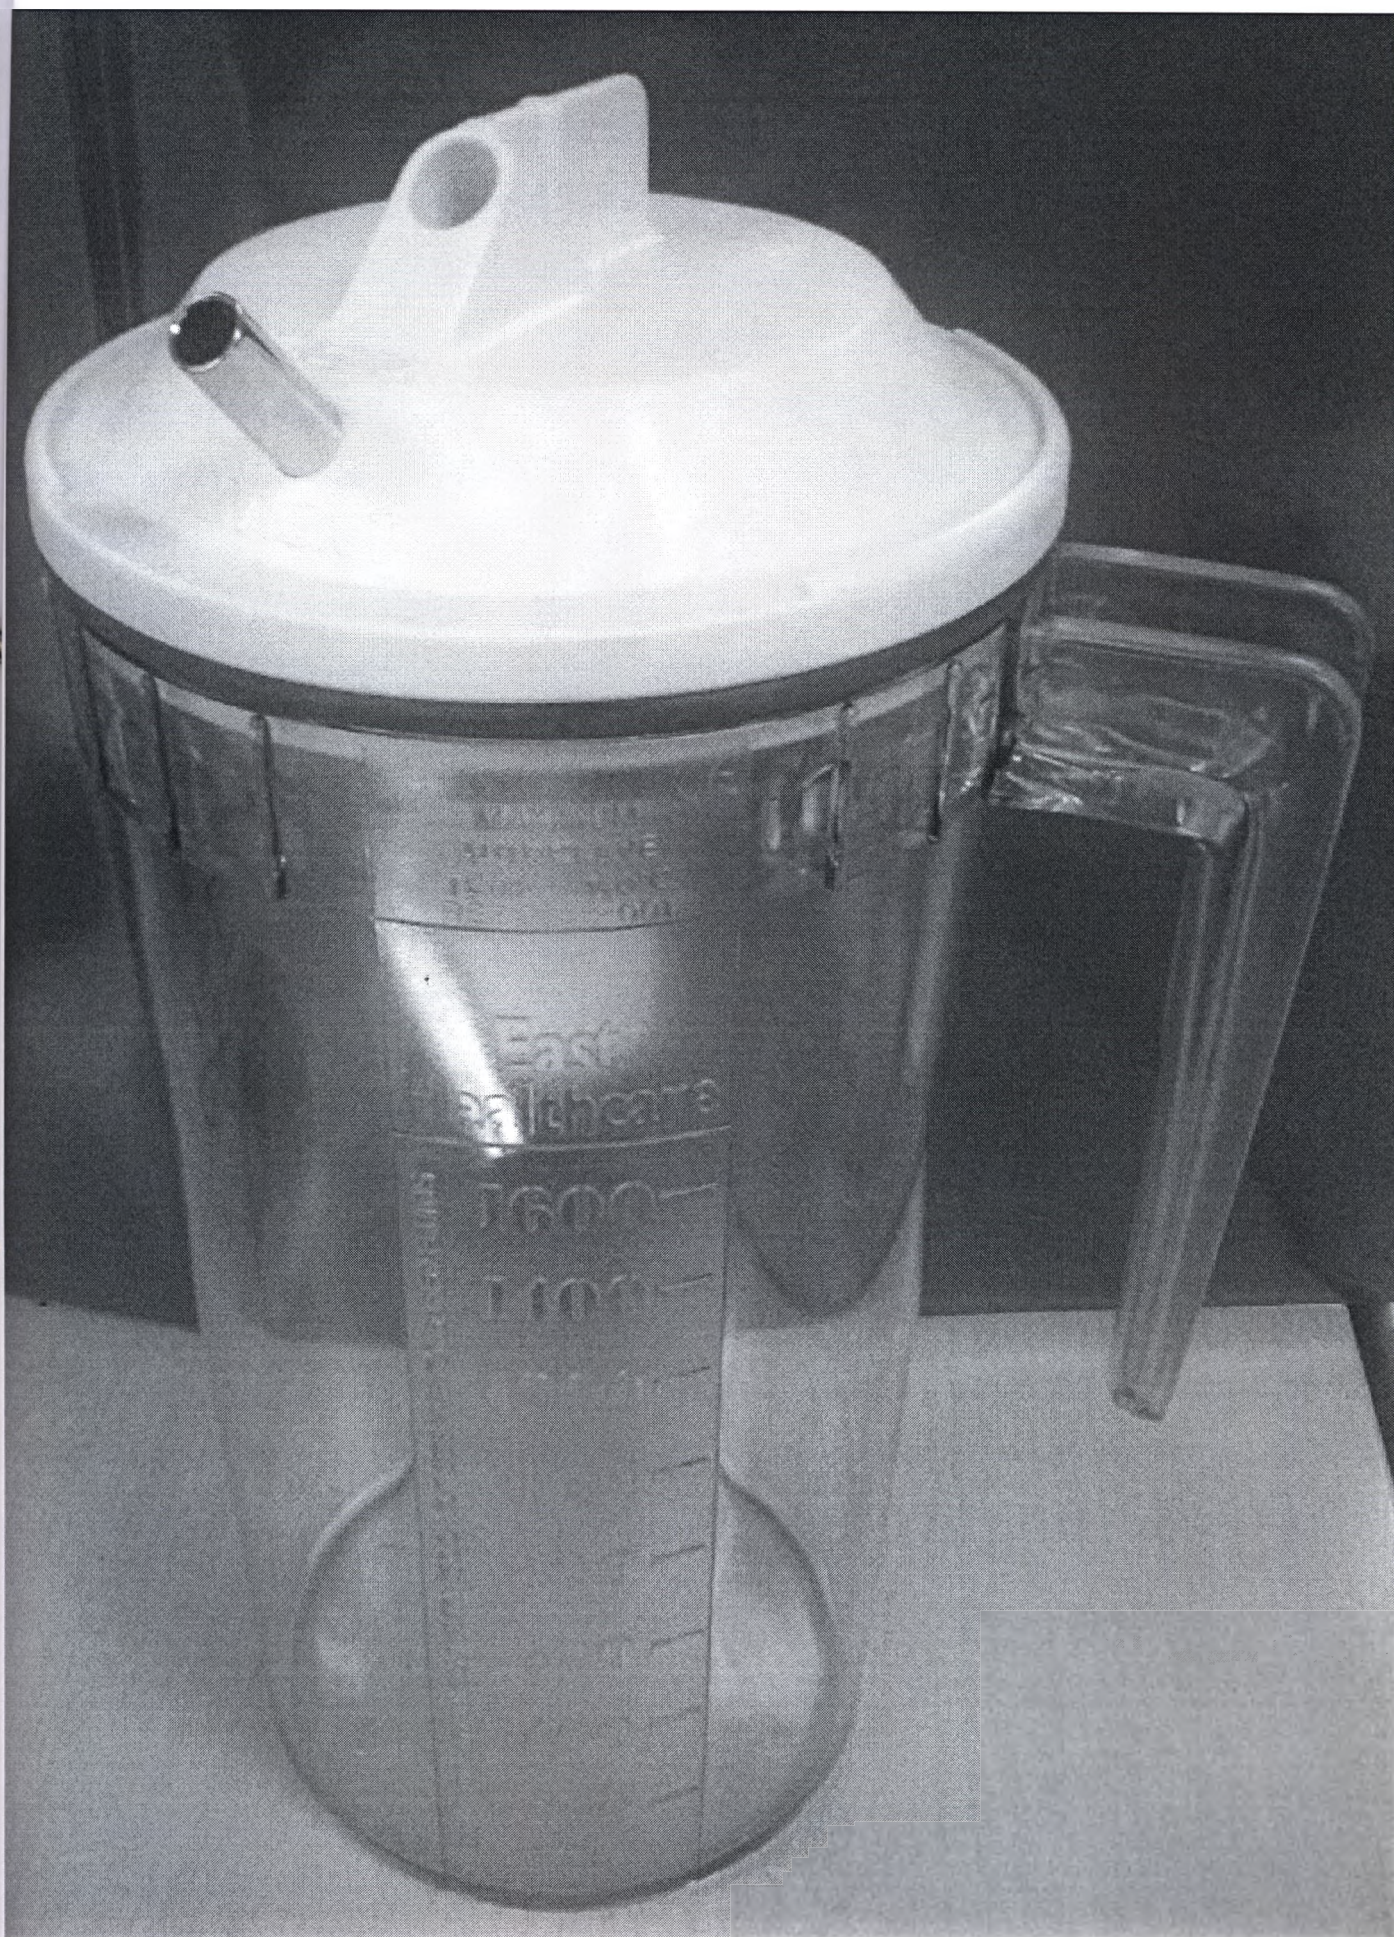


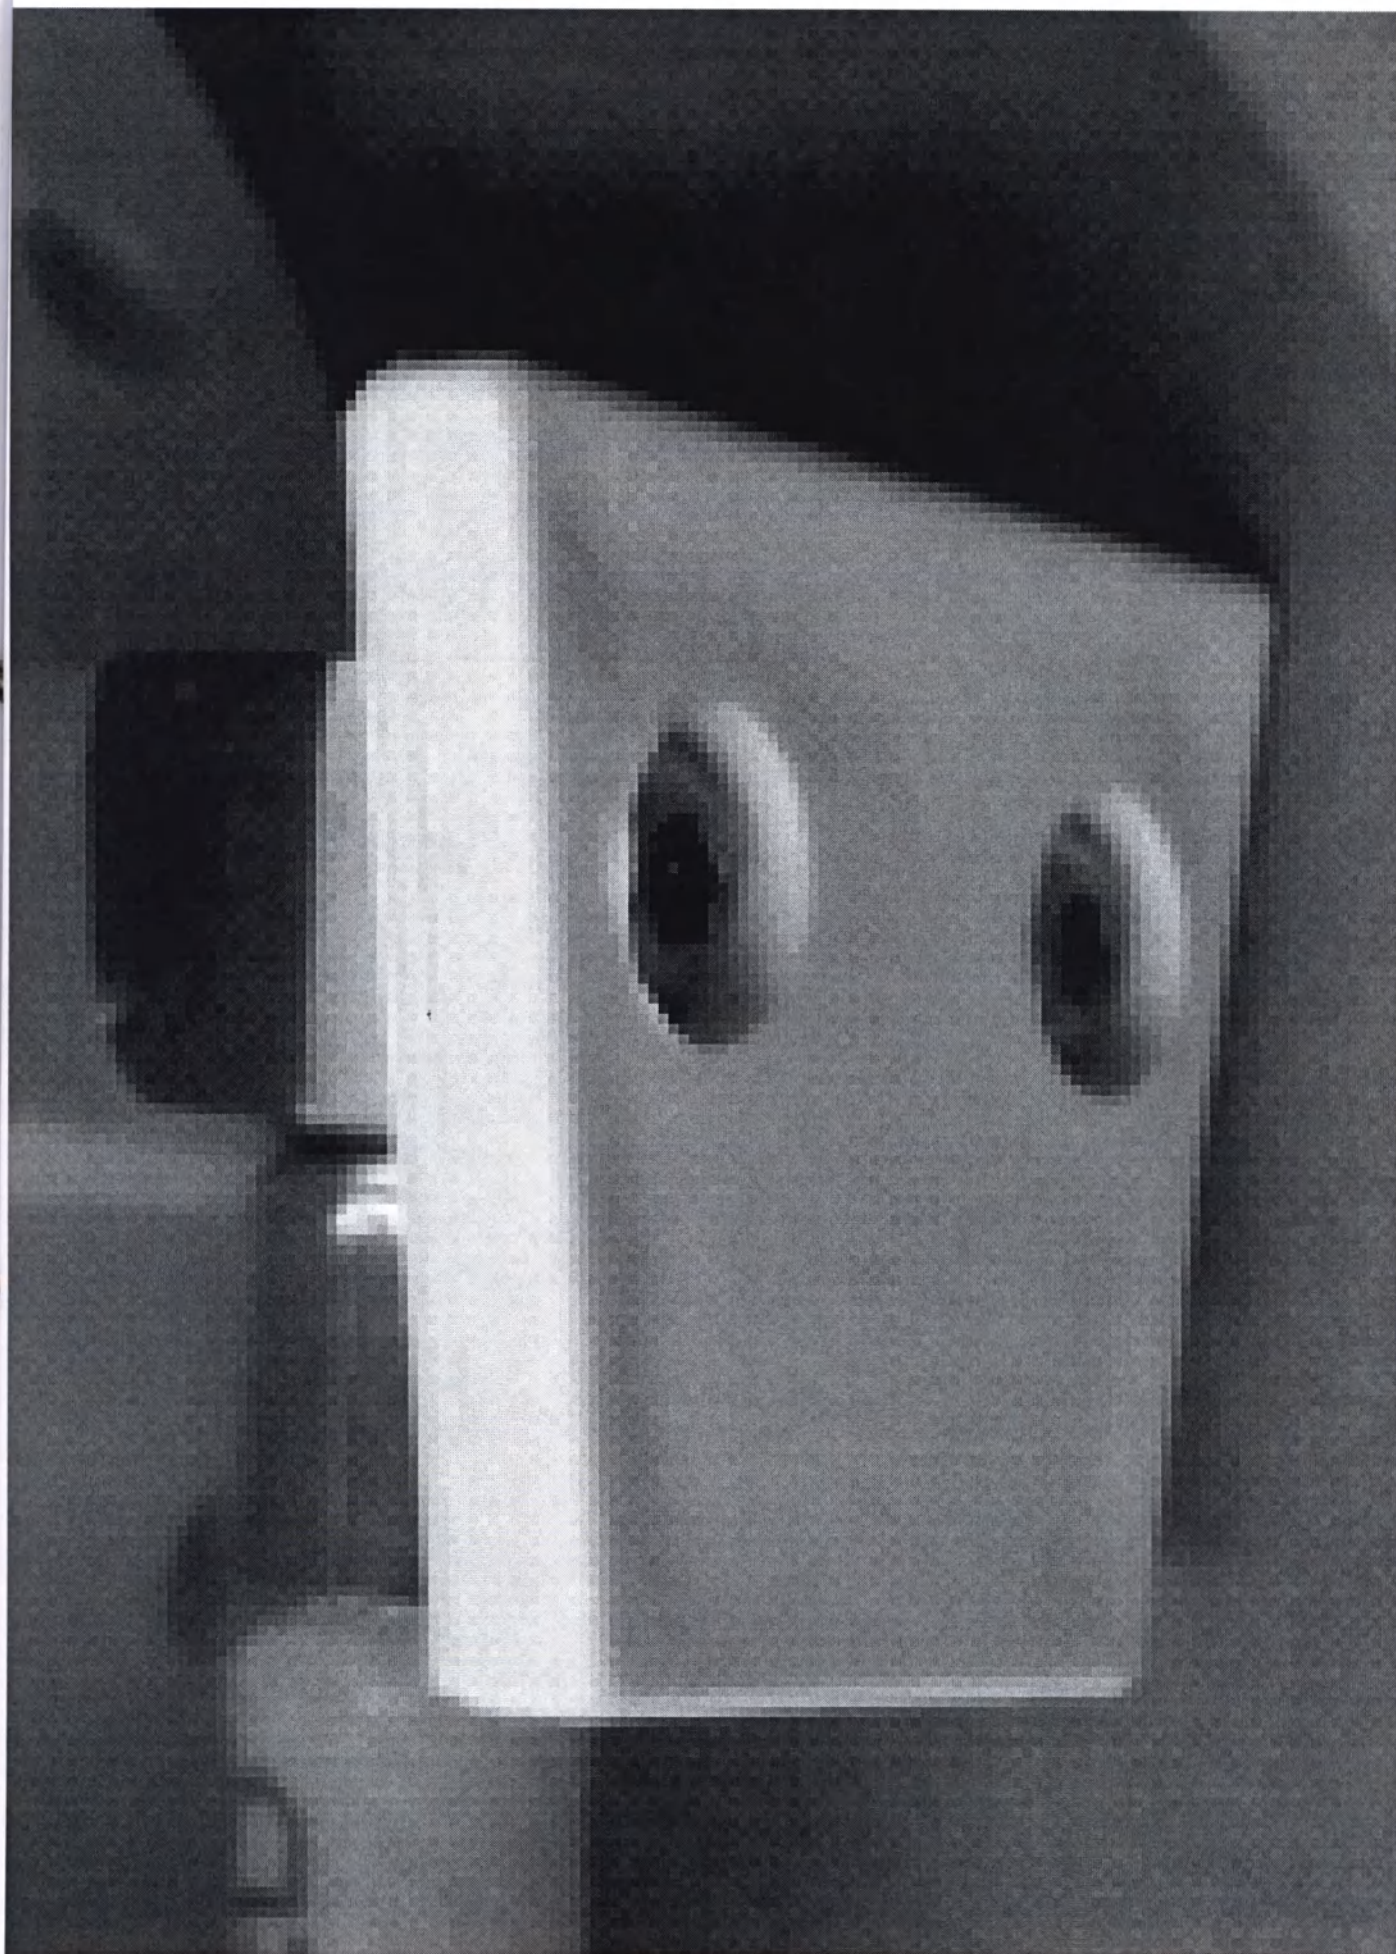





Система удаления наркотических газов (AGSS)

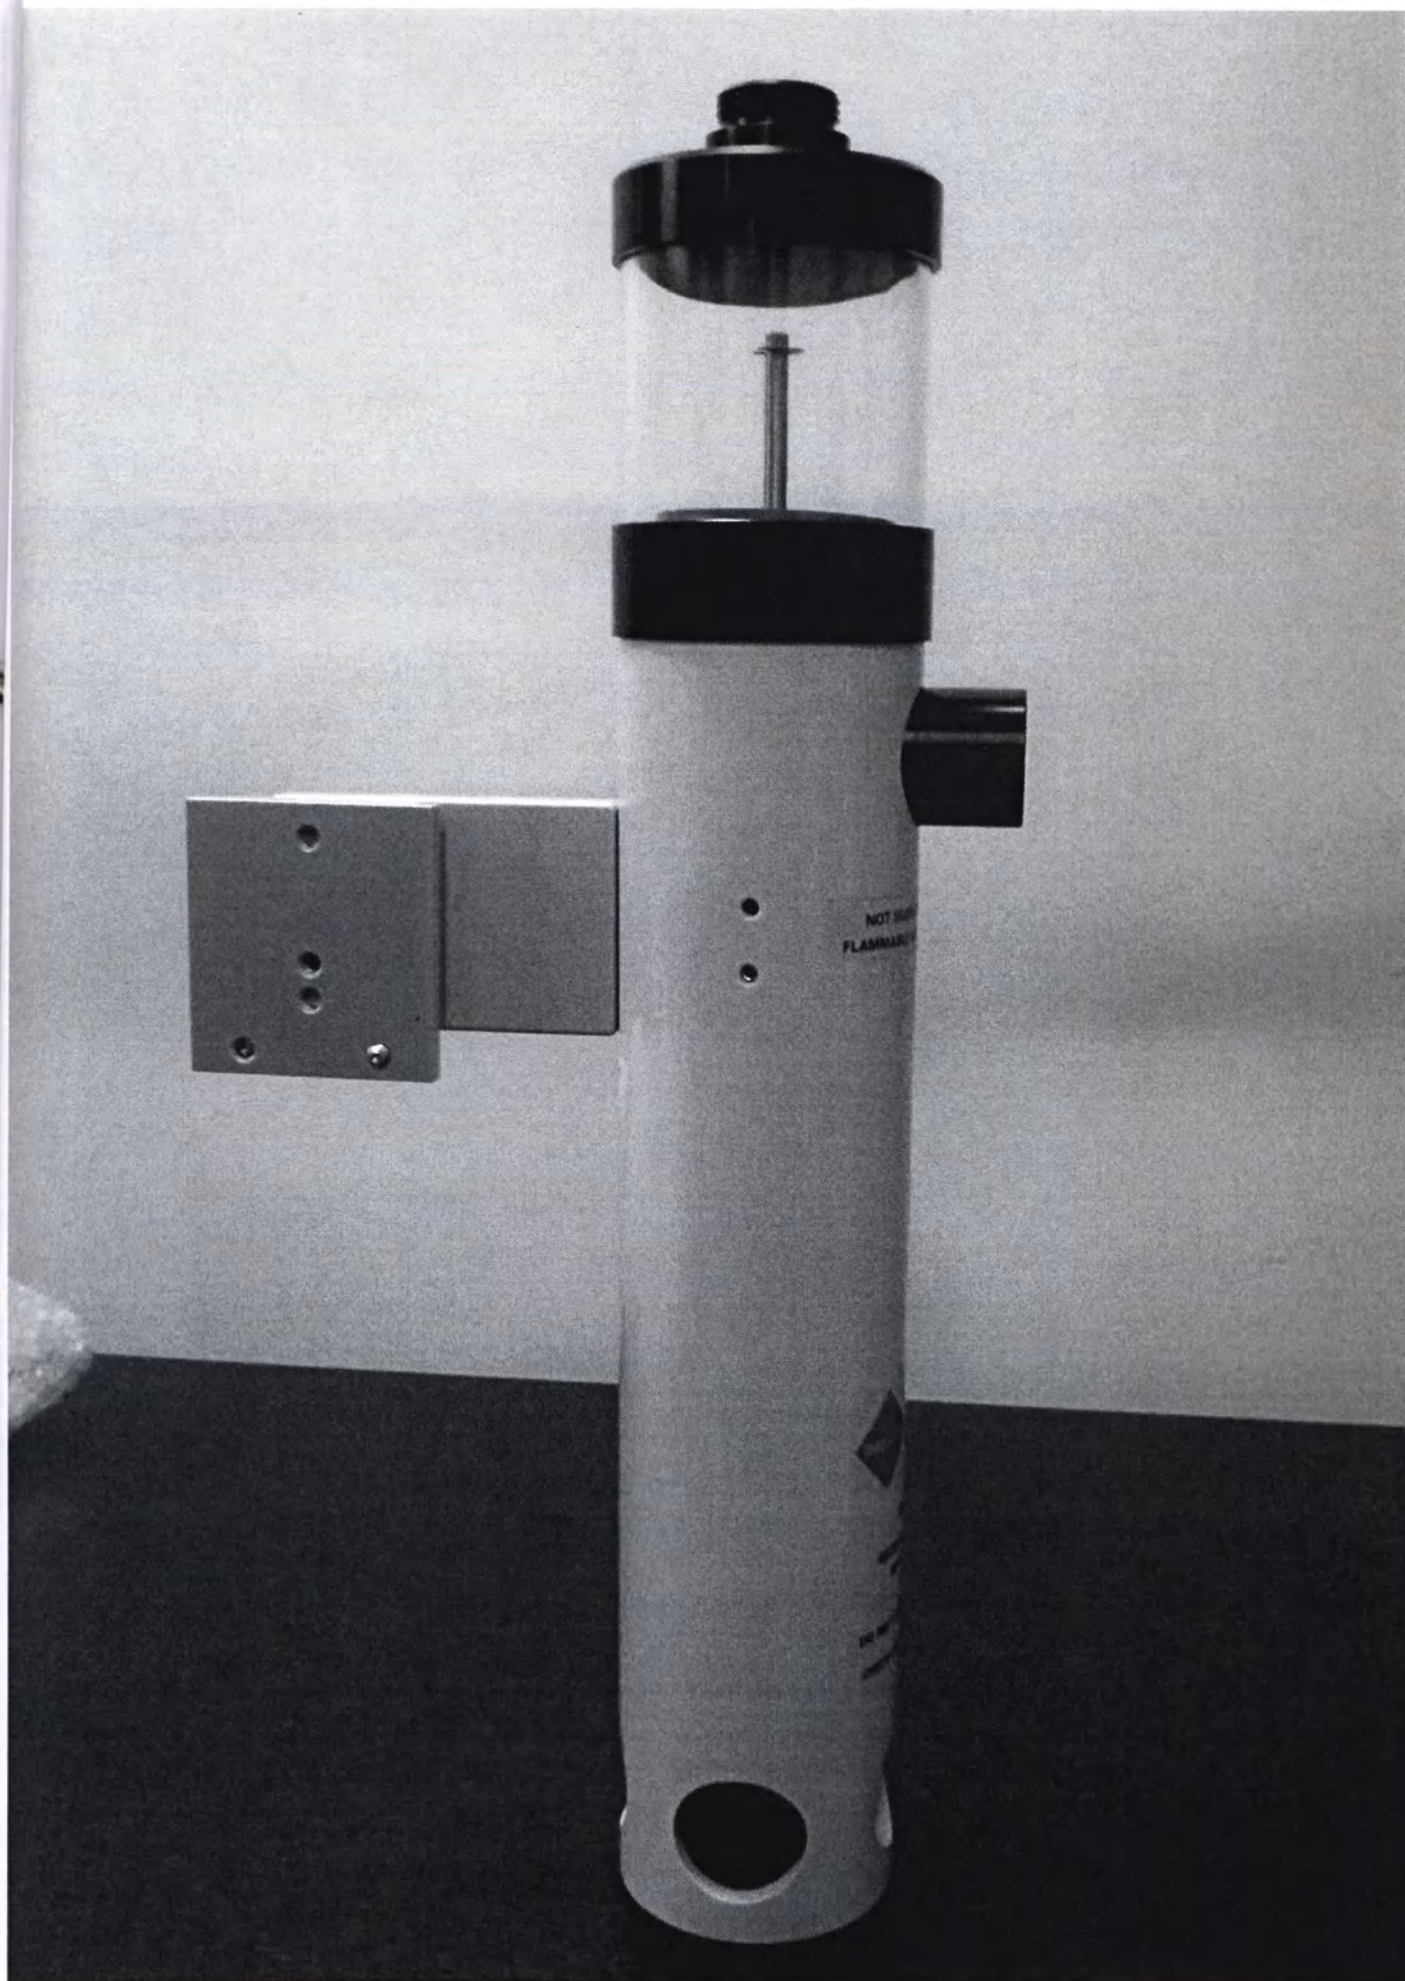

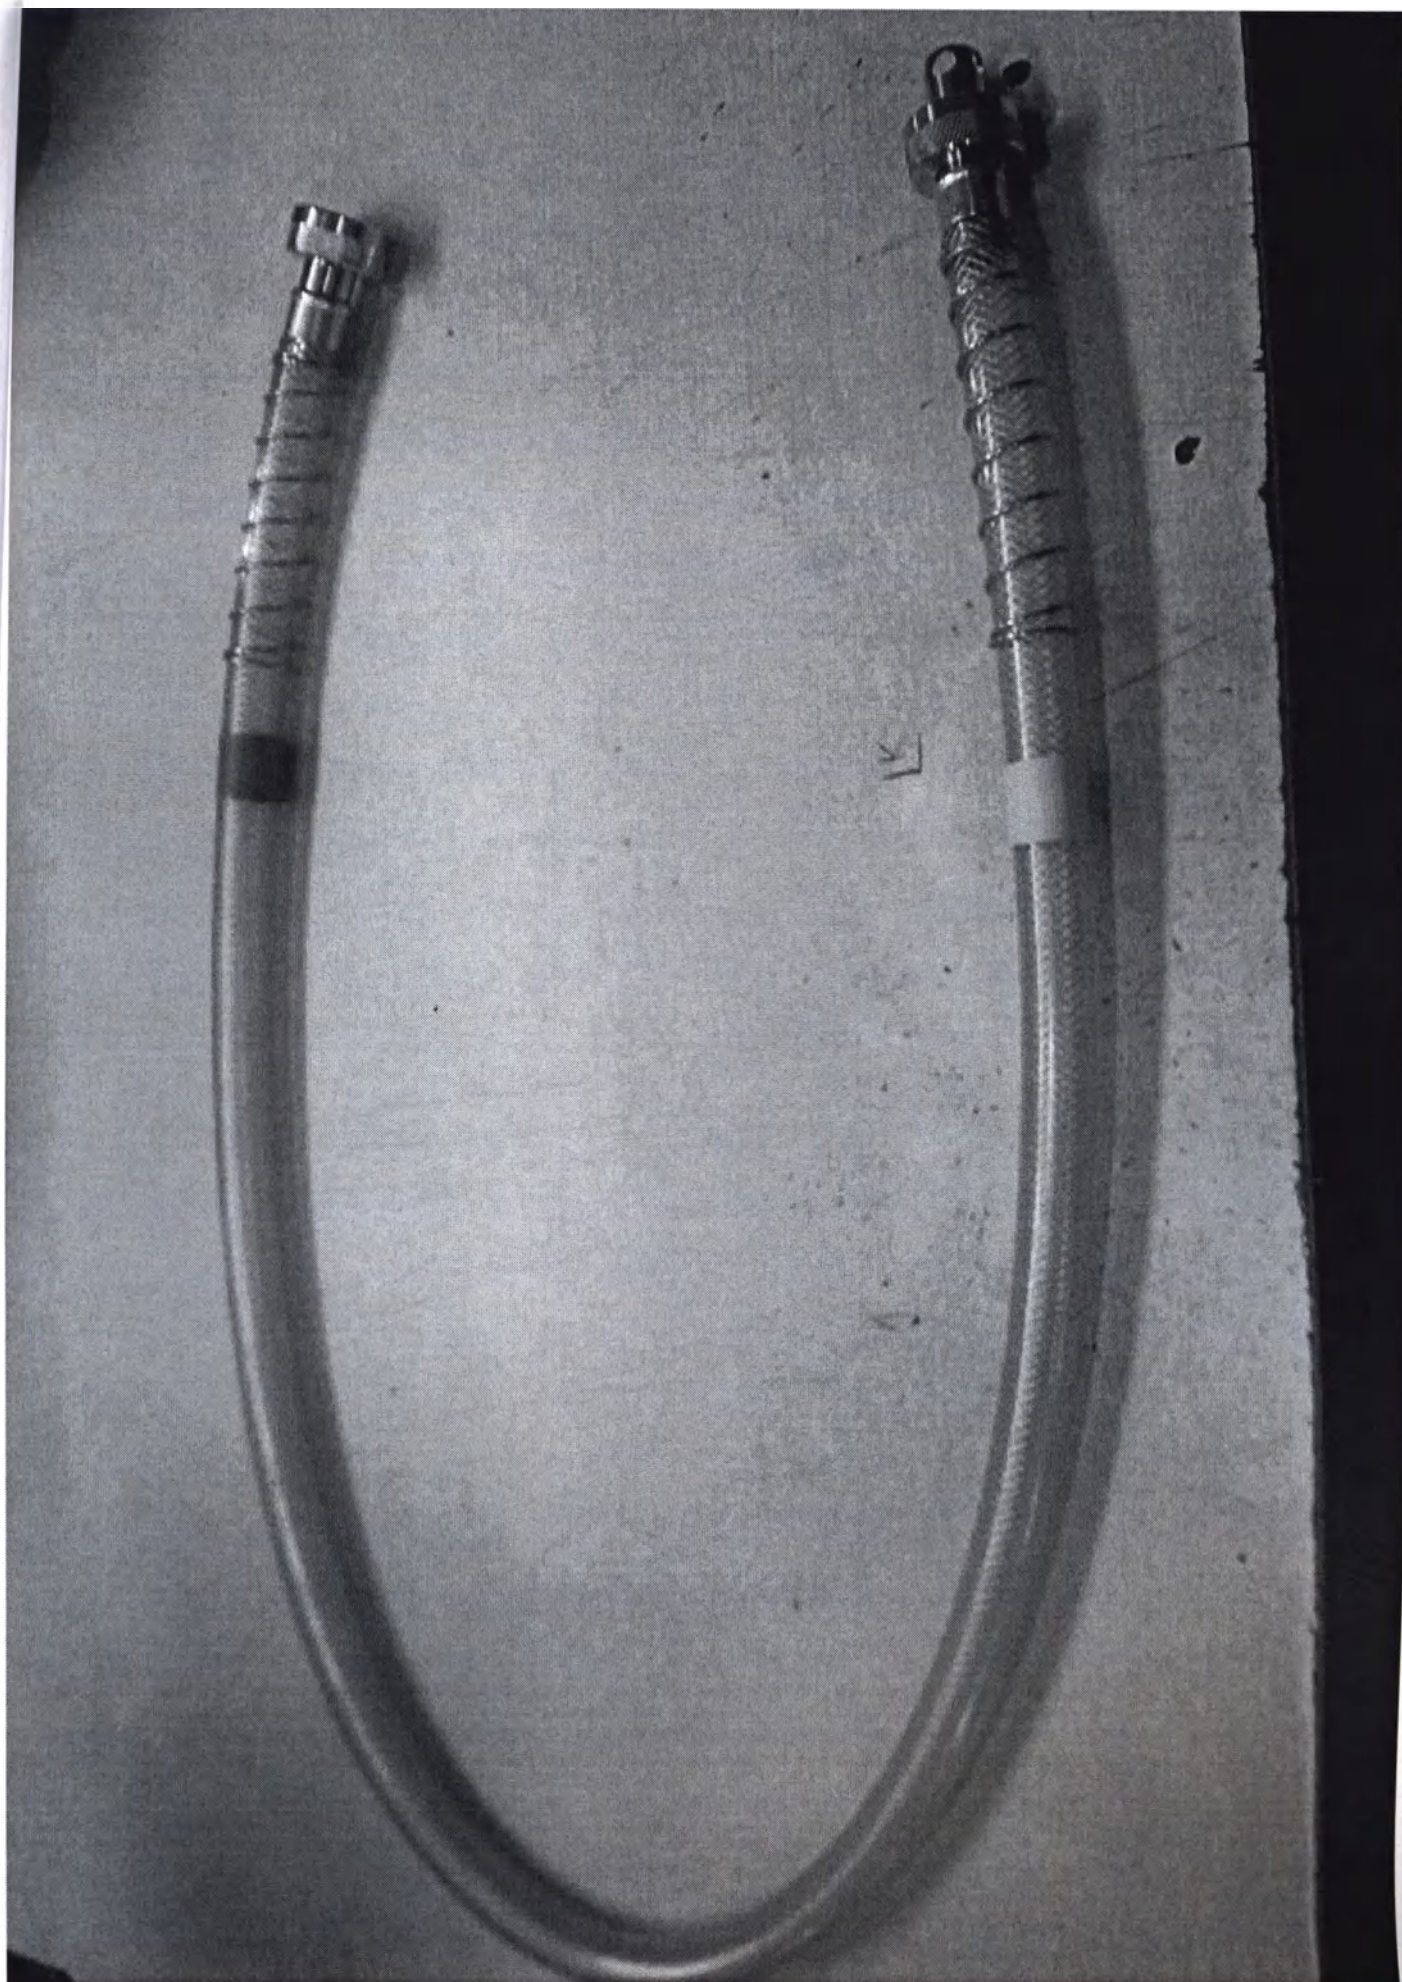

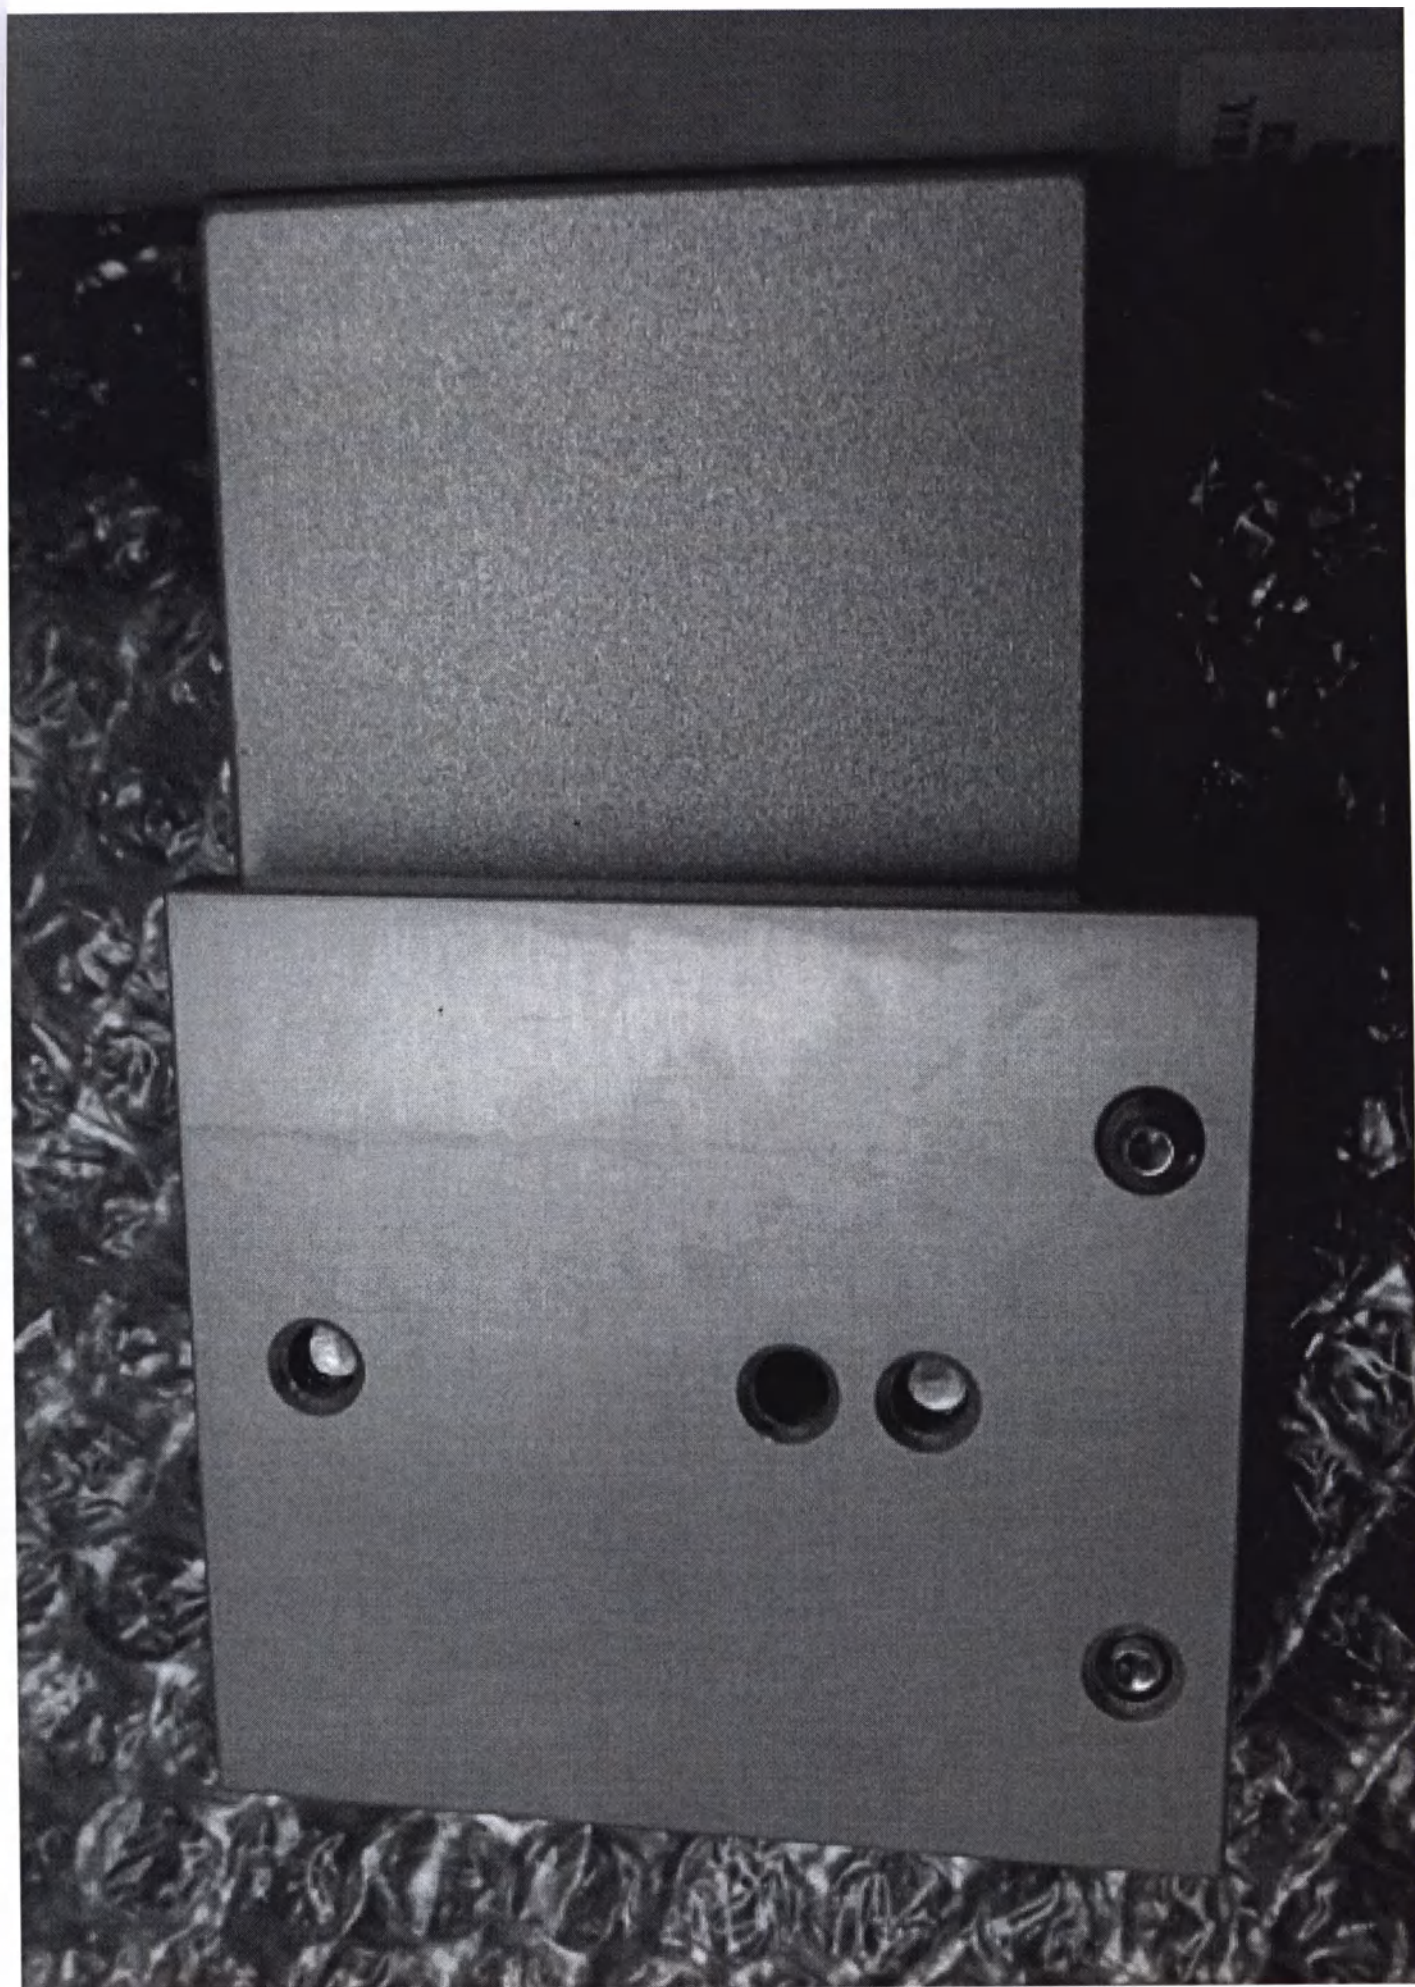

Фильтр

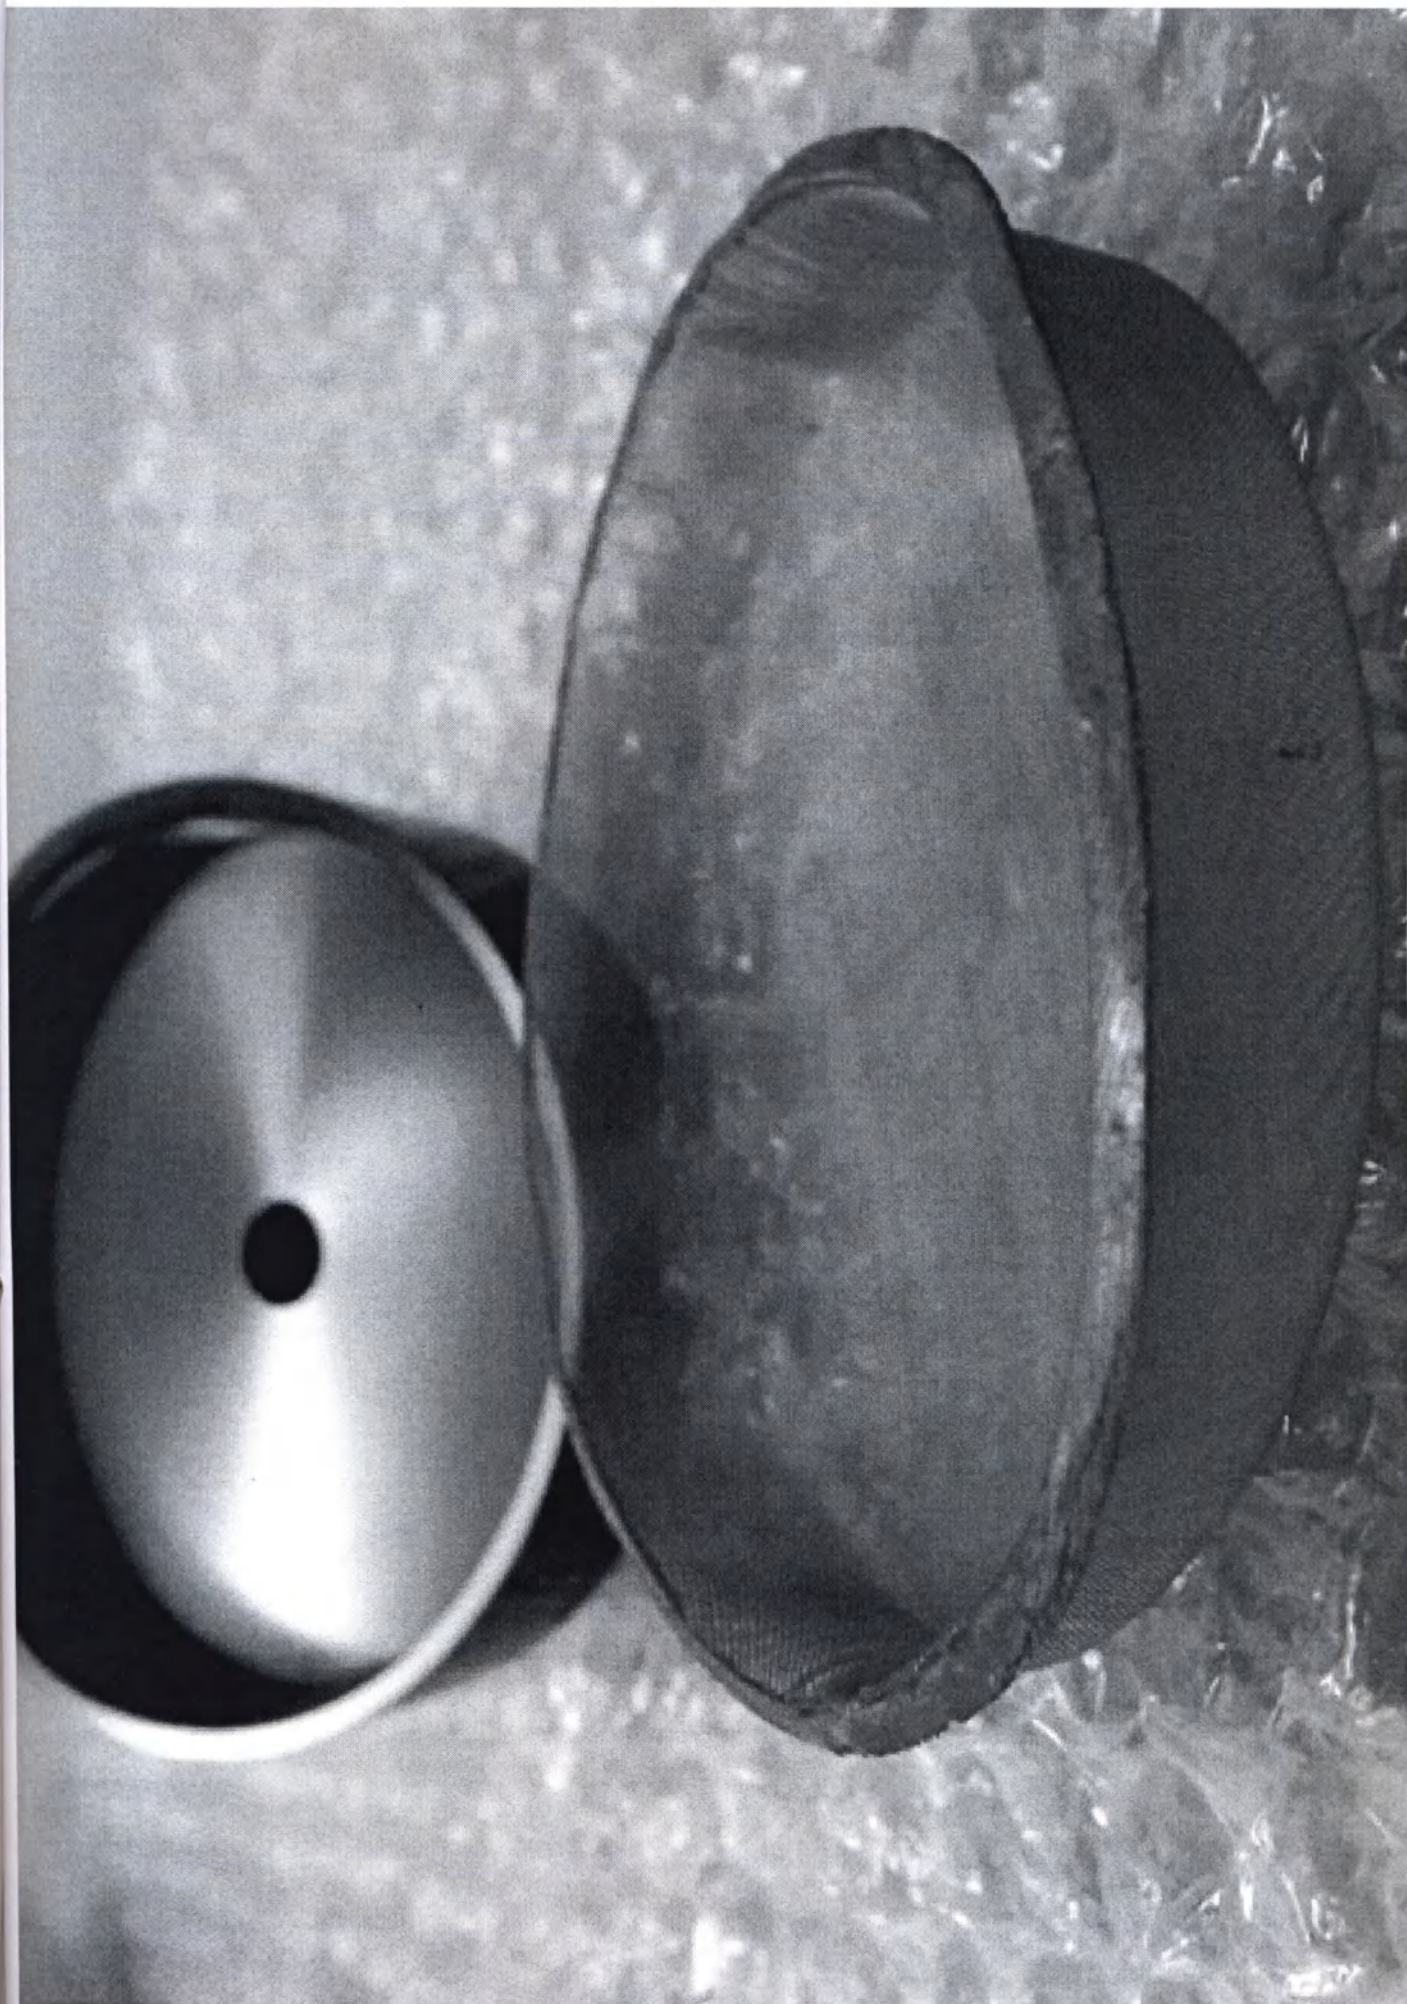





Челны



Леонова
Генеральный директор
Леонова Е. Б.
Прочитано 67 листов