


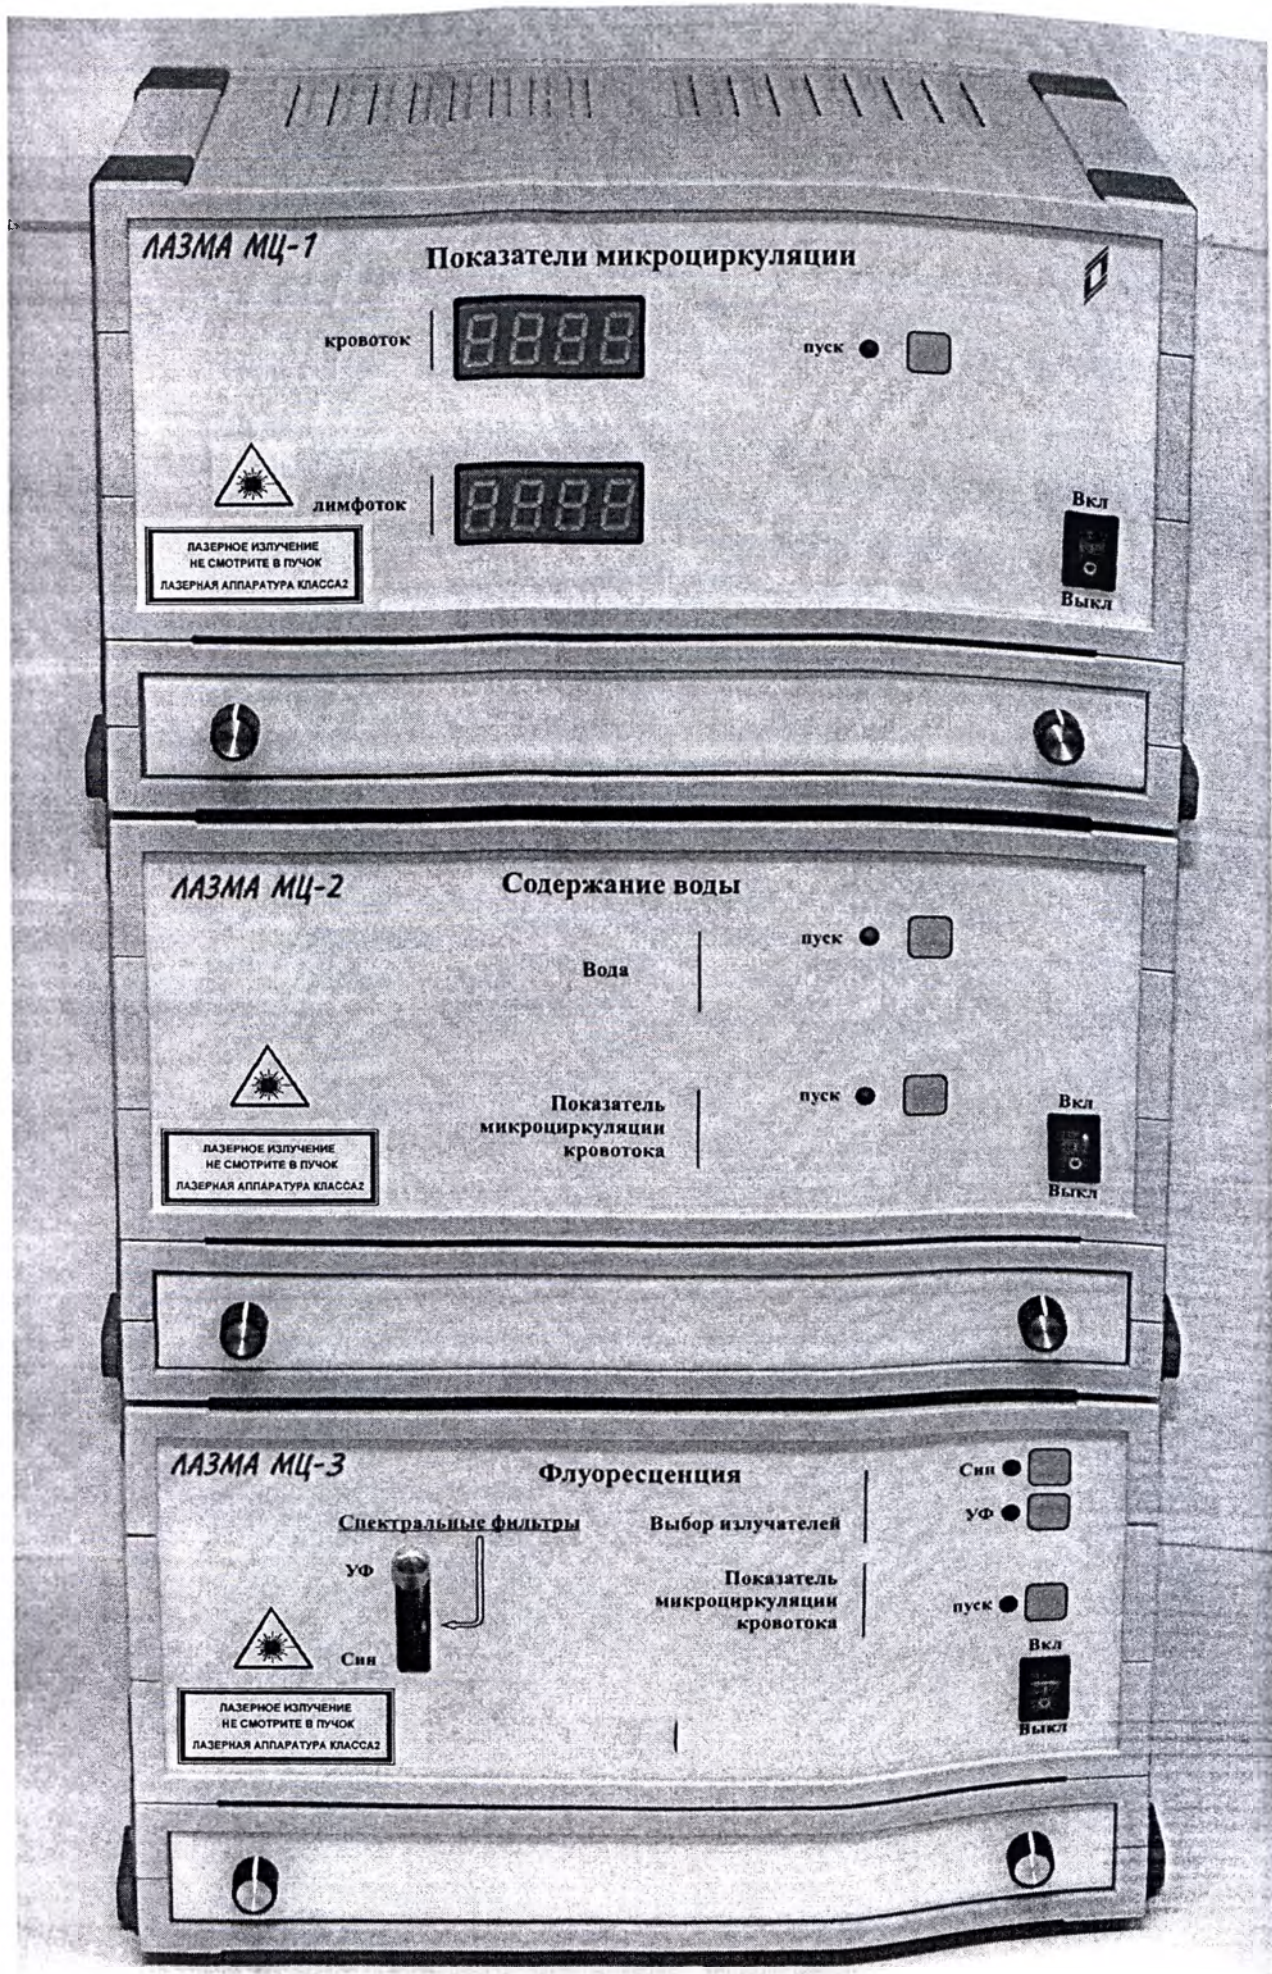

Комплекс лазерный диагностический «ЛАЗМА МЦ»

ООО НПП "ЛАЗМА" Комплекс лазерный диагностический "ЛАЗМА МЦ"

ТУ 9442-010-13232373-2015

Заводской номер: 003

Дата выпуска: 15.12.2014

~198-242 В

50 Гц

100ВА




Лазерная аппаратура класса 2:

анализатор "ЛАЗМА МЦ-1": длины волн излучения 405 нм, 1064 нм;


анализатор "ЛАЗМА МЦ-2": длины волн излучения 532нм, 830нм, 960нм.

анализатор "ЛАЗМА МЦ-3": длины волн излучения 365нм, 450нм - максимальная мощность излучения 2,5мВт.

**ВИДИМОЕ И НЕВИДИМОЕ  
ЛАЗЕРНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ**

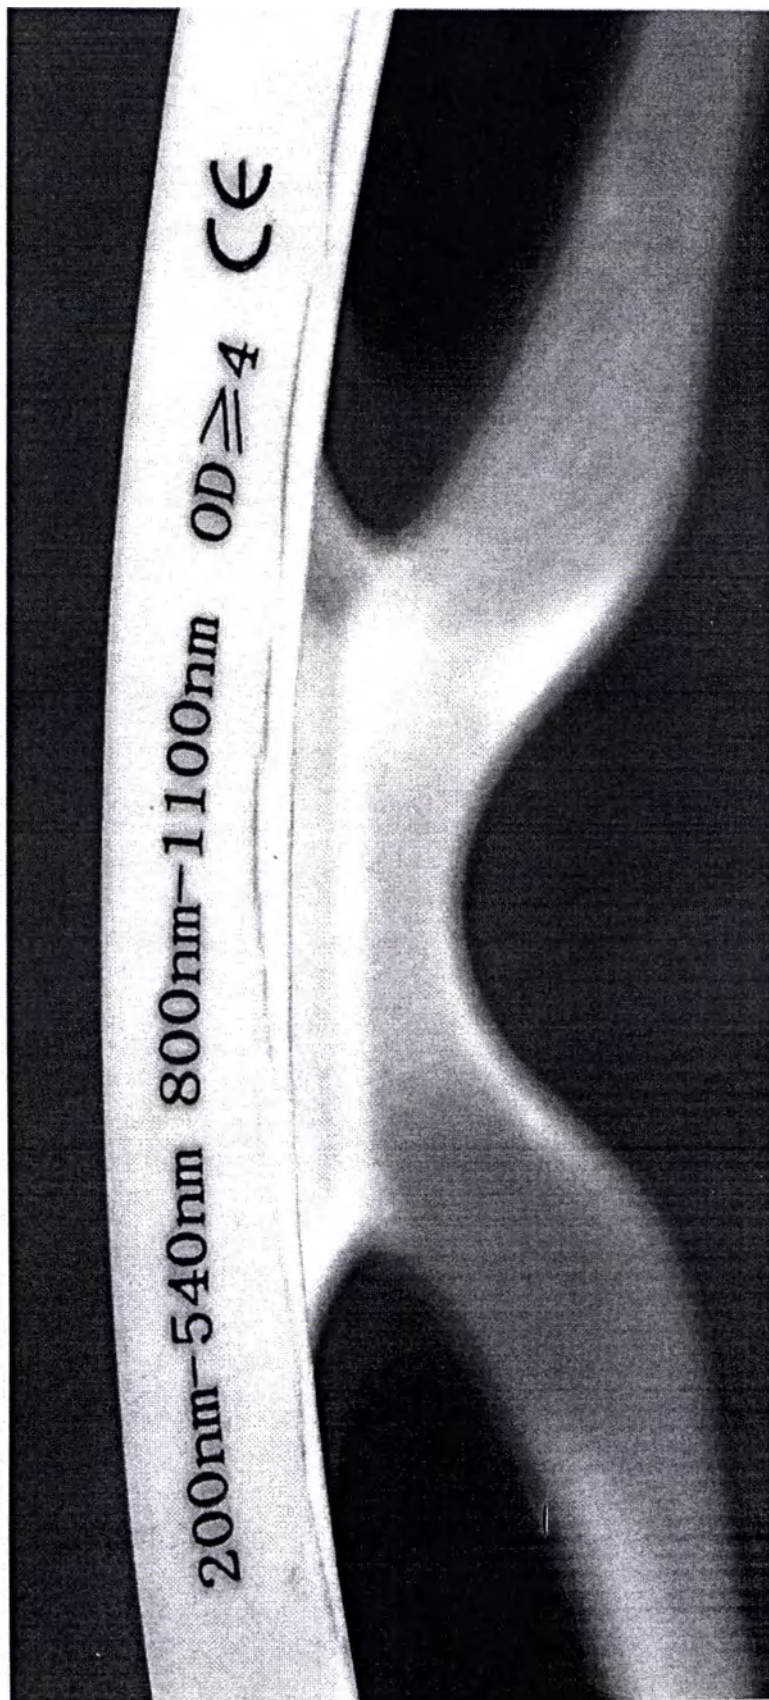

Защитные очки 315-1400 DL5

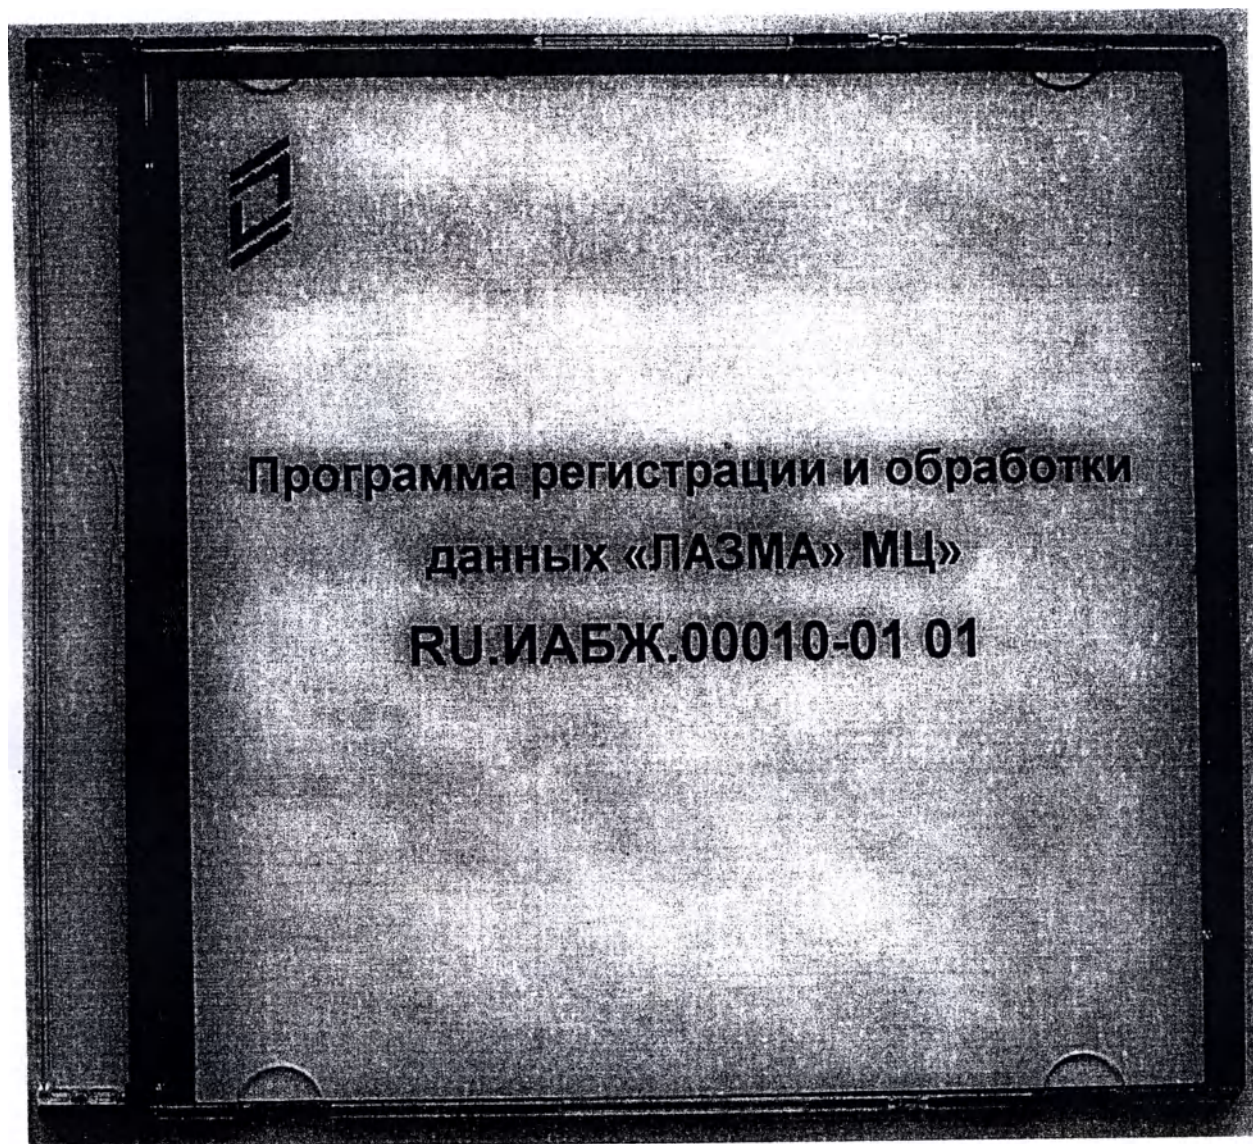

CD диск с программным обеспечением

Пронумеровано, прошнуровано  
скреплено печатью  
генеральный директор

Сидоров В. В.

