





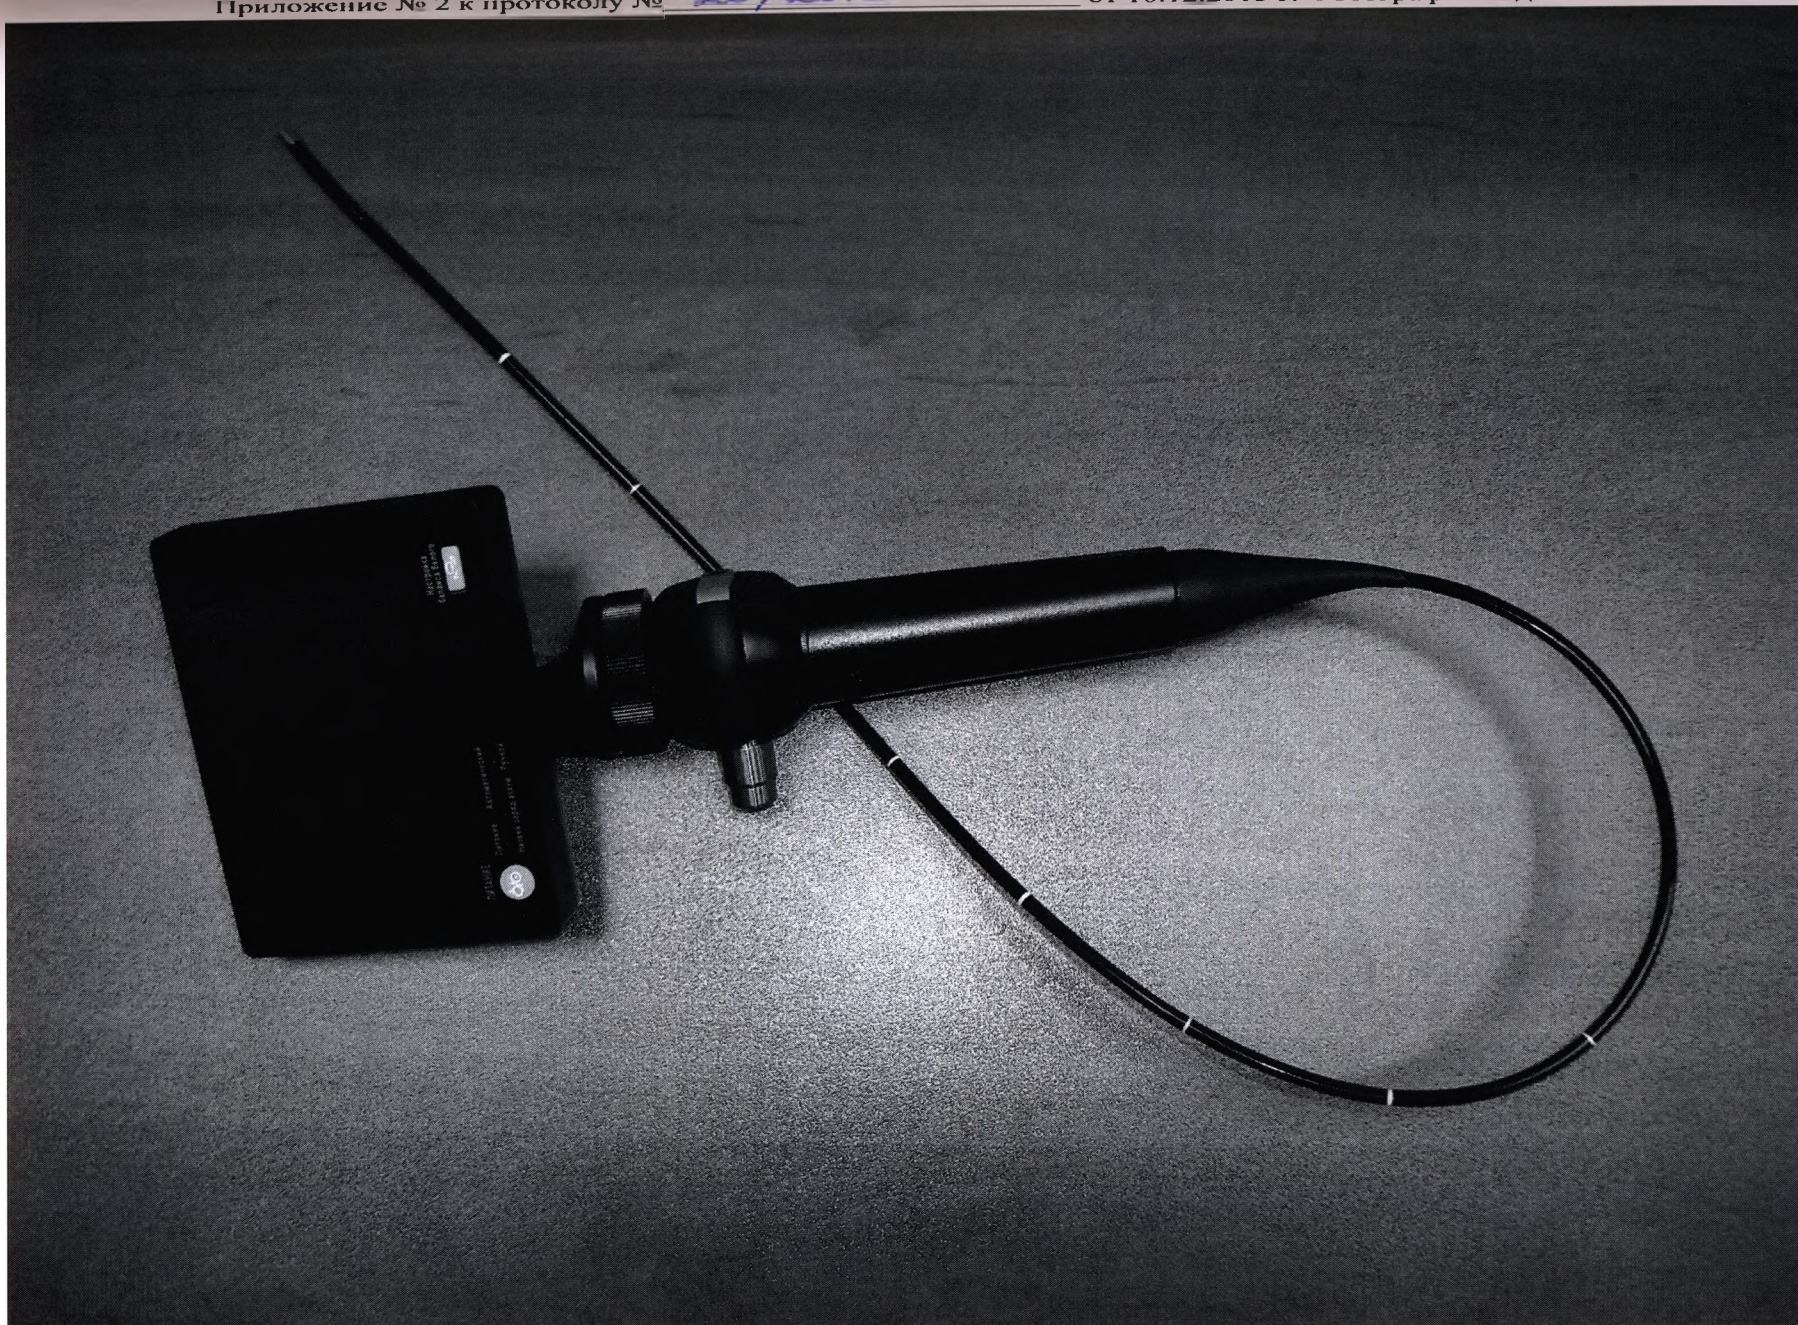

Интубоскоп А41 с монитором 4"

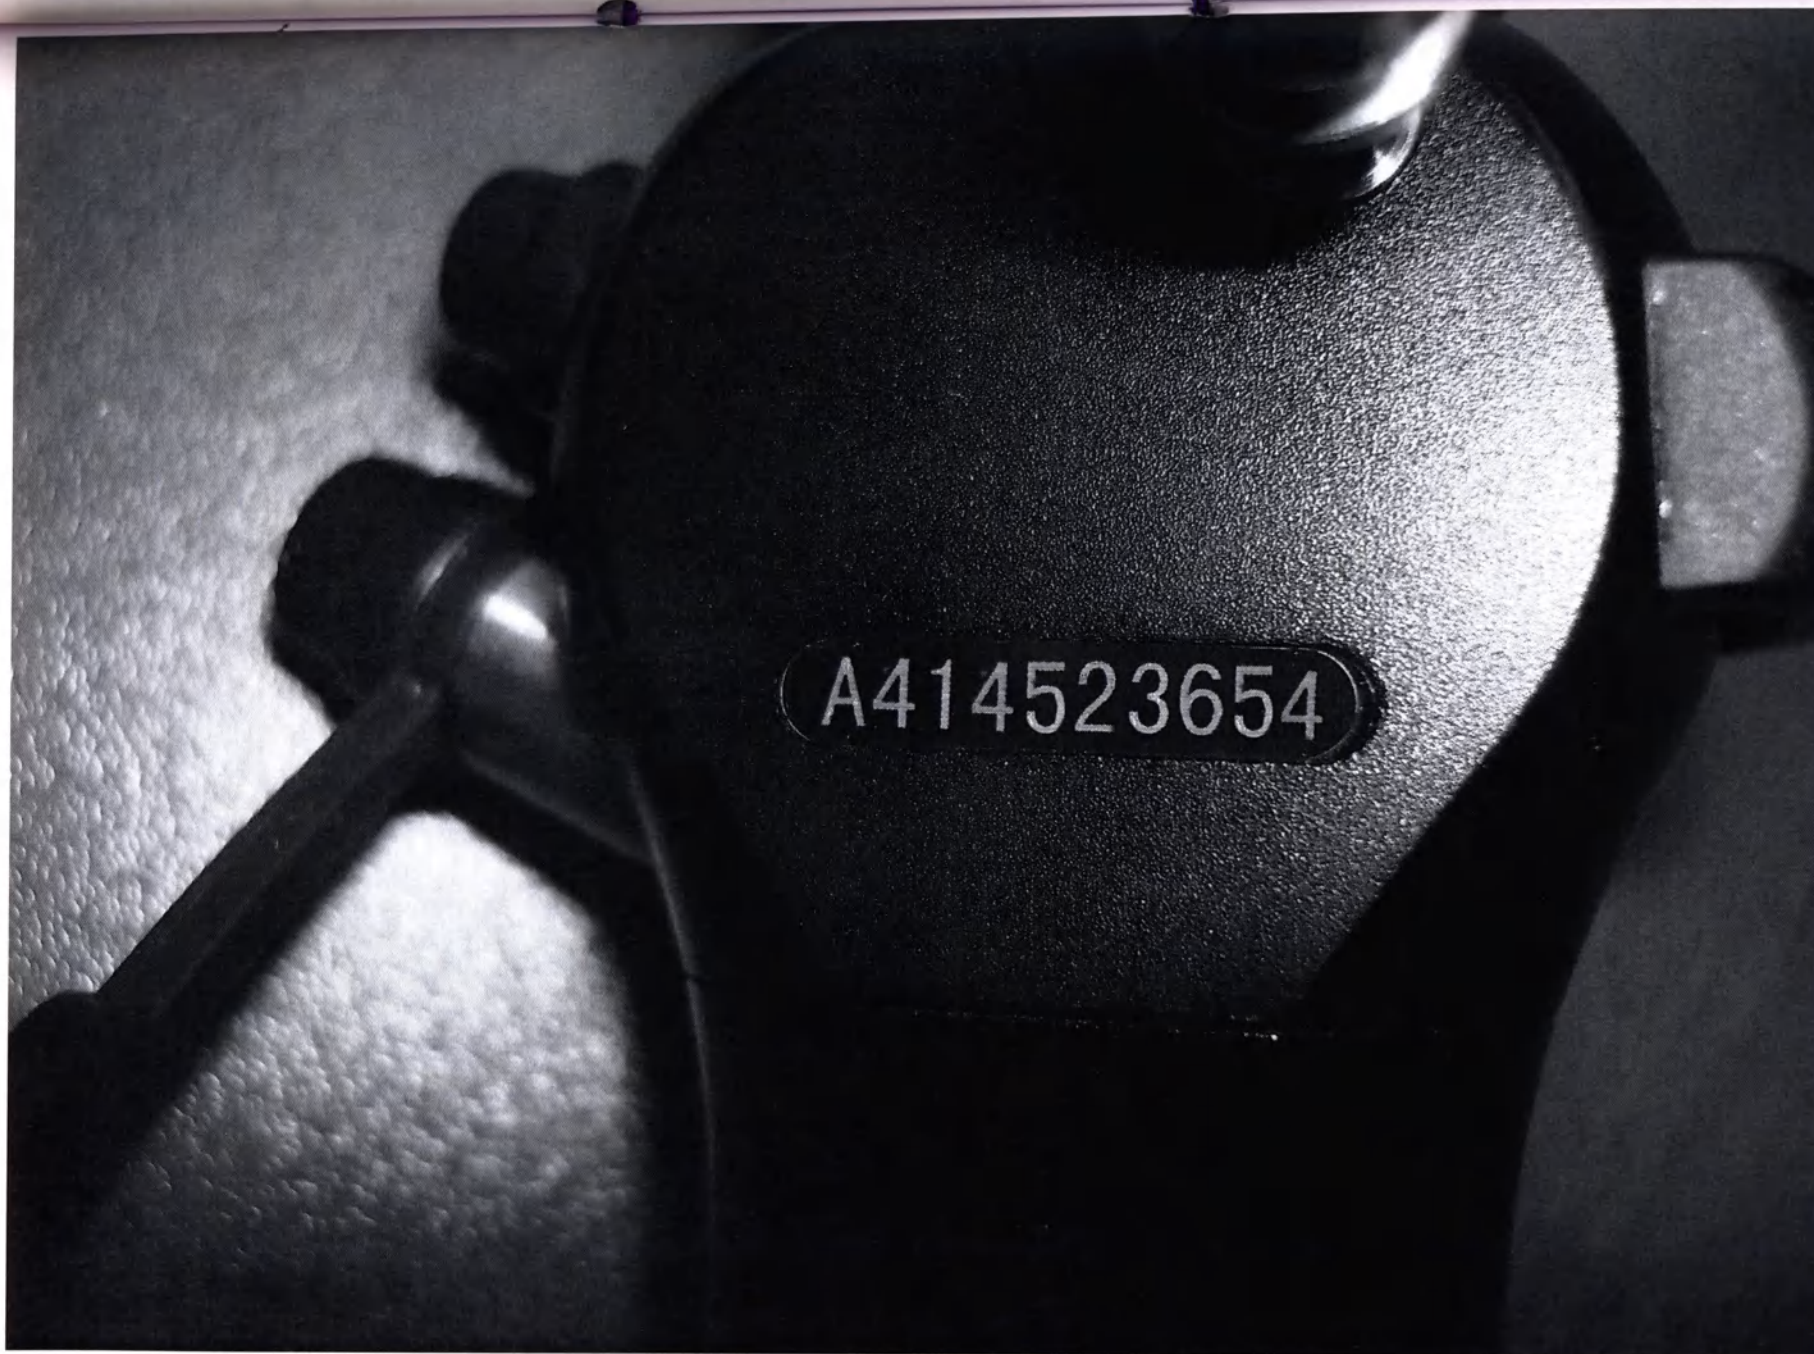

Маркировка Интубоскопа А41



Интубоскоп А10Н




Интубоскоп А10D




Интубоскоп А30




Интубоскоп А11

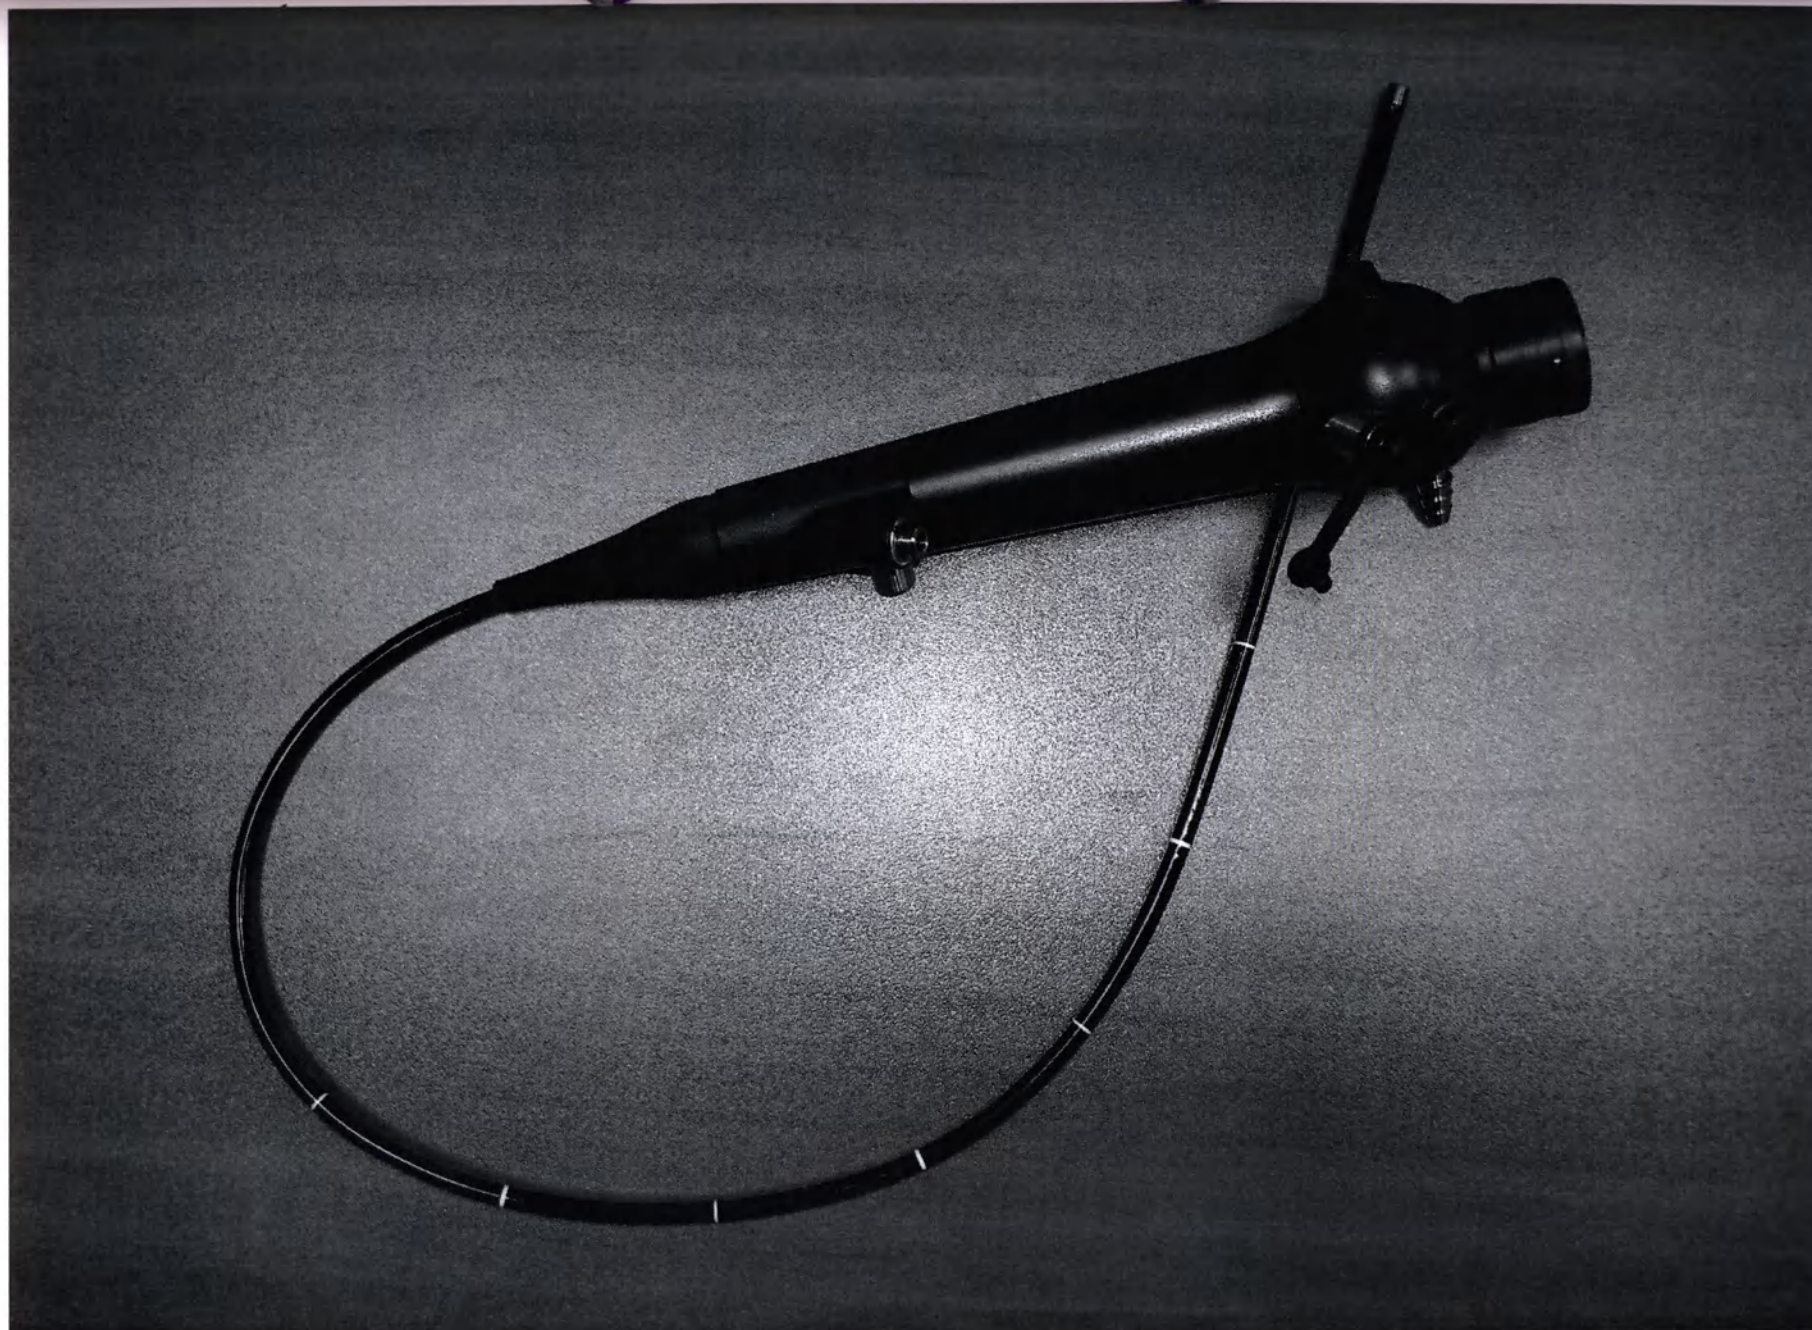

Интубоскоп А20

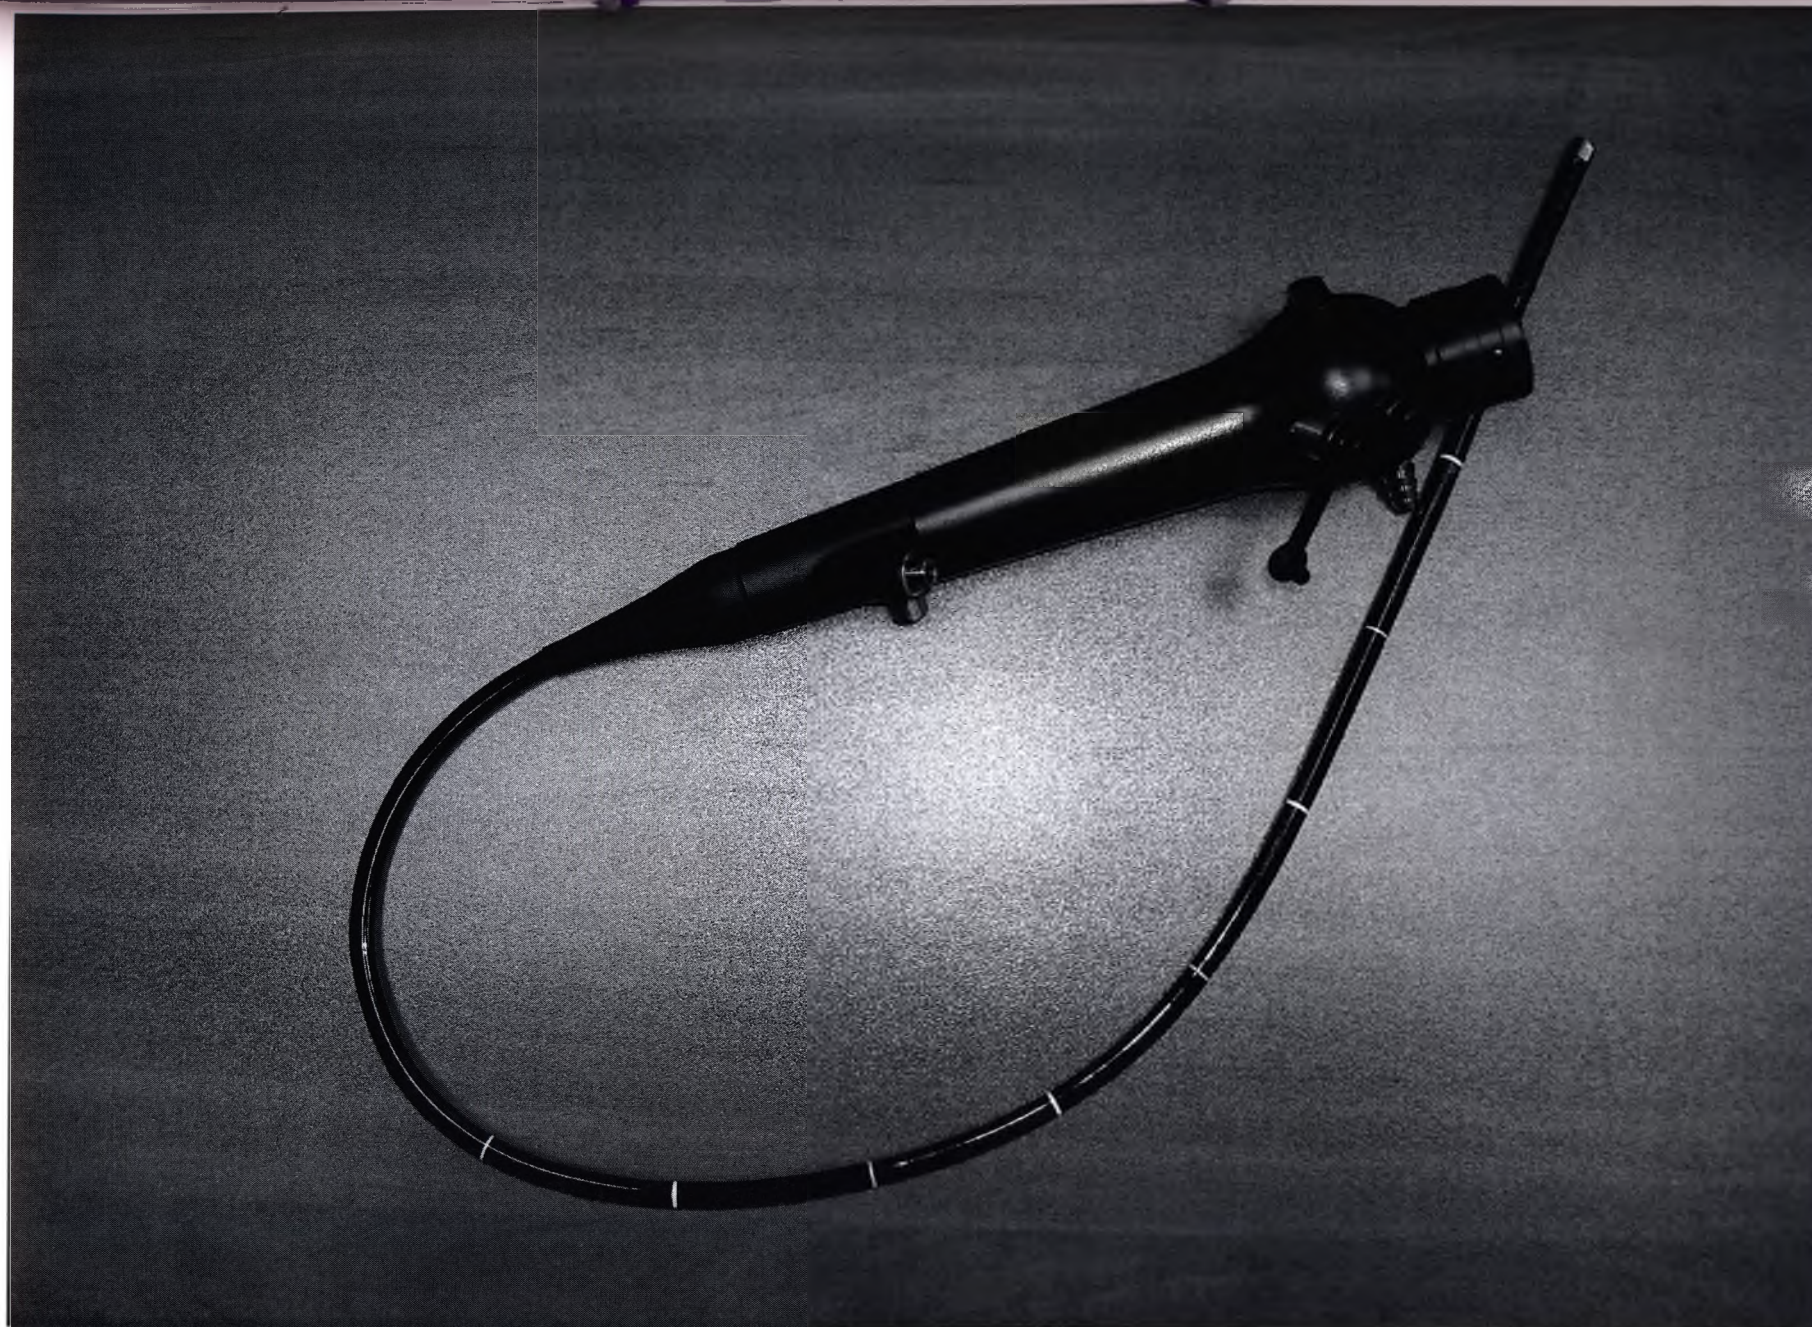

Интубоскоп А20R

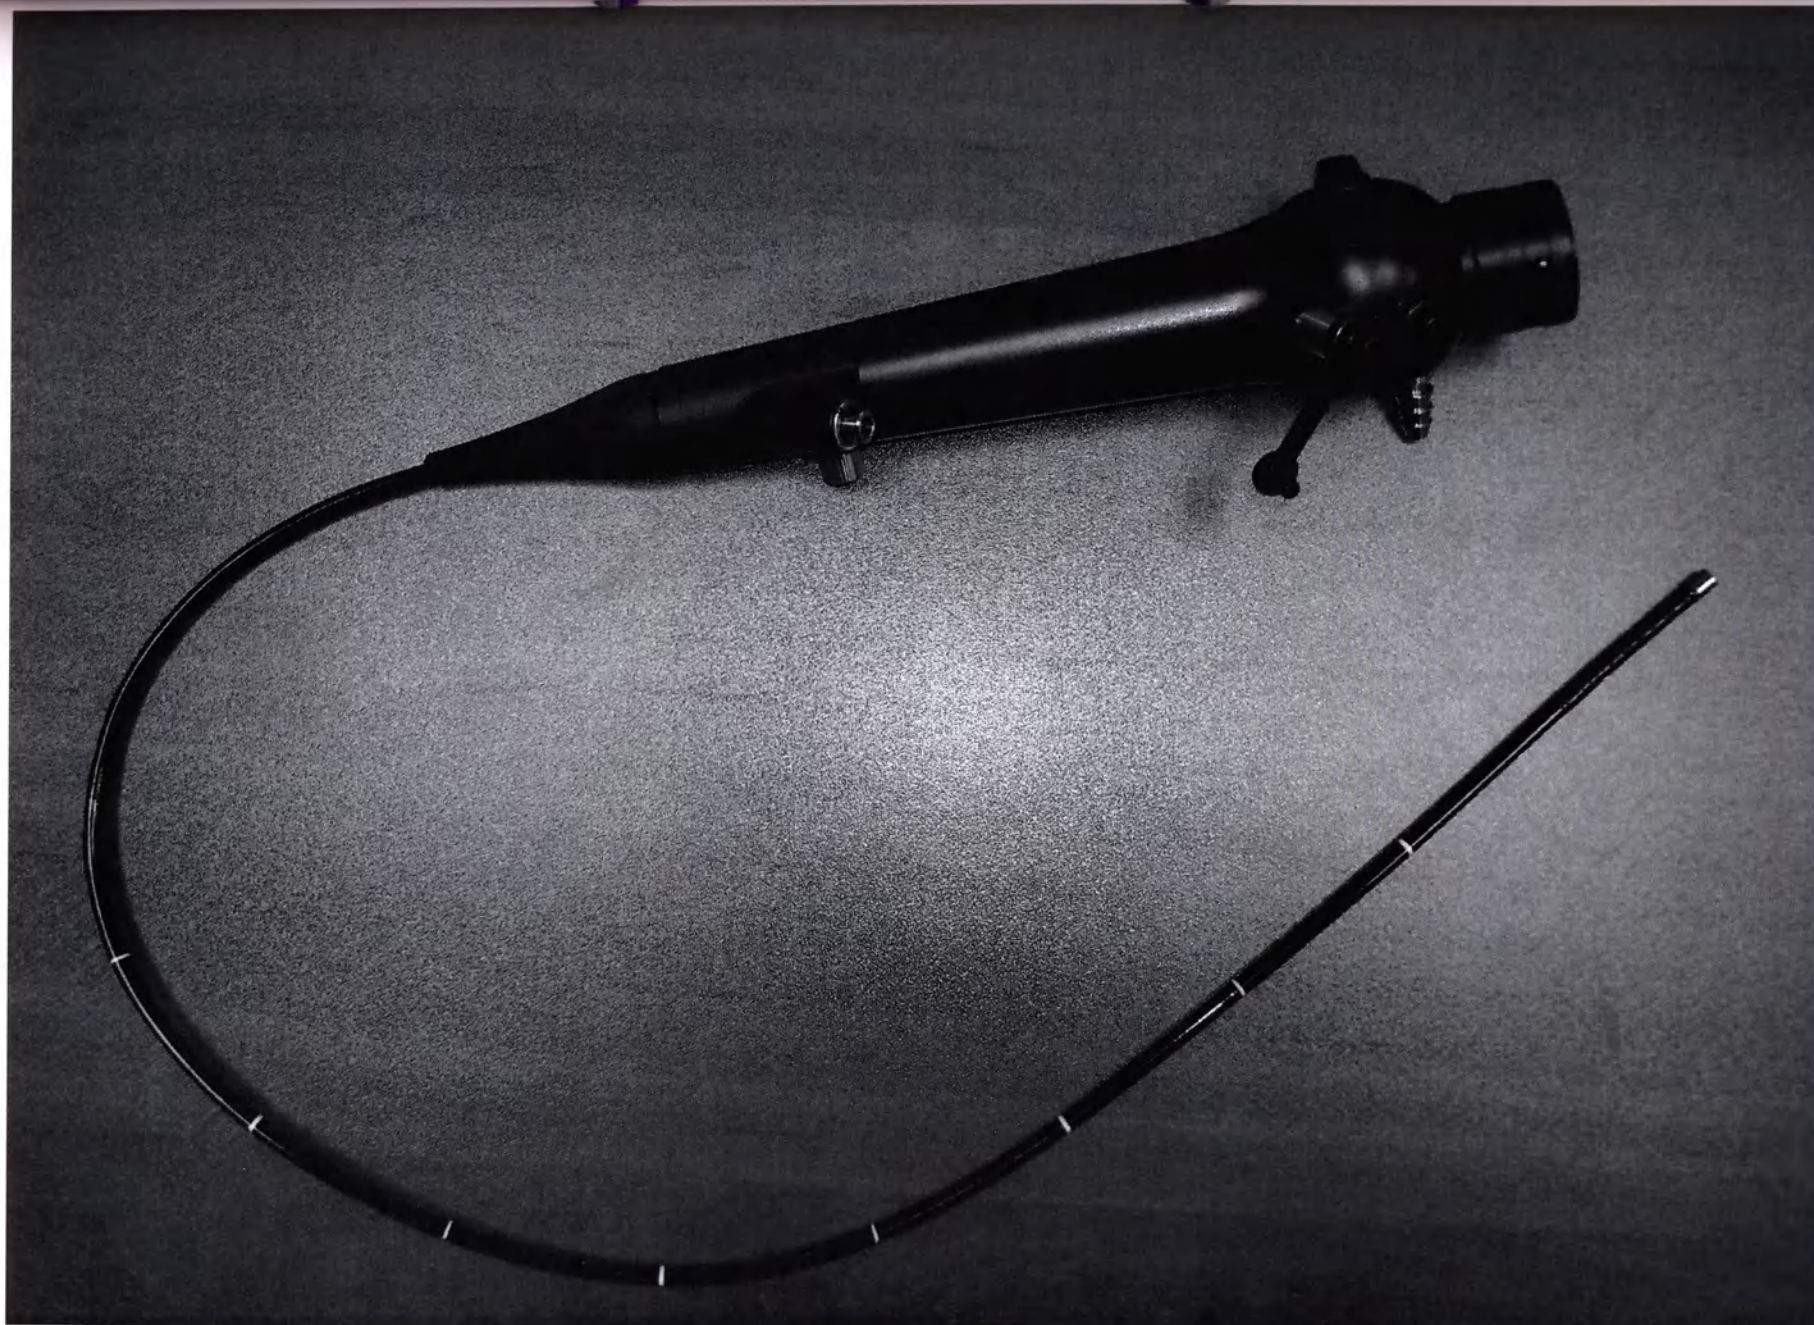

Интубоскоп А31




Монитор 3,5"

## Монитор 3,5"

SN: 26546

: 2014-09



Аккумулятор: литий-ионный



Чжухай Миндхао Медикал Технолоджи Ко., Лтд



Организация, уполномоченная изготовителем на принятие и удовлетворение требований потребителей в отношении товаров ненадлежащего качества: ООО "ХЕЛСИ ВОРЛД" 191014, г. Санкт-Петербург, пр. Лиговский, д.3/9, кв. 1, тел. 8(812) 579-74-97

Маркировка Монитора 3,5"




Монитор 4"



Чемодан



Отвертка

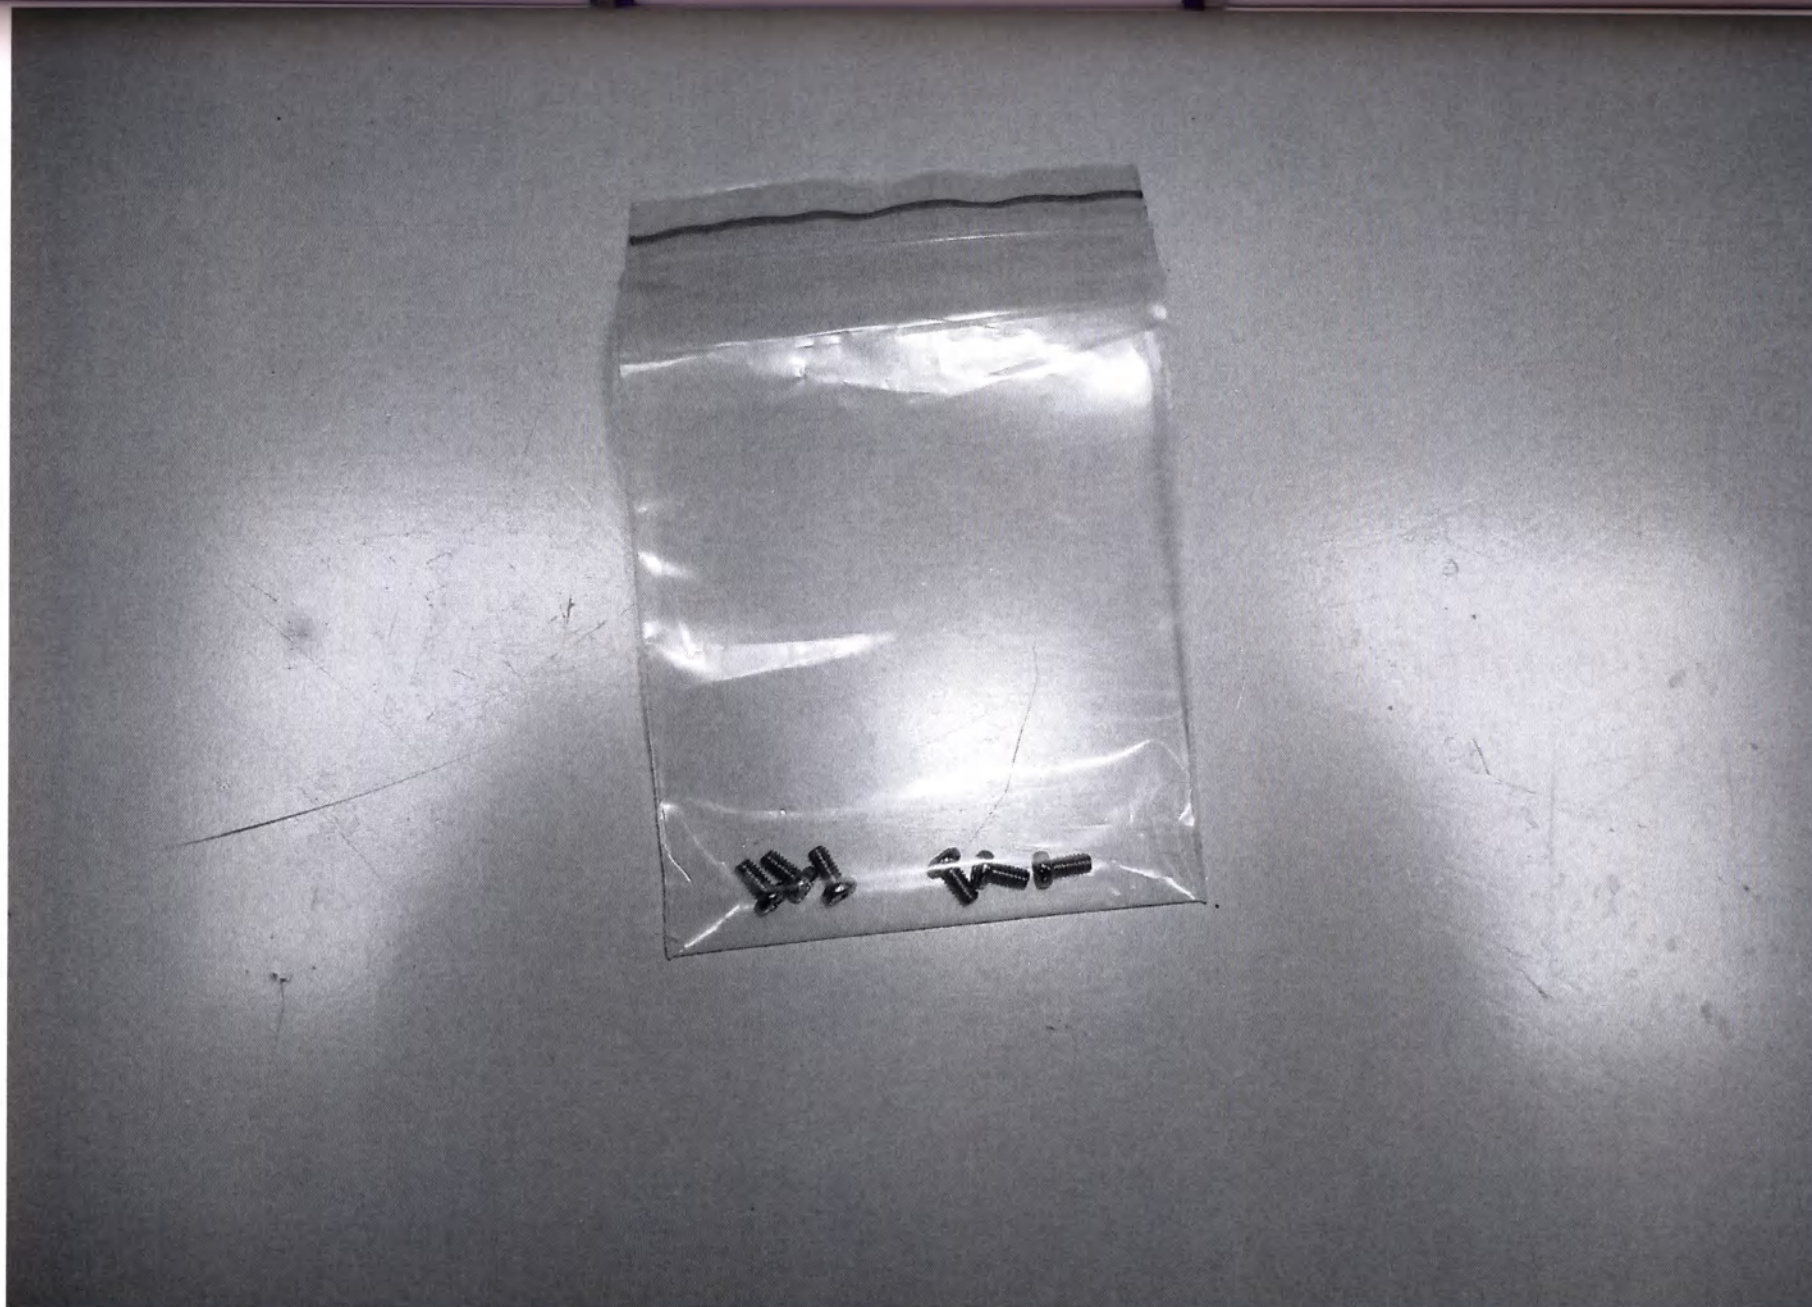

Винты



Загубник




ЕТТ адаптер



ЕТО колпачок




Клапан отсоса

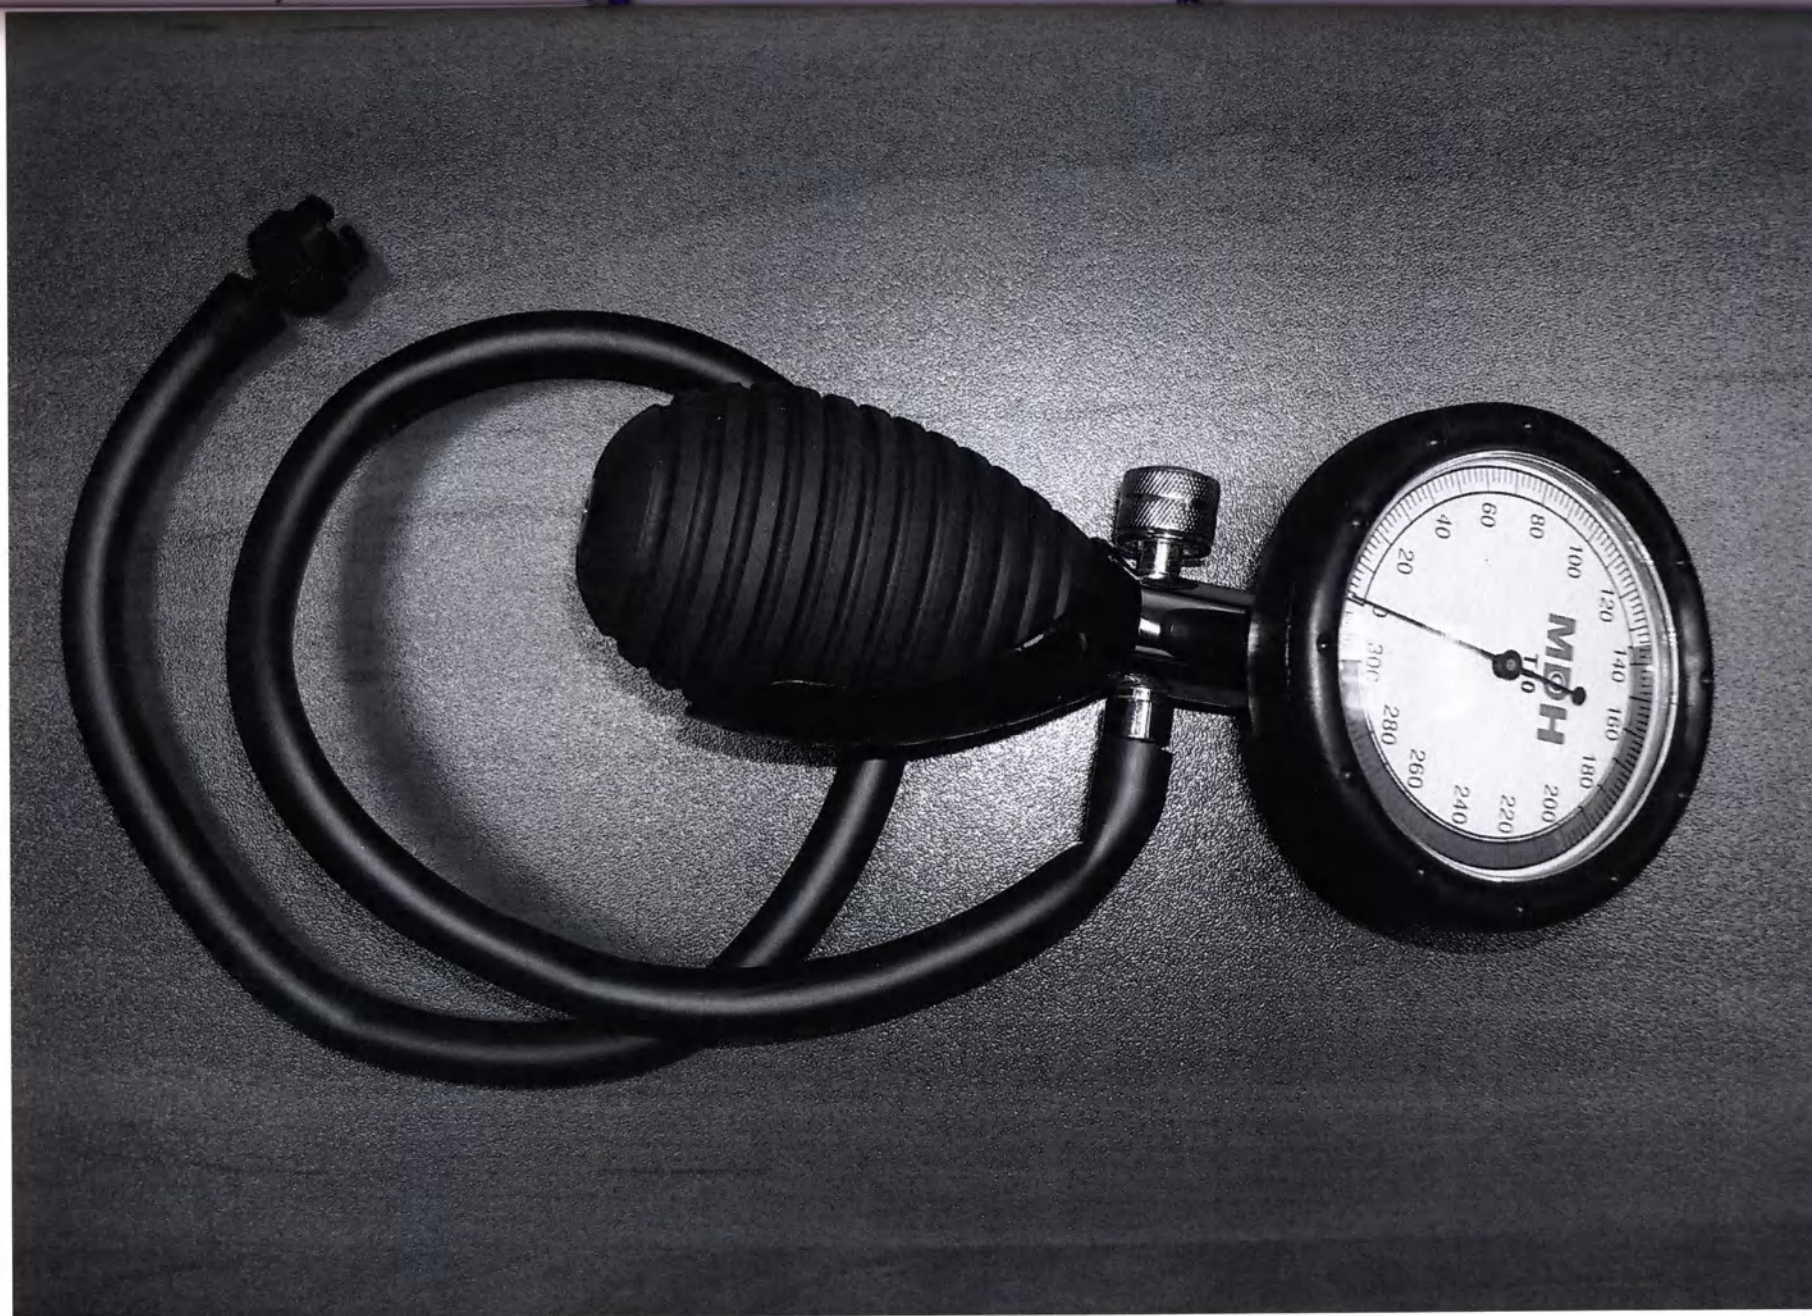

Течеискатель




Заглушка

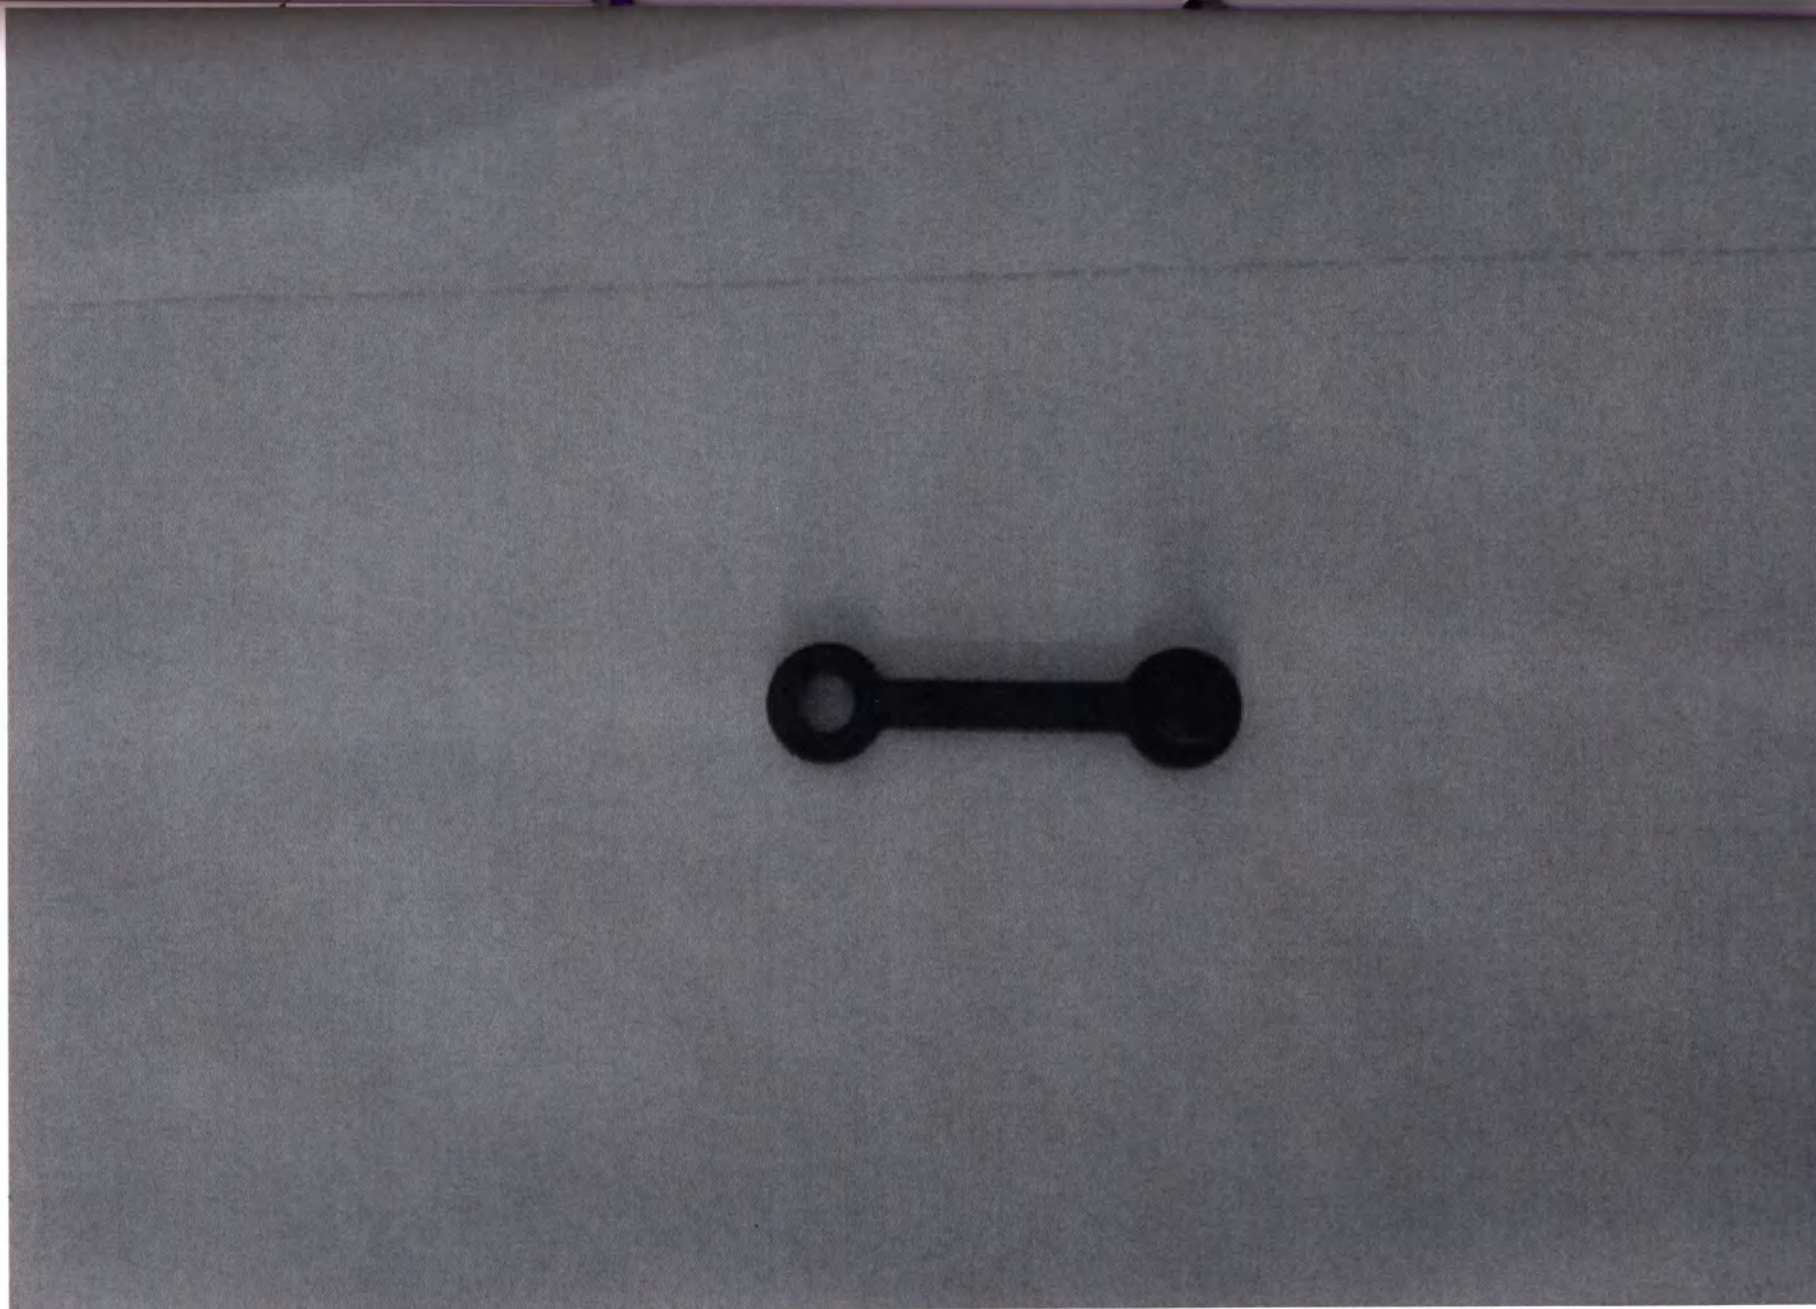

Клапан инструментального канала




Клапан воздуха

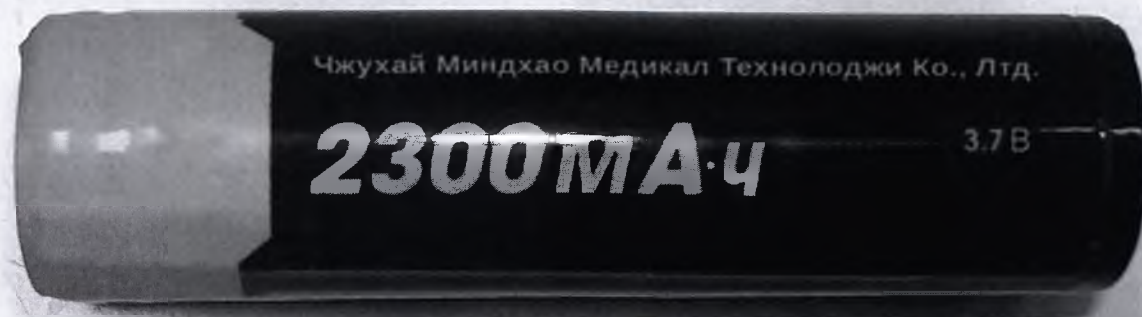

Аккумулятор



Переходник для аккумулятора

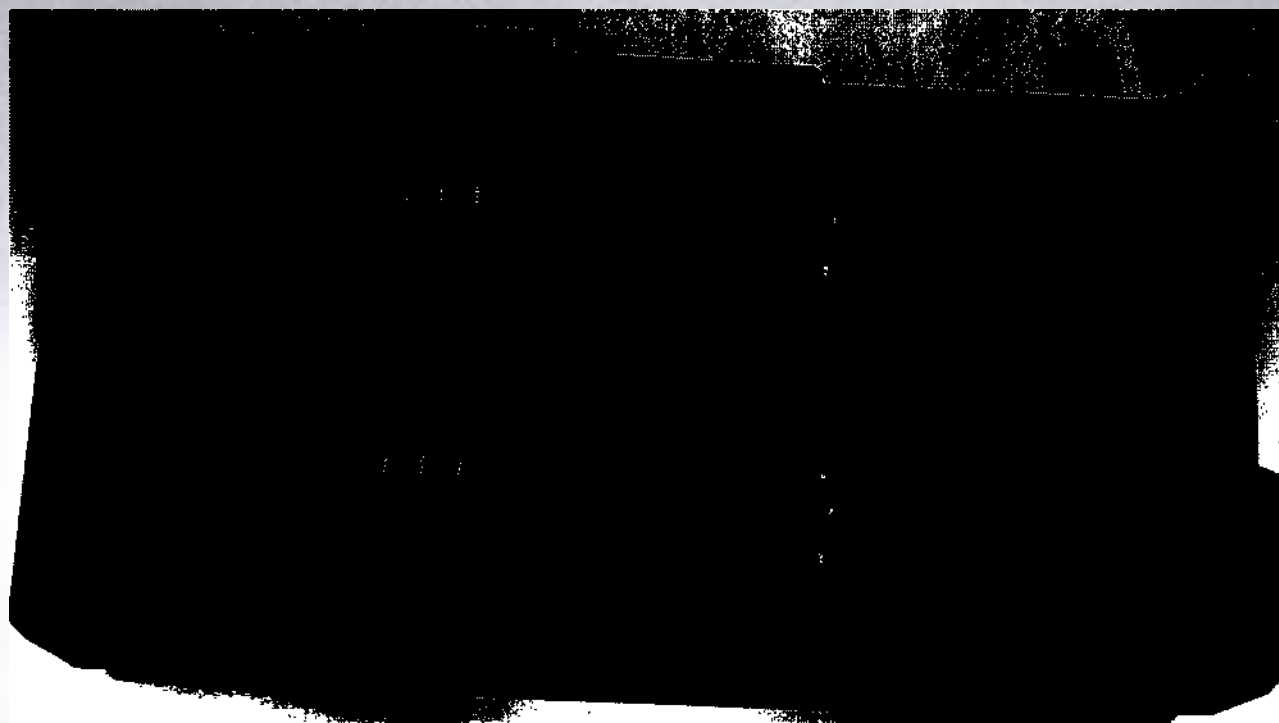

Зарядное устройство

# Зарядное устройство

Чжухай Миндхао Медикал Технолоджи Ко., Лтд.


**MDH**



ВХОД: ~ 220В 50Гц 8Вт


ВЫХОД == 4.2В 0.5А\*2

Сделано в Китае



0123


Маркировка зарядного устройства

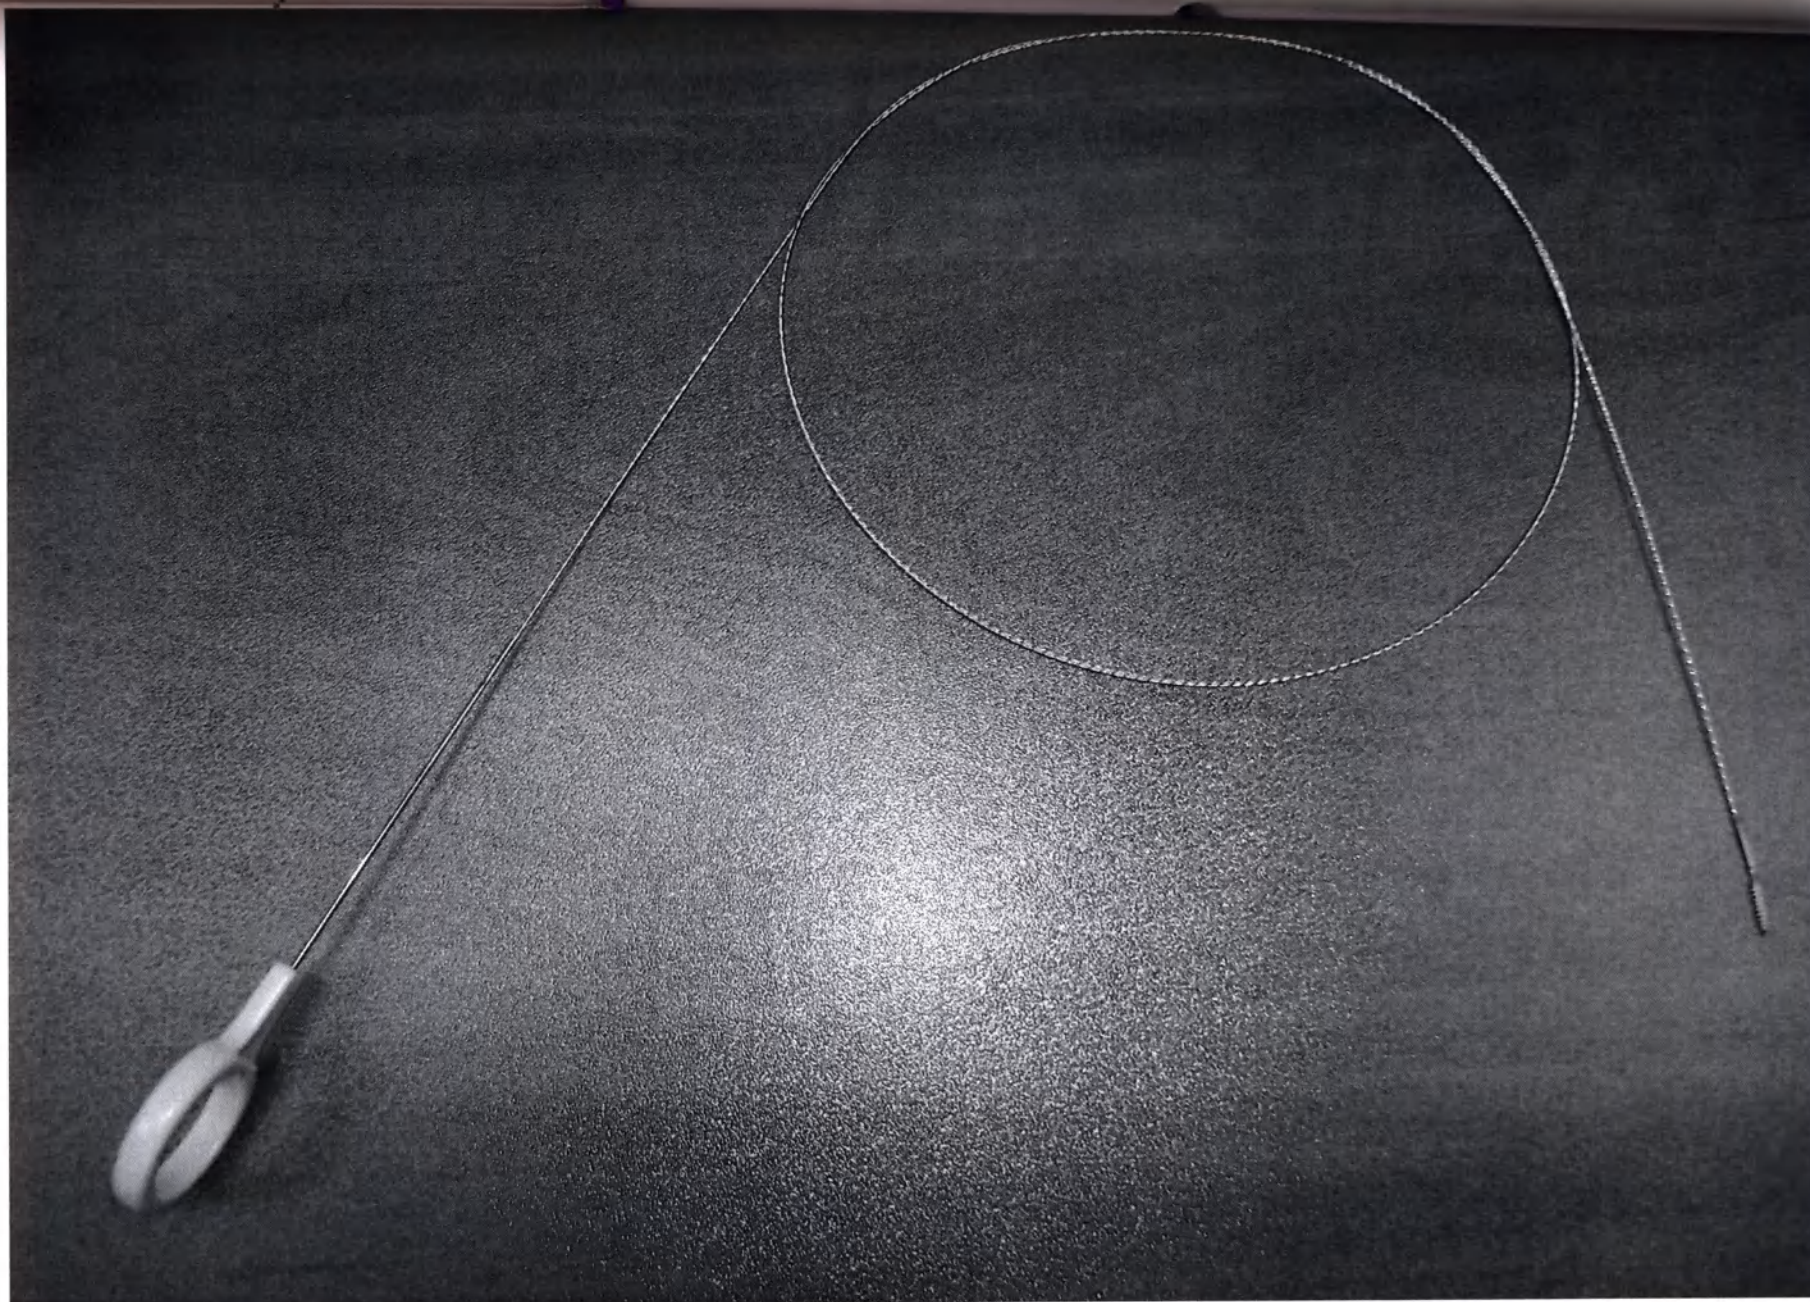


Чистящая щетка



Удлинитель 1 м

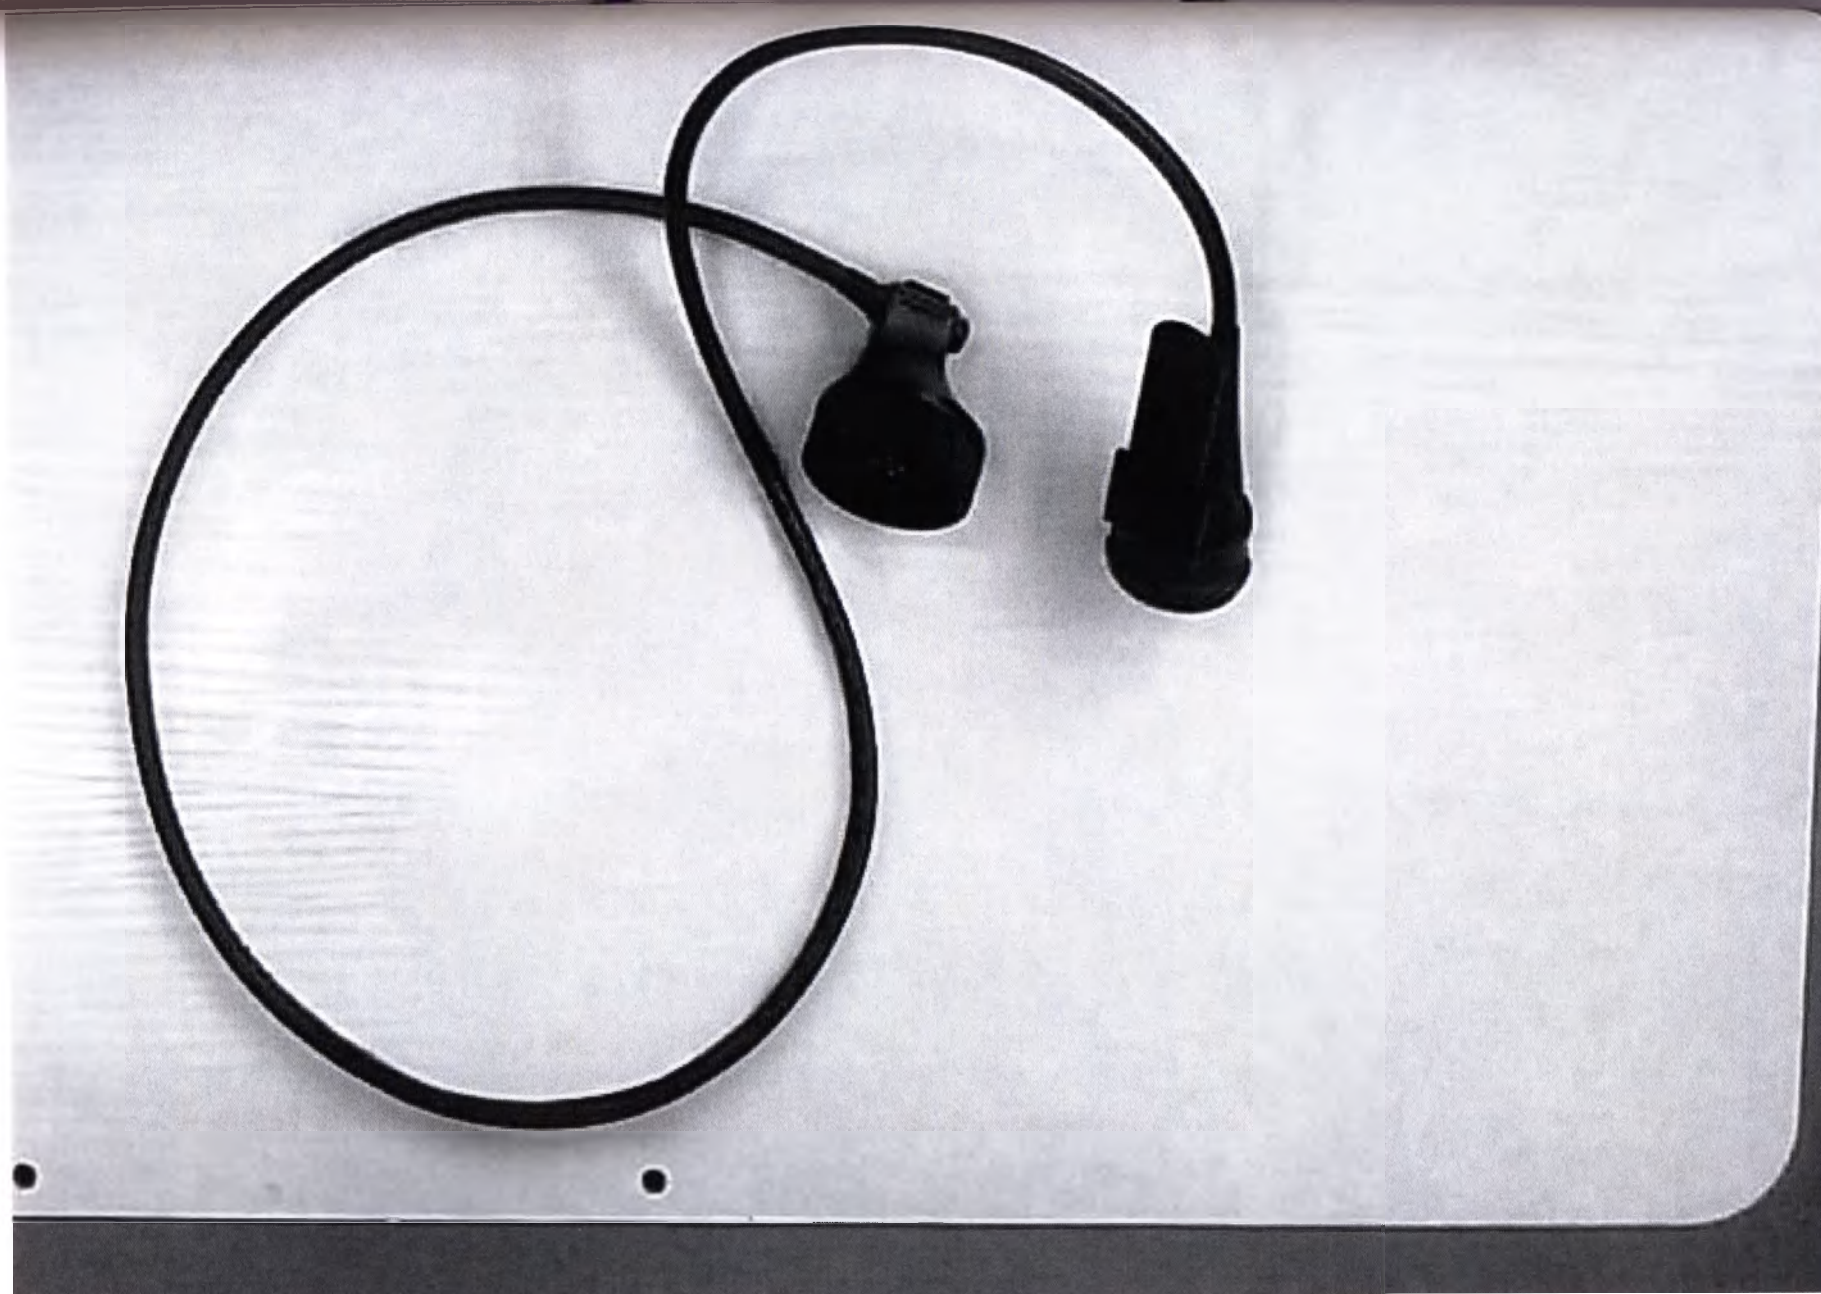

Удлинитель 2 м

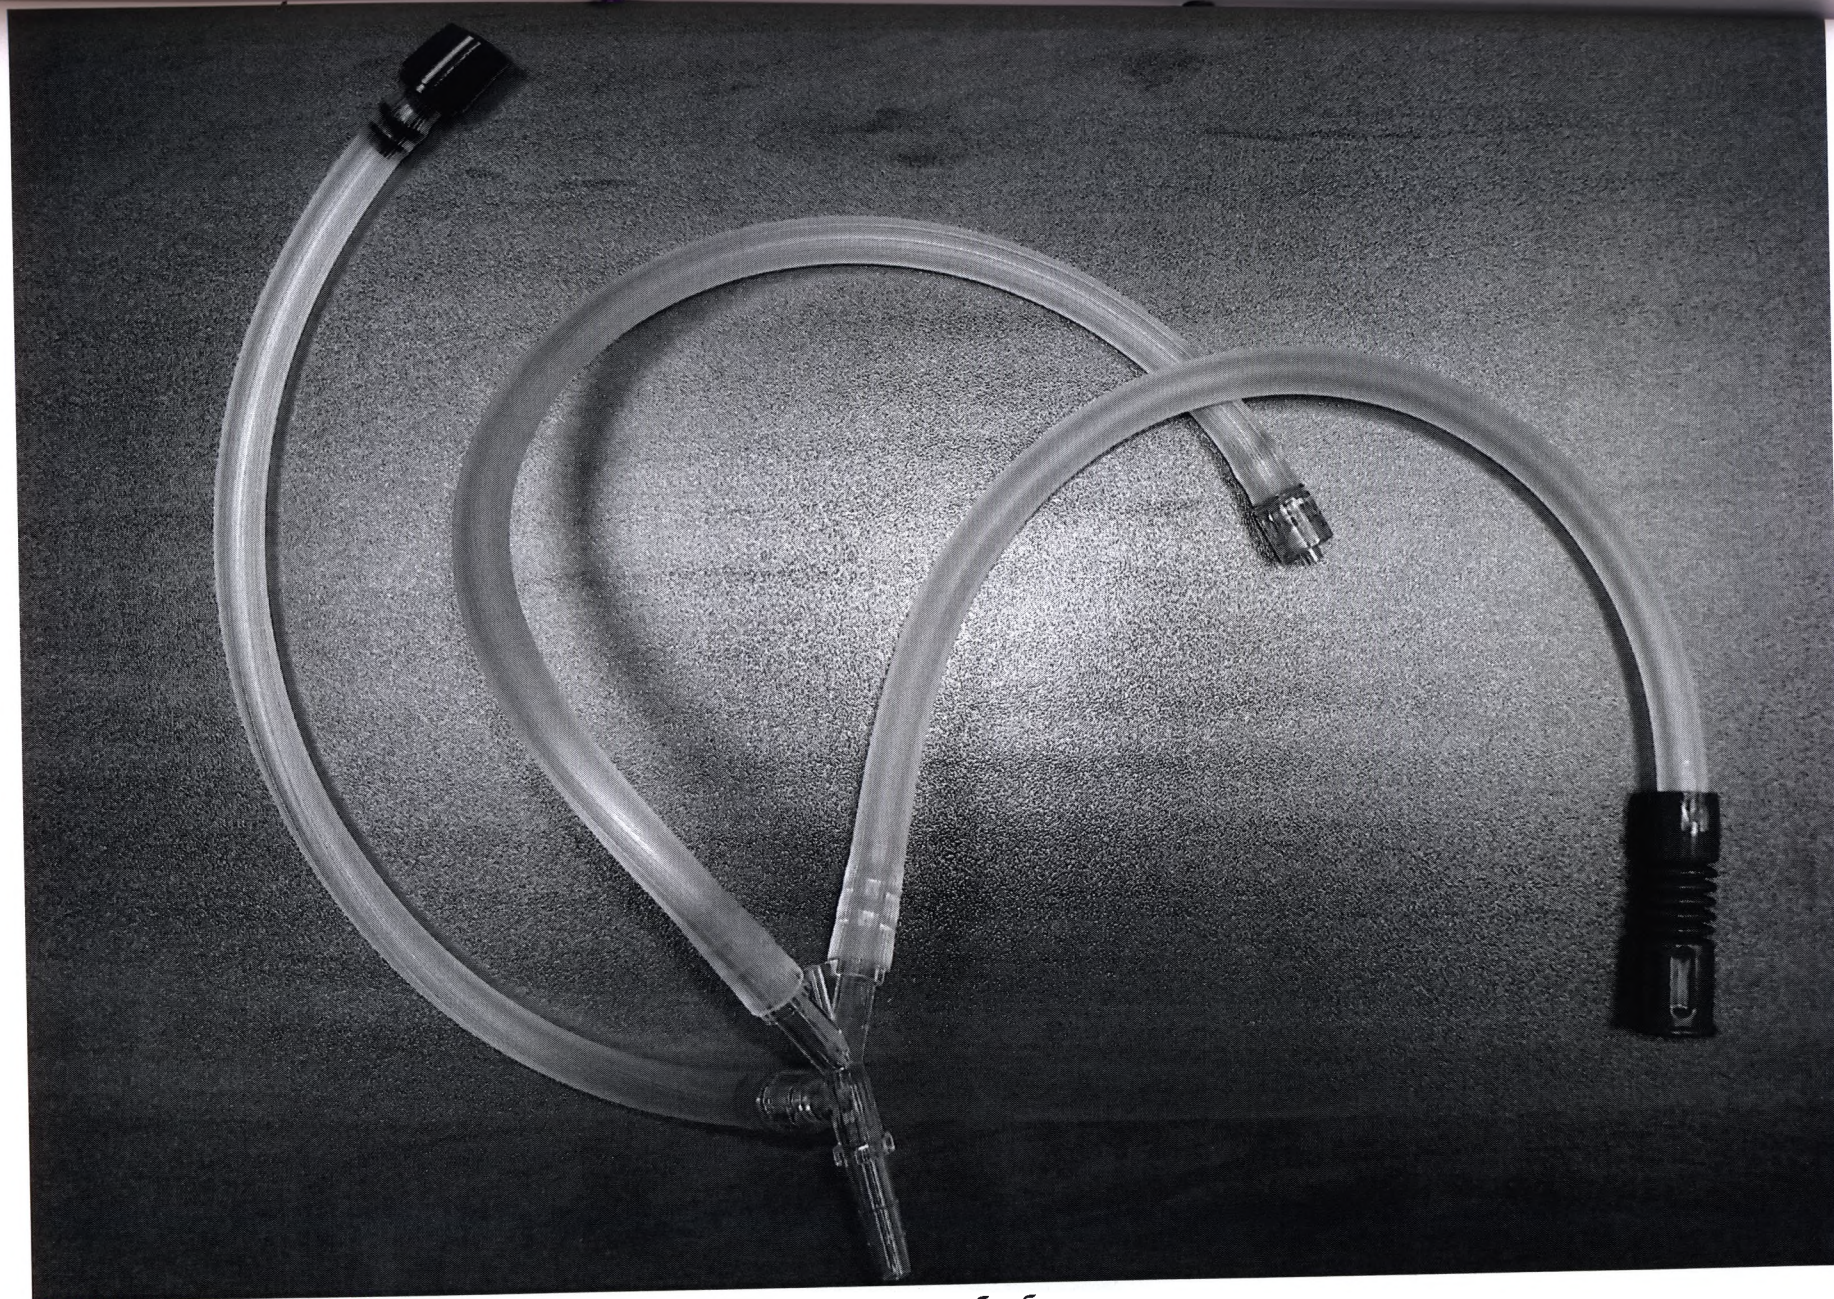

Адаптер для обработки



Соединительный кабель